
AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile RUP: Dott. Luigi Moreno COSTA – tel. 010 548 8561 luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI tel. 010/548-8553 tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

DETERMINAZIONE N. 315 DEL 06/09/2017

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento della fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari ad uso ospedaliero per le AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Lotti n. 11. Importo presunto di gara € 5.671.600,00 (IVA esclusa). Numero gara: 6621976. Aggiudicazione. Importo di spesa per la pubblicazione bandi di gara € 2.200,00 (IVA inclusa).

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);


Visto l'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dal 01/10/2016 da A.Li.Sa. fino alla revisione della normativa regionale in materia di centrale di committenza;

Vista la deliberazione n. 22 del 30/12/2016 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. rubricata "Ulteriori provvedimenti relativi al provvisorio esercizio delle funzioni dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, nelle more dell'adozione della dotazione organica definitiva e degli atti previsti dall'art. 11, c.11, della Legge Regionale 29 luglio 2016, n. 17" con la quale sono state prorogate in via transitoria le competenze del Direttore e dei Dirigenti dell'Area CRA;

Ricordato, inoltre, che A.Li.Sa. in funzione di Centrale Regionale di Acquisto opera, in qualità di articolazione funzionale della SUAR, individuata, ai sensi del disposto dell'art. 18 Commi 5 ed 8 della Legge Regionale 29 Dicembre 2014 n. 41, unica stazione appaltante della Regione Liguria, a seguito della Convenzione per l'esercizio delle funzioni di committenza delegate alla CRA per fornitura di beni e servizi in materia sanitaria, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 456 del 20/05/2016, al cui contenuto necessariamente si rinvia;

Richiamata la propria Determinazione n. 93 del 28/12/2016, al cui contenuto necessariamente si rinvia, con la quale si era provveduto all'indizione della procedura di gara per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari ad uso ospedaliero per le AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di ventiquattro mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) ed alla contestuale approvazione del Disciplinare di gara contenente le norme di partecipazione;





Considerato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del giorno 06/02/2017 sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

| Ditte | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Drager Medical Italia spa | Prot. n. 1808 del 06/02/2017 |
| Medtronic Italia spa | Prot. n. 1779 del 03/02/2017 |
| Carefusion Italy 311 srl unipersonale | Prot. n. 1774 del 06/02/2017 |
| Burke&Burke spa | Prot. n. 1772 del 06/02/2017 |
| Medigas Italia srl | Prot. n. 1805 del 06/02/2017 |
| Mindray Medical Italy srl | Prot. n. 1806 del 06/02/2017 |
| Air Liquide Medical Systems spa | Prot. n. 1807 del 06/02/2017 |
| Maquet Italia spa | Prot. n. 1810 del 06/02/2017 |
| Philips spa | Prot. n. 1811 del 06/02/2017 |
| GE Medical Systems Italia spa | Prot. n. 1801 del 06/02/2017 |

Preso atto che in data 09/02/2017 si è riunito il seggio di gara, nominato con la propria Determinazione n. 42 del 07/02/2017, secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e per la verifica dei documenti richiesti;

Considerato che tutte le Ditte hanno presentato regolare documentazione per cui sono state ammesse, per i lotti e con i prodotti a fianco di ciascuna indicati, alle successive fasi di gara, come da verbale della prima seduta pubblica del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa tenutasi in data 09/02/2017 (prot. n. 2406 del 15/02/2017 – ALLEGATO 1);

Richiamata la deliberazione n. 110 del 20/03/2017 del Direttore dell'Area CRA con la quale si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice della gara;

Dato atto che, all'esito della seconda seduta pubblica di verifica della documentazione tecnica svolta in data 06/04/2017 alla presenza della Commissione Giudicatrice come sopra nominata, tutte le Ditte hanno presentato regolare documentazione, per cui sono state ammesse (v. schema sotto riportato) alle successive fasi di gara, come da verbale prot. n. 5073 del 06/04/2017 (ALLEGATO 2):

| Società/Lotti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Air Liquid Medical Systems spa | | | | | X | | | | | | |
| Burke&Burke spa | | | X | X | X | | | X | | | |
| Carefusion Italy 311 srl unipersonale | | | | X | | | | | | | |
| Drager Medical Italia spa | X | X | X | X | | | | X | X | X | X |
| GE Medical Systems Italia spa | X | X | X | | | | | | | X | |
| Maquet Italia spa | X | X | X | | | | | | | X | |
| Medigas Italia spa | | | | X | | X | | | | | |
| Medtronic Italia spa | | | X | X | | | | | | X | |
| Mindray Medical Italy srl | | X | | X | | | | | | | |
| Philips spa | | | | X | | | | | | | |

Dato atto che in data 21/06/2017, 28/06/2017 e 26/07/2017 la Commissione Giudicatrice ha provveduto in seduta riservata, ai fini delle valutazioni di idoneità/qualità, alla prova pratica delle apparecchiature offerte in gara come previsto dal Disciplinare di Gara;

Rilevato che le prove pratiche delle apparecchiature sono state svolte, su indicazione della Commissione Giudicatrice, presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova per i Lotti 1, 2, 3, 4 e 6 e presso l'IRCCS Giannina Gaslini in Genova per i Lotti 5, 8, 9, 10 e 11;

Preso atto dei verbali dei lavori di valutazione tecnica (qualità/idoneità) della Commissione Giudicatrice riunitasi in seduta riservata nelle date sotto riportate:

- 21/04/2017 – verbale prot. n. 5962 del 21/04/2017;
- 24/05/2017 – verbale prot. n. 7564 del 25/05/2017
- 21/06/2017 – verbale prot. n. 8846 del 22/06/2017
- 28/06/2017 – verbale prot. n. 9162 del 29/06/2017
- 26/07/2017 – verbale prot. n. 10715 del 27/07/2017


allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 3);

Rilevato che la Commissione Giudicatrice, a seguito dei riscontri tecnici effettuati sulla documentazione tecnica prodotta, ha dovuto escludere per mancanza di requisiti obbligatori le offerte presentate dalla Società Medtronic Italia spa per i Lotti 3, 4 e 10 e che le esclusioni sono state comunicate alla Ditta interessata con nota prot. n. 7601 del 25/05/2017;

Preso altresì atto del verbale della seduta pubblica del 17/08/2017 (prot. n. 11745 del 17/08/2017) concernente l'apertura delle offerte economiche e l'individuazione dei migliori offerenti, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATO 4), con il quale si è proceduto alla proposta di aggiudicazione dei Lotti di gara ai sensi dell'art. 33, comma 1 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto delle risultanze delle diverse offerte, quali di seguito meglio precisate, a seguito delle quali emerge la proposta di aggiudicazione alle Ditte ed ai prodotti di seguito meglio precisati:

| Lotto | Descrizione | Graduatoria | DITTA | Prodotto offerto | Prezzo unitario offerto (euro IVA esclusa) |
|-------|---|-------------|-------------------------------|---|--|
| 1 | Apparecchi per anestesia di alta fascia | 1° | GE Medical Systems Italia spa | AYSIS CS 2 | € 25.480,00 |
| | | | | Monitoraggio Carescape B650 | € 4.991,00 |
| | | | | Monitoraggio E-Picco | € 1.090,00 |
| | | | | Monitoraggio E-Entropy | € 875,00 |
| | | | | Monitoraggio E-NMT | € 775,00 |
| | | 2° | Maquet Italia spa | Flow IC20 | € 33.000,00 |
| | | | | Monitoraggio Philips Intellivue MX 550 | € 4.499,00 |
| | | | | Monitoraggio Intellivue Picco | € 4.750,00 |
| | | | | Monitoraggio Intellivue BIS | 3.500,00 |
| | | 3° | Draeger Medical Italia spa | Zeus IE | € 29.500,00 |
| | | | | Monitoraggio infinity Acute Care System | € 4.920,00 |
| | | | | Monitoraggio Quad Hemo | € 2.977,00 |
| | | | | Monitoraggio BIS Vista | € 4.593,00 |
| 2 | Apparecchi per anestesia di base | 1° | Mindray Medical Italy srl | Wato Ex 65 Pro | € 16.437,00 |
| | | 2° | GE Medical Systems Italia spa | Carestation 650 | € 18.000,00 |



| | | | | | |
|----|---|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | 3° | Maquet Italia spa | Flow i-C 20 | € 28.000,00 |
| | | 4° | Draeger Medical Italia spa | Primus 2002 | € 19.000,00 |
| 3 | Apparecchi per terapia intensiva | 1° | Burke&Burke spa | Hamilton G5 | € 18.500,00 |
| | | 2° | Draeger Medical Italia spa | Evita Infinity V500 | € 22.900,00 |
| | | 3° | GE Medical Systems Italia spa | Carescape R860 | € 21.200,00 |
| | | 4° | Maquet Italia spa | Servo-U | € 24.000,00 |
| 4 | Ventilatori polmonari per pneumologia | 1° | Mindray Medical Italia srl | SV 300 | € 7.750,00 |
| | | 2° | Carefusion Italy 311 srl unipersonale | IX5 Comprehensive | € 9.400,00 |
| | | 3° | Draeger Medical Italia spa | Savina 300 | € 11.500,00 |
| | | 4° | Philips Healthcare spa | Respironics V680 | € 10.400,00 |
| | | 5° | Medigas Italia spa | Bellavista | € 12.950,00 |
| | | 6° | Burke&Burke spa | Hamilton C3 | € 13.800,00 |
| 5 | Ventilatori polmonari da trasporto/emergenza | 1° | Air Liquide Medical Systems spa | Monnal T60 | € 11.238,80 |
| | | 2° | Burke&Burke spa | Hamilton T1 | € 16.800,00 |
| 6 | CPAP per degenza | 1° | Medigas Italia spa | Resmart GII CPAP | € 275,00 |
| 7 | CPAP ad alto flusso per pazienti IRA | NON AGGIUDICATO | | | |
| 8 | Ventilatore per ventilazione convenzionale e ad alta frequenza oscillatoria per terapia intensiva neonatale | 1° | Draeger Medical Italia spa | Babylog VN 500 | € 30.200,00 |
| | | 2° | Burke&Burke spa | Fabian HOFi | € 22.500,00 |
| 9 | Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità invasiva | 1° | Draeger Medical Italia spa | Infinity Evita V500 | € 23.000,00 |
| 10 | Ventilatore per ventilazione invasiva per terapia intensiva pediatrica | 1° | Draeger Medical Italia spa | Infinity Evita V500 | € 23.000,00 |
| | | 2° | Maquet Italia spa | Servo-U | € 28.000,00 |
| | | 3° | GE Medical Systems Italia spa | Carescape R860 | € 18.300,00 |
| 11 | Apparecchio a circuito aperto, semi-chiuso e chiuso a bassi flussi per anestesia neonatale e pediatrica utilizzabile anche su paziente adolescente/adulto | 1° | Draeger Medical Italia spa | Perseus A500 | € 25.300,00 |
| | | | | Infinity Acute Care Systems C700 | € 5.000,00 |

Dato atto che tutti i verbali citati vengono integralmente allegati in copia alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte sostanziale;

Rilevato che gli Uffici della Centrale hanno altresì provveduto a richiedere, nei tempi e secondo le modalità stabilite ex art. 97, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, alle Società Air Liquide Medical Systems (lotto 5), Burke&Burke spa (lotti 3 e 8), Carefusion Italia 311 S.r.l. (lotto 4), Draeger Medical Italia spa. (lotti 9, 10 e 11), GE Medical Systems Italia spa (Lotti 1 e 2), Medigas italia spa (Lotto 6) e Mindray Medical Italy srl (Lotti 2 e 4) la giustificazione delle offerte risultate anormalmente basse;

Considerato che la documentazione probatoria fornita al riguardo dalle Società di cui al punto precedente, acquisita agli atti con i numeri di protocollo come indicato a fianco di ciascuna di esse (Air Liquide Medical Systems srl – prot. n. 12491 del 05/09/2017; Burke&Burke spa – prot. n. 12151 del 30/08/2017; Ca-

1



refusion Italy 311 – prot. n. 12275 del 01/09/2017; Draeger Medical Italia spa – prot. n. 12242 del 31/08/2017; GE Medical Systems Italia spa prot. n. 12271 del 01/09/2017; Medigas Italia srl prot. n. 12499 del 06/09/2017; Mindray Medical Italy srl prot. n. 12057 del 28/08/2017) attesta la congruità e l'affidabilità, nel complesso, delle offerte ai sensi del citato art. 97 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e che il RUP ha ritenuto, pertanto, congrue le offerte formulate;

Dato atto che, come previsto dal Disciplinare di gara, per ciascun Lotto dell'Accordo Quadro il 60% della fornitura verrà affidato al concorrente aggiudicatario che risulterà primo classificato nella graduatoria finale ed il restante 40% della fornitura verrà affidato agli altri concorrenti aggiudicatari dell'Accordo Quadro, sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze delle Amministrazioni utilizzatrici (art. 54, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016);

Rilevato che non esistono per la fornitura in oggetto convenzioni nazionali CONSIP;

Rilevato altresì che i prodotti oggetto di aggiudicazione non risultano ricompresi in quelli di riferimento individuati dall'ANAC (art. 17 comma 1 lett. a) D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111/2011) e ritenuto pertanto di poter sciogliere la riserva di non aggiudicazione del Disciplinare di gara in quanto non ricorrono nel caso di specie i presupposti richiesti dalla normativa vigente;

Vista la proposta di aggiudicazione di cui al Verbale di apertura delle offerte economiche del 17/082017;

Ritenuto di procedere alla aggiudicazione dell'Accordo Quadro de qua, in conformità ai verbali allegati alla presente determinazione;

Su proposta del Dirigente responsabile,

DETERMINA:

- Di approvare i verbali di gara allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto come in premessa specificato, relativi all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di "Apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari ad uso ospedaliero" occorrenti alle Aziende Sanitarie Liguri per un periodo di 2 anni (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno);
- Di procedere alla aggiudicazione della gara in oggetto secondo lo schema seguente:

| Lotto | Descrizione | Graduatoria | DITTA | Prodotto offerto | Prezzo unitario offerto (euro IVA esclusa) |
|-------|---|-------------|-------------------------------|--|--|
| 1 | Apparecchi per anestesia di alta fascia | 1° | GE Medical Systems Italia spa | AYSIS CS 2 | € 25.480,00 |
| | | | | Monitoraggio Carescape B650 | € 4.991,00 |
| | | | | Monitoraggio E-Picco | € 1.090,00 |
| | | | | Monitoraggio E-Entropy | € 875,00 |
| | | | | Monitoraggio E-NMT | € 775,00 |
| | | 2° | Maquet Italia spa | Flow iC20 | € 33.000,00 |
| | | | | Monitoraggio Philips Intellivue MX 550 | € 4.499,00 |
| | | | | Monitoraggio Intellivue Picco | € 4.750,00 |
| | | | | Monitoraggio Intellivue BIS | 3.500,00 |

l



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

| | | | | | |
|----|---|-----------------|---------------------------------------|---|-------------|
| | | | | Monitoraggio Intellivue NMT | € 3.000,00 |
| | | 3° | Draeger Medical Italia spa | Zeus IE | € 29.500,00 |
| | | | | Monitoraggio Infinity Acute Care System | € 4.920,00 |
| | | | | Monitoraggio Quad Hemo | € 2.977,00 |
| | | | | Monitoraggio BIS Vista | € 4.593,00 |
| | | | | Monitoraggio TOF Scan | € 4.300,00 |
| 2 | Apparecchi per anestesia di base | 1° | Mindray Medical Italy srl | Wato Ex 65 Pro | € 16.437,00 |
| | | 2° | GE Medical Systems Italia spa | Carestation 650 | € 18.000,00 |
| | | 3° | Maquet Italia spa | Flow i-C 20 | € 28.000,00 |
| | | 4° | Draeger Medical Italia spa | Primus 2002 | € 19.000,00 |
| 3 | Apparecchi per terapia intensiva | 1° | Burke&Burke spa | Hamilton G5 | € 18.500,00 |
| | | 2° | Draeger Medical Italia spa | Evita Infinity V500 | € 22.900,00 |
| | | 3° | GE Medical Systems Italia spa | Carescape R860 | € 21.200,00 |
| | | 4° | Maquet Italia spa | Servo-U | € 24.000,00 |
| 4 | Ventilatori polmonari per pneumologia | 1° | Mindray Medical Italia srl | SV 300 | € 7.750,00 |
| | | 2° | Carefusion Italy 311 srl unipersonale | iX5 Comprehensive | € 9.400,00 |
| | | 3° | Draeger Medical Italia spa | Savina 300 | € 11.500,00 |
| | | 4° | Philips Healthcare spa | Respironics V680 | € 10.400,00 |
| | | 5° | Medigas Italia spa | Bellavista | € 12.950,00 |
| | | 6° | Burke&Burke spa | Hamilton C3 | € 13.800,00 |
| 5 | Ventilatori polmonari da trasporti/emergenza | 1° | Air Liquide Medical Systems spa | Monnal T60 | € 11.238,80 |
| | | 2° | Burke&Burke spa | Hamilton T1 | € 16.800,00 |
| 6 | CPAP per degenza | 1° | Medigas Italia spa | Resmart GII CPAP | € 275,00 |
| 7 | CPAP ad alto flusso per pazienti IRA | NON AGGIUDICATO | | | |
| 8 | Ventilatore per ventilazione convenzionale e ad alta frequenza oscillatoria per terapia intensiva neonatale | 1° | Draeger Medical Italia spa | Babylog VN 500 | € 30.200,00 |
| | | 2° | Burke&Burke spa | Fabian HOFI | € 22.500,00 |
| 9 | Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità invasiva | 1° | Draeger Medical Italia spa | Infinity Evita V500 | € 23.000,00 |
| 10 | Ventilatore per ventilazione invasiva per terapia intensiva pediatrica | 1° | Draeger Medical Italia spa | Infinity Evita V500 | € 23.000,00 |
| | | 2° | Maquet Italia spa | Servo-U | € 28.000,00 |
| | | 3° | GE Medical Systems Italia spa | Carescape R860 | € 18.300,00 |
| 11 | Apparecchio a circuito aperto, semi-chiuso e chiuso a bassi flussi per anestesia neonatale e pediatrica utilizzabile anche su paziente adolescente/adulto | 1° | Draeger Medical Italia spa | Perseus A500 | € 25.300,00 |
| | | | | Infinity Acute Care Systems C700 | € 5.000,00 |





3. Di dare atto che, come previsto dal Disciplinare di gara, per ciascun Lotto dell'Accordo Quadro il 60% della fornitura verrà affidato al concorrente aggiudicatario che risulterà primo classificato nella graduatoria finale ed il restante 40% della fornitura verrà affidato agli altri concorrenti aggiudicatari dell'Accordo Quadro, sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze delle Amministrazioni utilizzatrici (art. 54, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016);
4. Di dare atto che:
 - l'aggiudicazione diventerà efficace successivamente all'espletamento dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 12 D. Lgs. 50/2016;
 - il termine dilatorio per la stipula della convenzione, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data dell'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento effettuata agli aggiudicatari e ai non aggiudicatari della gara;
 - l'importo della garanzia fideiussoria da prestare da parte dell'aggiudicatario è determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1 secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale;
5. Di dare atto che le convenzioni da sottoscrivere con le Ditte aggiudicatarie e gli ordinativi di fornitura da sottoscrivere a cura di ciascuna Azienda Sanitaria saranno redatti in base allo schema tipo approvato con la determinazione di indizione;
6. Di provvedere alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;
7. Di disporre, la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, sulle seguenti testate e siti informatici, alle condizioni previste nella determinazione n. 150 del 13/04/2017:
 - in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,
 - per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui seguenti quotidiani e siti informatici:
 - Il Giornale nell'edizione nazionale
 - Il Messaggero nell'edizione nazionale
 - TuttoSport ed. Nord Ovest
 - La Repubblica ed. Genova
 - Servizio appalti Regione Liguria
 - Sito web ANAC (www.anticorruzione.it)
 - Sito Web Aziendale.
8. Di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento quantificati in € 2.200,00 (IVA al 22% inclusa), sono compresi nello stanziamento del Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2017 (Conto 170.015.010 - Autorizzazione n. 17/2017), e che per l'importo di € 2.200,00 circa saranno rimborsati ad A.Li.Sa. dagli aggiudicatari della procedura ai sensi dell'art. 34 D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 221.
9. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 7 (sette) pagine oltre gli allegati.

IL DIRETTORE
AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)

Allegati:

- Verbale apertura documentazione amministrativa – 09/02/2017 (prot. n. 2406 del 15/02/2017)
- Verbale conformità documentazione tecnica – 06/04/2017 (prot. n. 5073 del 06/04/2017)
- Verbalì lavori Commissione Giudicatrice:
 - * seduta del 21/04/2017 – verbale prot. n. 5962 del 26/04/2017
 - * seduta del 24/05/2017 – verbale prot. n. 7564 del 25/05/2017
 - * seduta del 21/06/2017 – verbale prot. n. 8846 del 22/06/2017
 - * seduta del 28/06/2017 – verbale prot. n. 9162 del 29/06/2017



* seduta del 26/07/2017 – verbale prot. n. 10715 del 27/07/2017
- Verbale apertura offerte economiche – 17/08/2017 (prot. n. 11745 del 17/08/2017)

A.Li.Sa.**AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA**

C.F. / P. IVA 02421770997

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa- tel.010/548 8561
 e-mail: luigi.moreno.costa@regione.liguria.it
 Referente: Dott.ssa Tiziana Tazzoli- tel. 010/548-8553
 e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 54 D.Lgs n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento della fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori pomonari ad uso ospedaiero occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.CC.S. della Regione Liguria per un periodo di anni due con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Gara n. 6621976.

Verbale di apertura buste afferenti la documentazione amministrativa

Il giorno 09/02/2017 alle ore 10:00, presso la Sala riunioni dell'Area Centrale Regionale di Acquisto in via D'Annunzio 64, 16121 Genova, si è riunito il Seggio di gara della procedura in oggetto, nominato con determinazione n. 42 del 07/02/2017 per la verifica della sussistenza della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti. Sono presenti i Sigg.:

- Dr. Luigi Moreno Costa - Dirigente della Centrale - Presidente
- Dr.ssa Tiziana Tazzoli - Collaboratore amm.vo prof.le della Centrale – Componente Segretario
- Dr.ssa Francesca Elia – Assistente amm.vo della Centrale – Componente

L'Ufficiale rogante di A.Li.Sa., Area Centrale Regionale d'Acquisto, è presente nella persona del dott. Luigi Tomei.

In rappresentanza delle Ditte partecipanti sono presenti i Signori:

| Nominativo | Ditta |
|--|-------------------------------|
| Sig. Marco Violato | Philips spa |
| Sig. Alessandro Garofalo | Burke&Burke spa |
| Sig. Paolo Mario Marcarini | Maquet Italia spa |
| Sig. Stefano Sartori | Drager Medical Italia spa |
| Sig. Andrea Lanzone | Care Fusion Italy |
| Sig. Cristiano Giacalone - lascia la seduta alle ore 11:07 | Medtronic Italia spa |
| Sig. Alessandro Puppo e Sig.ra Nadia Pasotti | GE Medical Systems Italia spa |

muniti delle necessarie procure (presentate in copia o in originale) che verranno allegare quali parti integranti e sostanziali del presente verbale in caso di dichiarazioni rese a verbale.

Il Seggio di gara dà preliminarmente atto che:

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
 tel. 010 548 8562/ 8563

PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it
 Sito web: www.acquistiliguria.it

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

2 di 4

- con determinazione n. 93 del 28/12/2016 si è provveduto all'indizione della gara in oggetto ed all'approvazione del capitolato speciale e delle norme di partecipazione;
- il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 12,00 del giorno 06/02/2017;

Il Presidente del Seggio di gara rileva che entro il termine delle ore 12,00 del 06/02/2017 sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

| Ditte | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Drager Medical Italia spa | Prot. n. 1808 del 06/02/2017 |
| Medtronic Italia spa | Prot. n. 1779 del 036/02/2017 |
| Carefusion Italy | Prot. n. 1774 del 06/02/2017 |
| Burke&Burke spa | Prot. n. 1772 del 06/02/2017 |
| Medigas Italia srl | Prot. n. 1805 del 06/02/2017 |
| Mindray Medical Italy srl | Prot. n. 1806 del 06/02/2017 |
| Air Liquide Medical Systems spa | Prot. n. 1807 del 06/02/2017 |
| Maquet Italia spa | Prot. n. 1810 del 06/02/2017 |
| Philips spa | Prot. n. 1811 del 06/02/2017 |
| GE Medical Systems Italia spa | Prot. n. 1801 del 06/02/2017 |

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità dei plichi pervenuti custoditi sino alla seduta odierna a cura del RUP in luogo chiuso a chiave, procede pertanto, ad aprire gli stessi che, come prescritto dalle norme di partecipazione, risultano contenere le buste sigillate previste dal disciplinare di gara contenenti la documentazione amministrativa (**busta 1**), la documentazione tecnica (**busta n. 2**) e l'offerta economica (**busta n. 3**).

All'apertura del plico presentato dalla Società Medigas Italia srl il Seggio di Gara riscontra la presenza, all'interno dello stesso, di n. 5 buste sigillate come di seguito identificate:

- busta documentazione amministrativa
- busta offerta tecnica Lotto 6
- busta offerta economica Lotto 6
- busta offerta economica Lotto 4
- busta offerta economica Lotto 4

Pertanto, in relazione al Lotto 4, risultano presenti due buste identificate "offerta economica" e nessuna busta identificata quale "offerta tecnica". Il Seggio di Gara, preso atto dell'accaduto, ritiene di escludere la Società Medigas Italia srl dal prosieguo della procedura di gara in relazione al Lotto 4 (ventilatori polmonari per pneumologia). Viene invece ammessa, in quanto regolarmente presentata, l'offerta relativa al Lotto 6 (C-PAP per degenza).

Il Presidente informa i convenuti che per ciascuna ditta sono state predisposte apposite schede, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, riportanti un elenco della documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare di gara (busta n. 1). Si procederà al raffronto di tali schede con la documentazione presentata dalle ditte. Sulle schede predisposte il Presidente appunterà negli appositi spazi, dopo che il Seggio avrà esperito la verifica documentale, la conformità della documentazione inviata a quella richiesta dal disciplinare di gara.

Il Presidente procede pertanto all'apertura delle sole buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare la sussistenza della documentazione presentata dalle ditte partecipanti in accordo alle prescrizioni del Disciplinare di gara.

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)

tel. 010 548 8562/ 8563

PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

Sito web: www.acquistiliguria.it

La verifica della sussistenza della documentazione amministrativa ha stabilito che la stessa è stata **regolarmente** confermata per tutti i sopraindicati offerenti che risultano pertanto tutti ammessi al prosieguo della gara, ad esclusione della Società Medigas Italia srl esclusa relativamente al Lotto 4 per i motivi sopra esposti.

Le buste contenenti le offerte economiche vengono raccolte in due plichi differenti, opportunamente chiusi e vistati sui lembi di chiusura dal Presidente del seggio di gara, dall'Ufficiale Rogante e dai rappresentanti delle Ditte:

- plico n. 1 contenente le offerte economiche presentate da tutte le Ditte ammesse al prosieguo della procedura di gara;
- plico n. 2: contenente le due buste identificate come "offerta economica Lotto 4" presentate dalla Società Medigas Italia srl.

Entrambi i plichi saranno riposti per la conservazione in armadio con serratura collocato in luogo chiuso.

Le buste contenenti la documentazione tecnica saranno successivamente esaminate dalla Commissione giudicatrice che provvederà preliminarmente alla verifica, in seduta pubblica, della conformità della documentazione inviata rispetto a quella richiesta dal Disciplinare di gara.

Esse vengono anch'esse riposte in un armadio chiuso situato in ambiente provvisto di serratura.

In chiusura di seduta viene riepilogata la situazione dei Lotti partecipati, sintetizzata nello schema seguente:

| Società/Lotti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Air Liquid Medical Systems spa | | | | | X | | | | | | |
| Burke&Burke spa | | | X | X | X | | | X | | | |
| Carefusion Italy | | | | X | | | | | | | |
| Drager Medical Italia spa | X | X | X | X | | | | X | X | X | X |
| GE Medical Systems Italia spa | X | X | X | | | | | | | X | |
| Maquet Italia spa | X | X | X | | | | | | | X | |
| Medigas Italia spa | | | | | | X | | | | | |
| Medtronic Italia spa | | | X | X | | | | | | X | |
| Mindray Medical Italy srl | | X | | X | | | | | | | |
| Philips spa | | | | X | | | | | | | |

Viene, pertanto dato atto della non aggiudicazione del lotto 7 (C-PAP ad alto flusso per pazienti IRA) per mancanza di offerte.

La seduta è tolta alle ore 12:30.


Letto, confermato e sottoscritto.

• **Presidente :**

Dott. Luigi Moreno Costa

• **Componente Segretario**

Dott.ssa Tiziana Tazzoli

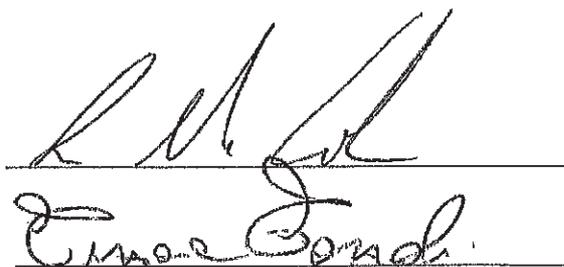

- **Componente:**

Dott.ssa Francesca Ella

Francesca Ella

- **L'Ufficiale Rogante:**

Dott. Luigi Tomel

Luigi Tomel

www.alsa.liguria.it

DITTA: MEDTRONIC ITALIA SPA

Lotti partecipati: 3, 4, 10

| a) Istanza di partecipazione alla gara, come da modello allegato (Allegato F1). | CONFORME | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------|----------------|----------|----------|
| <p>b) Documento di gara unico europeo (DGUE). Dovranno essere compilate le seguenti parti:</p> <p>Parte II: A: Informazioni sull'operatore economico. B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico. C: Informazioni sull'affidamento ("avvalimento") sulle capacità di altri soggetti. D: Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento.</p> <p>Parte III: A: Motivi legati a condanne penali. B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali. C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali. D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.</p> <p>Parte IV: A: Idoneità. B: Capacità economica e finanziaria (1a, 1b, 2a, 2b, 3) Nel documento deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2013- 2015. L'ammissione alla gara è condizionata, salve le ipotesi di cui all'art. 83 comma 4 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, alla esistenza nel triennio 2013-2015, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ di un fatturato medio annuale globale di impresa pari almeno a 1,5 volte; ✓ di un fatturato medio annuale specifico, nel "settore oggetto di gara", almeno pari. C: Capacità tecniche e professionali (1b, 5, 10, 11) D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.</p> | CONFORME | | | | | | | | |
| c) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fidejussione, valida per 230 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta nella misura quantificata nel Disciplinare di gara. | PRESENTE CON RIDUZIONE 50% CERTIFICAZIONE ISO + 20% CERTIFICAZIONE AMBIENTALE | | | | | | | | |
| d) Dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. | PRESENTE | | | | | | | | |
| <p>e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:</p> <table border="1" data-bbox="295 1742 1010 1874"> <thead> <tr> <th>Lotto</th> <th>Codice CIG</th> <th>Importo triennale lotto (esclusa IVA)</th> <th>Importo contributo (espresso in euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>6928028590</td> <td>€ 1.715.000,00</td> <td>€ 140,00</td> </tr> </tbody> </table> | Lotto | Codice CIG | Importo triennale lotto (esclusa IVA) | Importo contributo (espresso in euro) | 3 | 6928028590 | € 1.715.000,00 | € 140,00 | PRESENTE |
| Lotto | Codice CIG | Importo triennale lotto (esclusa IVA) | Importo contributo (espresso in euro) | | | | | | |
| 3 | 6928028590 | € 1.715.000,00 | € 140,00 | | | | | | |

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15 16121 Genova (GE)
Sede operativa Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
C.F./P. IVA 02421770997

tel. 010 548 4162
tel. 010 548 8562 8563

PEC: protocollo@pec.alsa.liguria.it

ST *GE* *08* *16*

www.alisa.liguria.it

| | | | | |
|--|------------|--------------|--------|---------------------------------|
| 4 | 6928045398 | € 135.000,00 | ESENTE | |
| 10 | 6928079FA3 | € 140.000,00 | ESENTE | |
| f) Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico; il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema. | | | | PRESENTE 9341-2986-7960-4227 |
| g) Documenti relativi all'affidamento (i.e. "avvalimento") Contratto di avvalimento DGUE ausiliaria _____ | | | | NO AVVALIMENTO |
| h) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta | | | | PRESENTE |
| i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata. | | | | PRESENTE |
| j) CD-ROM (non riscrivibile) contenente tutta la documentazione di cui sopra salvata in formato PDF, oltre a una copia dei modelli F1, F3, salvata in formato editabile dall'offerente; nel CD-ROM dovrà altresì essere allegata la copia, in formato PDF, di un valido documento d'identità del sottoscrittore dell'offerta. | | | | PRESENTE |

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15 16121 Genova (GE)
Sede operativa Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
C.F. / P. IVA 02421770997

tel. 010 548 4162
tel. 010 548 8562 8563

PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

www.alisa.liguria.it

DITTA: MINDRAY MEDICAL ITALY SRL

Lotti partecipati: 2-4

| <p>a) Istanza di partecipazione alla gara, come da modello allegato (Allegato F1).</p> | <p>CONFORME</p> | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <p>b) Documento di gara unico europeo (DGUE). Dovranno essere compilate le seguenti parti:</p> <p>Parte II: A: Informazioni sull'operatore economico. B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico. C: Informazioni sull'affidamento ("avvalimento") sulle capacità di altri soggetti. D: Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento.</p> <p>Parte III: A: Motivi legati a condanne penali. B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali. C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali. D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.</p> <p>Parte IV: A: Idoneità. B: Capacità economica e finanziaria (1a, 1b, 2a, 2b, 3) Nel documento deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2013- 2015. L'ammissione alla gara è condizionata, salve le ipotesi di cui all'art. 83 comma 4 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, alla esistenza nel triennio 2013-2015, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta: ✓ di un fatturato medio annuale globale di impresa pari almeno a 1,5 volte; ✓ di un fatturato medio annuale specifico, nel "settore oggetto di gara", almeno pari. C: Capacità tecniche e professionali (1b, 5, 10, 11) D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.</p> | <p>CONFORME</p> | | | | | | | | |
| <p>c) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 230 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta nella misura quantificata nel Disciplinare di gara.</p> | <p>PRESENTE CON RIDUZIONE 50% CERTIFICAZIONE ISO</p> | | | | | | | | |
| <p>d) Dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.</p> | <p>PRESENTE</p> | | | | | | | | |
| <p>e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 265, per i seguenti importi:</p> <table border="1" data-bbox="300 1771 1013 1870"> <thead> <tr> <th data-bbox="300 1771 391 1870">Lotto</th> <th data-bbox="391 1771 566 1870">Codice CIG</th> <th data-bbox="566 1771 790 1870">Importo triennale lotto (esclusa IVA)</th> <th data-bbox="790 1771 1013 1870">Importo contributo (espresso in Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Lotto | Codice CIG | Importo triennale lotto (esclusa IVA) | Importo contributo (espresso in Euro) | | | | | <p>PRESENTE</p> |
| Lotto | Codice CIG | Importo triennale lotto (esclusa IVA) | Importo contributo (espresso in Euro) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15 16121 Genova (GE)
Sede operativa Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
C.F. / P. IVA 02421770997

tel. 010 548 4162
tel. 010 548 8562 8563

PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

[Handwritten signatures and initials]

www.alisa.liguria.it

| | | | | | |
|--|---|------------|--------------|---------|--------------------------------|
| | 2 | 6928019E20 | € 280.000,00 | € 20,00 | |
| | 4 | 6928045398 | € 135.000,00 | ESENTE | |
| f) Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico; Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema. | | | | | PRESENTE 3275-114194-985668 |
| g) Documenti relativi all'affidamento (i.e. "avvalimento") Contratto di avvalimento DGUE ausiliaria _____ | | | | | NO AVVALIMENTO |
| h) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta | | | | | PRESENTE |
| i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata. | | | | | PRESENTE |
| j) CD-ROM (non riscrivibile) contenente tutta la documentazione di cui sopra salvata in formato PDF, oltre a una copia dei modelli F1, F3, salvata in formato editabile dall'offerente; nel CD-ROM dovrà altresì essere allegata la copia, in formato PDF, di un valido documento d'identità del sottoscrittore dell'offerta. | | | | | PRESENTE |

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15 16121 Genova (GE)
Sede operativa Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
C.F. / P. IVA 02421770997

tel. 010 548 4162
tel. 010 548 8562 8563

PEC: protocollo@pec.alisalliguria.it

Handwritten signatures and initials:





www.alisa.liguria.it

DITTA: MEDIGAS ITALIA SRL

Lotti partecipati: 4-6. All'apertura del plico si rileva che sono presenti due buste identificate quale "offerta economica Lotto 4" e nessuna busta identificata quale offerta tecnica Lotto 4. Sono invece presenti la busta identificata "documentazione amministrativa", la busta identificata "offerta tecnica Lotto 6" e la busta identificata "offerta economica Lotto 6"

| | |
|--|----------|
| a) Istanza di partecipazione alla gara, come da modello allegato (Allegato F1). | CONFORME |
| <p>b) Documento di gara unico europeo (DGUE). Dovranno essere compilate le seguenti parti:</p> <p>Parte II: A: Informazioni sull'operatore economico. B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico. C: Informazioni sull'affidamento ("avvalimento") sulle capacità di altri soggetti. D: Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento.</p> <p>Parte III: A: Motivi legati a condanne penali. B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali. C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali. D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.</p> <p>Parte IV: A: Idoneità. B: Capacità economica e finanziaria (1a, 1b, 2a, 2b, 3) Nel documento deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2013- 2015. L'ammissione alla gara è condizionata, salve le ipotesi di cui all'art. 83 comma 4 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, alla esistenza nel triennio 2013-2015, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta: ✓ di un fatturato medio annuale globale di impresa pari almeno a 1,5 volte; ✓ di un fatturato medio annuale specifico, nel "settore oggetto di gara", almeno pari. C: Capacità tecniche e professionali (1b, 5, 10, 11) D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.</p> | CONFORME |
| c) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fidejussione, valida per 230 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta nella misura quantificata nel Disciplinare di gara. | PRESENTE |
| d) Dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. | PRESENTE |
| e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi: | |

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15 16121 Genova (GE)
Sede operativa Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
C.F. / P. IVA 02421770997

tel. 010 548 4162
tel. 010 548 8562 8563

PEC: protocollo@pec.alisalliguria.it

www.alisa.liguria.it

| lotto | Codice CIG | Importo triennale lotto (esclusa IVA) | Importo contributo (espresso in Euro) | |
|---|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 4 | 6928045398 | € 135.000,00 | ESENTE | ESENTE |
| 6 | 6928060FF5 | € 15.200,00 | ESENTE | |
| <p>f) Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico; il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema.</p> | | | | PRESENTE 9725-6233-4900-6921 |
| <p>g) Documenti relativi all'affidamento (i.e. "avvalimento") Contratto di avvalimento DGUE ausiliaria</p> | | | | NO AVVALIMENTO |
| h) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta | | | | PRESENTE |
| i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata. | | | | PRESENTE |
| j) CD-ROM (non riscrivibile) contenente tutta la documentazione di cui sopra salvata in formato PDF, oltre a una copia dei modelli F1, F3, salvata in formato editabile dall'offerente; nel CD-ROM dovrà altresì essere allegata la copia, in formato PDF, di un valido documento d'identità del sottoscrittore dell'offerta. | | | | PRESENTE |

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15 16121 Genova (GE)
Sede operativa Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
C.F./P. IVA 02421770997

tel. 010 548 4162
tel. 010 548 8562 8563

PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

LT FE 80 h

www.allsa.liguria.it

DITTA: AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA

Lotti partecipati: 5

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------|--|
| a) Istanza di partecipazione alla gara, come da modello allegato (Allegato F1). | CONFORME | | | | |
| <p>b) Documento di gara unico europeo (DGUE). Dovranno essere compilate le seguenti parti:</p> <p>Parte II: A: Informazioni sull'operatore economico. B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico. C: Informazioni sull'affidamento ("avvalimento") sulle capacità di altri soggetti. D: Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento.</p> <p>Parte III: A: Motivi legati a condanne penali. B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali. C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali. D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.</p> <p>Parte IV: A: Idoneità. B: Capacità economica e finanziaria (1a, 1b, 2a, 2b, 3) Nel documento deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2013- 2015. L'ammissione alla gara è condizionata, salve le ipotesi di cui all'art. 83 comma 4 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, alla esistenza nel triennio 2013-2015, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ di un fatturato medio annuale globale di impresa pari almeno a 1,5 volte; ✓ di un fatturato medio annuale specifico, nel "settore oggetto di gara", almeno pari. C: Capacità tecniche e professionali (1b, 5, 10, 11) D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.</p> | CONFORME | | | | |
| c) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fidejussione, valida per 230 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta nella misura quantificata nel Disciplinare di gara. | PRESENTE CON RIDUZIONE 50% CERTIFICAZIONE ISO | | | | |
| d) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. | PRESENTE | | | | |
| e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi: | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Lotto</td> <td>Codice CIG</td> <td>Importo triennale</td> <td>Importo</td> </tr> </table> | Lotto | Codice CIG | Importo triennale | Importo | |
| Lotto | Codice CIG | Importo triennale | Importo | | |

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15 16121 Genova (GE)
Sede operativa Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
C.F. / P. IVA 02421770997

tel. 010 548 4162
tel. 010 548 8562 8563

PEC: protocollo@pec.allsaliguria.it






www.alisa.liguria.it

| | | lotto (esclusa IVA) | contributo (espresso in Euro) | |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 5 | 6928054B03 | € 170.000,00 | € 20,00 | PRESENTE |
| f) Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico; il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema. | | | | PRESENTE 9341-2986-7960-4227 |
| g) Documenti relativi all'affidamento (i.e. "avvalimento") Contratto di avvalimento DGUE ausiliaria _____ | | | | NO AVVALIMENTO |
| h) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta | | | | PRESENTE |
| i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata. | | | | PRESENTE |
| j) CD-ROM (non riscrivibile) contenente tutta la documentazione di cui sopra salvata in formato PDF, oltre a una copia dei modelli F1, F3, salvata in formato editabile dall'offerente; nel CD-ROM dovrà altresì essere allegata la copia, in formato PDF, di un valido documento d'identità del sottoscrittore dell'offerta. | | | | PRESENTE |

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15 16121 Genova (GE)
Sede operativa Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
C.F. / P. IVA 02421770997

tel. 010 548 4162
tel. 010 548 8562 8563

PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

www.alisa.liguria.it

DITTA: PHILIPS SPA

Lotti partecipati: 4

| | |
|--|---|
| a) Istanza di partecipazione alla gara, come da modello allegato (Allegato F1). | CONFORME |
| <p>b) Documento di gara unico europeo (DGUE). Dovranno essere compilate le seguenti parti:</p> <p>Parte II: A: Informazioni sull'operatore economico. B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico. C: Informazioni sull'affidamento ("avvalimento") sulle capacità di altri soggetti. D: Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento.</p> <p>Parte III: A: Motivi legati a condanne penali. B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali. C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali. D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.</p> <p>Parte IV: A: Idoneità. B: Capacità economica e finanziaria (1a, 1b, 2a, 2b, 3) Nel documento deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2013- 2015. L'ammissione alla gara è condizionata, salve le ipotesi di cui all'art. 83 comma 4 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, alla esistenza nel triennio 2013-2015, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ di un fatturato medio annuale globale di impresa pari almeno a 1,5 volte; ✓ di un fatturato medio annuale specifico, nel "settore oggetto di gara", almeno pari. C: Capacità tecniche e professionali (1b, 5, 10, 11) D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.</p> | CONFORME |
| c) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fidejussione, valida per 230 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta nella misura quantificata nel Disciplinare di gara. | PRESENTE CON RIDUZIONE 50% CERTIFICAZIONE ISO |
| d) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. | PRESENTE |
| e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi: | |

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15 16121 Genova (GE)
Sede operativa Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
C.F./P. IVA 02421770997

tel. 010 548 4162
tel. 010 548 8562 8563

PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

www.alisa.liguria.it

| Lotto | Codice CIG | Importo triennale lotto (esclusa IVA) | Importo contributo (espresso in Euro) | |
|--|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 4 | 6928045398 | € 135.000,00 | ESENTE | PRESENTE |
| f) Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico; il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema. | | | | PRESENTE 8832-8363-2939-8697 |
| g) Documenti relativi all'affidamento (i.e. "avvalimento") Contratto di avvalimento DGUE ausiliaria _____ | | | | NO AVVALIMENTO |
| h) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta | | | | PRESENTE |
| i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata. | | | | PRESENTE |
| j) CD-ROM (non riscrivibile) contenente tutta la documentazione di cui sopra salvata in formato PDF, oltre a una copia dei modelli F1, F3, salvata in formato editabile dall'offerente; nel CD-ROM dovrà altresì essere allegata la copia, in formato PDF, di un valido documento d'identità del sottoscrittore dell'offerta. | | | | PRESENTE |

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15 16121 Genova (GE)
Sede operativa Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
C.F. / P. IVA 02421770997

tel. 010 548 4162
tel. 010 548 8562 8563

PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

lt OO FE e

www.alisa.liguria.it

DITTA: CARE FUSION ITALY

Lotti partecipati: 4

| | |
|--|----------|
| a) Istanza di partecipazione alla gara, come da modello allegato (Allegato F1). | CONFORME |
| <p>b) Documento di gara unico europeo (DGUE). Dovranno essere compilate le seguenti parti:</p> <p>Parte II: A: Informazioni sull'operatore economico. B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico. C: Informazioni sull'affidamento ("avvalimento") sulle capacità di altri soggetti. D: Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento.</p> <p>Parte III: A: Motivi legati a condanne penali. B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali. C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali. D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.</p> <p>Parte IV: A: Idoneità. B: Capacità economica e finanziaria (1a, 1b, 2a, 2b, 3) Nel documento deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2013- 2015. L'ammissione alla gara è condizionata, salve le ipotesi di cui all'art. 83 comma 4 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, alla esistenza nel triennio 2013-2015, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ di un fatturato medio annuale globale di impresa pari almeno a 1,5 volte; ✓ di un fatturato medio annuale specifico, nel "settore oggetto di gara", almeno pari. C: Capacità tecniche e professionali (1b, 5, 10, 11) D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.</p> | CONFORME |
| c) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fidejussione, valida per 230 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta nella misura quantificata nel Disciplinare di gara. | PRESENTE |
| d) Dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. | PRESENTE |

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15 16121 Genova (GE)
Sede operativa Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
C.F. / P. IVA 02421770997

tel. 010 548 4162
tel. 010 548 8562 8563

PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

www.alisa.liguria.it

| <p>e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lotto</th> <th>Codice CIG</th> <th>Importo triennale lotto (esclusa IVA)</th> <th>Importo contributo (espresso in Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>6928045398</td> <td>€ 135.000,00</td> <td>ESENTE</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Lotto | Codice CIG | Importo triennale lotto (esclusa IVA) | Importo contributo (espresso in Euro) | 4 | 6928045398 | € 135.000,00 | ESENTE | PRESENTE |
|--|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------|--------------|--------|----------|
| Lotto | Codice CIG | Importo triennale lotto (esclusa IVA) | Importo contributo (espresso in Euro) | | | | | | | | | |
| 4 | 6928045398 | € 135.000,00 | ESENTE | | | | | | | | | |
| <p>f) Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico; il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema.</p> | | | | PRESENTE 4930-3170-5180-5942 | | | | | | | | |
| <p>g) Documenti relativi all'affidamento (i.e. "avvalimento") Contratto di avvalimento DGUE ausiliaria _____</p> | | | | NO AVVALIMENTO | | | | | | | | |
| <p>h) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta</p> | | | | PRESENTE | | | | | | | | |
| <p>i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.</p> | | | | PRESENTE | | | | | | | | |
| <p>j) CD-ROM (non riscrivibile) contenente tutta la documentazione di cui sopra salvata in formato PDF, oltre a una copia dei modelli F1, F3, salvata in formato editabile dall'offerente; nel CD-ROM dovrà altresì essere allegata la copia, in formato PDF, di un valido documento d'identità del sottoscrittore dell'offerta.</p> | | | | PRESENTE | | | | | | | | |

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15 16121 Genova (GE)
Sede operativa Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
C.F. / P. IVA 02421770997

tel. 010 548 4162
tel. 010 548 8562 8563

PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

Handwritten signatures and initials

www.alisa.liguria.it

DITTA: BURKE&BURKE SPA

Lotti partecipati: 3,4,5,8

| | |
|---|--|
| a) Istanza di partecipazione alla gara, come da modello allegato (Allegato F1). | CONFORME |
| <p>b) Documento di gara unico europeo (DGUE). Dovranno essere compilate le seguenti parti:</p> <p>Parte II: A: Informazioni sull'operatore economico. B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico. C: Informazioni sull'affidamento ("avvallimento") sulle capacità di altri soggetti. D: Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento.</p> <p>Parte III: A: Motivi legati a condanne penali. B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali. C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali. D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.</p> <p>Parte IV: A: Idoneità. B: Capacità economica e finanziaria (1a, 1b, 2a, 2b, 3) Nel documento deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2013- 2015. L'ammissione alla gara è condizionata, salve le ipotesi di cui all'art. 83 comma 4 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, alla esistenza nel triennio 2013-2015, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta: ✓ di un fatturato medio annuale globale di impresa pari almeno a 1,5 volte; ✓ di un fatturato medio annuale specifico, nel "settore oggetto di gara", almeno pari. C: Capacità tecniche e professionali (1b, 5, 10, 11) D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.</p> | CONFORME |
| c) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fidejussione, valida per 230 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta nella misura quantificata nel Disciplinare di gara. | PRESENTE CON RIDUZIONE 50% CERTIFICAZIONE ISO |

www.alisa.liguria.it

| d) Dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. | PRESENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------|----------------|----------|---|------------|----------------|----------|---|------------|--------------|--------|---|------------|--------------|---------|---|------------|--------------|--------|--|
| e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi: | PRESENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lotto</th> <th>Codice CIG</th> <th>Importo triennale lotto (esclusa IVA)</th> <th>Importo contributo (espresso in Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>6928028590</td> <td>€ 1.715.000,00</td> <td>€ 140,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>6928028590</td> <td>€ 1.715.000,00</td> <td>€ 140,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>6928045398</td> <td>€ 135.000,00</td> <td>ESENTE</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>6928054803</td> <td>€ 170.000,00</td> <td>€ 20,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>6928070838</td> <td>€ 140.000,00</td> <td>ESENTE</td> </tr> </tbody> </table> | Lotto | Codice CIG | Importo triennale lotto (esclusa IVA) | Importo contributo (espresso in Euro) | 3 | 6928028590 | € 1.715.000,00 | € 140,00 | 3 | 6928028590 | € 1.715.000,00 | € 140,00 | 4 | 6928045398 | € 135.000,00 | ESENTE | 5 | 6928054803 | € 170.000,00 | € 20,00 | 8 | 6928070838 | € 140.000,00 | ESENTE | |
| Lotto | Codice CIG | Importo triennale lotto (esclusa IVA) | Importo contributo (espresso in Euro) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 6928028590 | € 1.715.000,00 | € 140,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 6928028590 | € 1.715.000,00 | € 140,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 6928045398 | € 135.000,00 | ESENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6928054803 | € 170.000,00 | € 20,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 6928070838 | € 140.000,00 | ESENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico; il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema. | PRESENTE 8684-5186-1458-8828 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) Documenti relativi all'affidamento (i.e. "avvalimento") Contratto di avvalimento DGUE ausiliaria _____ | NO AVVALIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta | PRESENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata. | PRESENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| j) CD-ROM (non riscrivibile) contenente tutta la documentazione di cui sopra salvata in formato PDF, oltre a una copia dei modelli F1, F3, salvata in formato editabile dall'offerente; nel CD-ROM dovrà altresì essere allegata la copia, in formato PDF, di un valido documento d'identità del sottoscrittore dell'offerta. | PRESENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15 16121 Genova (GE)
Sede operativa Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
C.F. / P. IVA 02421770997

tel. 010 548 4162
tel. 010 548 8562 8563

PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

15 88 FE

www.alisa.liguria.it

DITTA: GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA

Lotti partecipati: 1,2,3,10

| | |
|--|----------|
| a) Istanza di partecipazione alla gara, come da modello allegato (Allegato F1). | CONFORME |
| <p>b) Documento di gara unico europeo (DGUE). Dovranno essere compilate le seguenti parti:</p> <p>Parte II: A: Informazioni sull'operatore economico. B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico. C: Informazioni sull'affidamento ("avvalimento") sulle capacità di altri soggetti. D: Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento.</p> <p>Parte III: A: Motivi legati a condanne penali. B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali. C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali. D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.</p> <p>Parte IV: A: Idoneità. B: Capacità economica e finanziaria (1a, 1b, 2a, 2b, 3) Nel documento deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2013- 2015. L'ammissione alla gara è condizionata, salve le ipotesi di cui all'art. 83 comma 4 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, alla esistenza nel triennio 2013-2015, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ di un fatturato medio annuale globale di impresa pari almeno a 1,5 volte; ✓ di un fatturato medio annuale specifico, nel "settore oggetto di gara", almeno pari. <p>C: Capacità tecniche e professionali (1b, 5, 10, 11) D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.</p> | CONFORME |
| c) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fidejussione, valida per 230 giorni dalla | PRESENTE |

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15 16121 Genova (GE)
Sede operativa Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
C.F. / P. IVA 02421770997

tel. 010 548 4162
tel. 010 548 8562 8563

PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

LT 02 FE N

www.alisa.liguria.it

| data di scadenza di presentazione dell'offerta nella misura quantificata nel Disciplinare di gara. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------|----------------|----------|---|------------|----------------|----------|---|------------|--------------|---------|---|------------|----------------|----------|----|------------|--------------|--------|----------|
| d) Dichiarazione di impegno di un fidelussore a rilasciare la garanzia fidelussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. | PRESENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:</p> <table border="1" data-bbox="287 613 999 896"> <thead> <tr> <th>Lotto</th> <th>Codice CIG</th> <th>Importo triennale lotto (esclusa IVA)</th> <th>Importo contributo (espresso in Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>6928028590</td> <td>€ 1.715.000,00</td> <td>€ 140,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>692801392E</td> <td>€ 2.690.000,00</td> <td>€ 140,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>6928019E20</td> <td>€ 280.000,00</td> <td>€ 20,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>6928028590</td> <td>€ 1.715.000,00</td> <td>€ 140,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>6928079FA3</td> <td>€ 140.000,00</td> <td>ESENTE</td> </tr> </tbody> </table> | Lotto | Codice CIG | Importo triennale lotto (esclusa IVA) | Importo contributo (espresso in Euro) | 3 | 6928028590 | € 1.715.000,00 | € 140,00 | 1 | 692801392E | € 2.690.000,00 | € 140,00 | 2 | 6928019E20 | € 280.000,00 | € 20,00 | 3 | 6928028590 | € 1.715.000,00 | € 140,00 | 10 | 6928079FA3 | € 140.000,00 | ESENTE | PRESENTE |
| Lotto | Codice CIG | Importo triennale lotto (esclusa IVA) | Importo contributo (espresso in Euro) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 6928028590 | € 1.715.000,00 | € 140,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 692801392E | € 2.690.000,00 | € 140,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6928019E20 | € 280.000,00 | € 20,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 6928028590 | € 1.715.000,00 | € 140,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 6928079FA3 | € 140.000,00 | ESENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico; il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema. | PRESENTE 5831-2835-4908-4797 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) Documenti relativi all'affidamento (i.e. "avvalimento") Contratto di avvalimento DGUE ausiliaria _____ | NO AVVALIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta | PRESENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata. | PRESENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| j) CD-ROM (non riscrivibile) contenente tutta la documentazione di cui sopra salvata in formato PDF, oltre a una copia dei modelli F1, F3, salvata in formato editabile dall'offerente; nel CD-ROM dovrà altresì essere allegata la copia, in formato PDF, di un valido documento d'identità del sottoscrittore dell'offerta. | PRESENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

www.alisa.liguria.it

DITTA: DRAGER Medical Italia spa

Lotti partecipati: 1,2,3,4,8,9,10,11

| <p>a) Istanza di partecipazione alla gara, come da modello allegato (Allegato F1).</p> | <p>CONFORME</p> | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <p>b) Documento di gara unico europeo (DGUE). Dovranno essere compilate le seguenti parti:</p> <p>Parte II: A: Informazioni sull'operatore economico. B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico. C: Informazioni sull'affidamento ("avalimento") sulle capacità di altri soggetti. D: Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento.</p> <p>Parte III: A: Motivi legati a condanne penali. B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali. C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali. D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.</p> <p>Parte IV: A: Idoneità. B: Capacità economica e finanziaria (1a, 1b, 2a, 2b, 3) Nel documento deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2013- 2015. L'ammissione alla gara è condizionata, salve le ipotesi di cui all'art. 83 comma 4 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, alla esistenza nel triennio 2013-2015, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta: ✓ di un fatturato medio annuale globale di impresa pari almeno a 1,5 volte; ✓ di un fatturato medio annuale specifico, nel "settore oggetto di gara", almeno pari. C: Capacità tecniche e professionali (1b, 5, 10, 11) D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.</p> | <p>CONFORME</p> | | | | | | | | |
| <p>c) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fidejussione, valida per 230 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta nella misura quantificata nel Disciplinare di gara.</p> | <p>PRESENTE CON RIDUZIONE 50% CERTIFICAZIONE ISO</p> | | | | | | | | |
| <p>d) Dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.</p> | <p>PRESENTE</p> | | | | | | | | |
| <p>e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:</p> <table border="1" data-bbox="295 1765 1007 1865"> <thead> <tr> <th>Lotto</th> <th>Codice CIG</th> <th>Importo triennale lotto (esclusa IVA)</th> <th>Importo contributo (espresso in Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Lotto | Codice CIG | Importo triennale lotto (esclusa IVA) | Importo contributo (espresso in Euro) | | | | | <p>PRESENTE</p> |
| Lotto | Codice CIG | Importo triennale lotto (esclusa IVA) | Importo contributo (espresso in Euro) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15 16121 Genova (GE)
Sede operativa Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
C.F. / P. IVA 02421770997

tel. 010 548 4162
tel. 010 548 8562 8563

PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

Handwritten signatures and initials:
A large handwritten mark resembling a stylized 'L' or '5'.
Below it, the initials 'GE' and 'OC' are written, followed by a signature and another mark.

www.alisa.liguria.it

| | | | | |
|--|------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 1 | 692801392E | € 2.690.000,00 | € 140,00 | |
| 2 | 6928019E20 | € 280.000,00 | € 20,00 | |
| 3 | 6928028590 | € 1.715.000,00 | € 140,00 | |
| 4 | 6928045398 | € 135.000,00 | ESENTE | |
| 8 | 6928070838 | € 140.000,00 | ESENTE | |
| 9 | 6928074B84 | € 140.000,00 | ESENTE | |
| 10 | 6928079FA3 | € 140.000,00 | ESENTE | |
| 11 | 6928087640 | € 240.000,00 | € 20,00 | |
| f) Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico; il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema. | | | | PRESENTE 0111-9192-1860-3026 |
| g) Documenti relativi all'affidamento (i.e. "avvalimento") Contratto di avvalimento DGUE ausiliaria _____ | | | | NO AVVALIMENTO |
| h) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta | | | | PRESENTE |
| i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata. | | | | PRESENTE |
| j) CD-ROM (non riscrivibile) contenente tutta la documentazione di cui sopra salvata in formato PDF, oltre a una copia dei modelli F1, F3, salvata in formato editabile dall'offerente; nel CD-ROM dovrà altresì essere allegata la copia, in formato PDF, di un valido documento d'identità del sottoscrittore dell'offerta. | | | | PRESENTE |

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15 16121 Genova (GE)
Sede operativa Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
C.F. / P. IVA 02421770997

tel. 010 548 4162
tel. 010 548 8562 8563

PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

www.alisa.liguria.it

DITTA: MAQUET ITALIA SPA

Lotti partecipati: 1,2,3,10

| <p>k) Istanza di partecipazione alla gara, come da modello allegato (Allegato F1).</p> | <p>CONFORME</p> | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <p>l) Documento di gara unico europeo (DGUE). Dovranno essere compilate le seguenti parti:</p> <p>Parte II: A: Informazioni sull'operatore economico. B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico. C: Informazioni sull'affidamento ("avvallimento") sulle capacità di altri soggetti. D: Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento.</p> <p>Parte III: A: Motivi legati a condanne penali. B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali. C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali. D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.</p> <p>Parte IV: A: Idoneità. B: Capacità economica e finanziaria (1a, 1b, 2a, 2b, 3) Nel documento deve essere indicato il fatturato medio annuale realizzato nel triennio 2013- 2015. L'ammissione alla gara è condizionata, salve le ipotesi di cui all'art. 83 comma 4 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016, alla esistenza nel triennio 2013-2015, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta: ✓ di un fatturato medio annuale globale di impresa pari almeno a 1,5 volte; ✓ di un fatturato medio annuale specifico, nel "settore oggetto di gara", almeno pari. C: Capacità tecniche e professionali (1b, 5, 10, 11) D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.</p> | <p>CONFORME+DGUE SOCIO UNICO+DGUE TERNA SUB-APPALTATORI</p> <p>DICHIARA SUB-APPALTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHI LOTTO 1 NEL LIMITE DEL 10% DEL VALORE DELLA FORNITURA</p> | | | | | | | | |
| <p>m) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fidejussione, valida per 230 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta nella misura quantificata nel Disciplinare di gara.</p> | <p>PRESENTE CON RIDUZIONI 50% CERTIFICAZIONE ISO</p> | | | | | | | | |
| <p>n) Dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.</p> | <p>PRESENTE</p> | | | | | | | | |
| <p>o) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:</p> <table border="1" data-bbox="292 1783 1007 1877"> <thead> <tr> <th>Lotto</th> <th>codice CIG</th> <th>Importo triennale lotto (esclusa IVA)</th> <th>Importo contributo (espresso in Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Lotto | codice CIG | Importo triennale lotto (esclusa IVA) | Importo contributo (espresso in Euro) | | | | | <p>PRESENTE</p> |
| Lotto | codice CIG | Importo triennale lotto (esclusa IVA) | Importo contributo (espresso in Euro) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15 16121 Genova (GE)
Sede operativa Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
C.F./P. IVA 02421770997

tel. 010 548 4162
tel. 010 548 8562 8563

PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

[Handwritten signatures and initials]

www.allisa.liguria.it

| | | | | | |
|--|----|------------|----------------|----------|---|
| | 1 | 692801392E | € 2.690.000,00 | € 140,00 | |
| | 2 | 6928019E20 | € 280.000,00 | € 20,00 | |
| | 3 | 6928028590 | € 1.715.000,00 | € 140,00 | |
| | 10 | 6928079FA3 | € 140.000,00 | ESENTE | |
| p) Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico; il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema. | | | | | PRESENTE 4531-5947-2569-1352 Lotto 1 7390-9485-7976-6666 Lotto 2 5526-5319-9384-7759 Lotto 3 2164-8140-4297-7426 Lotto 10 |
| q) Documenti relativi all'affidamento (i.e. "avvalimento") Contratto di avvalimento DGUE ausiliaria _____ | | | | | NO AVVALIMENTO |
| r) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta | | | | | PRESENTE |
| s) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata. | | | | | PRESENTE |
| t) CD-ROM (non riscrivibile) contenente tutta la documentazione di cui sopra salvata in formato PDF, oltre a una copia dei modelli F1, F3, salvata in formato editabile dall'offerente; nel CD-ROM dovrà altresì essere allegata la copia, in formato PDF, di un valido documento d'identità del sottoscrittore dell'offerta. | | | | | PRESENTE |

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15 16121 Genova (GE)
Sede operativa Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
C.F. / P. IVA 02421770997

tel. 010 548 4162
tel. 010 548 8562 8563

PEC: protocollo@pec.allisaliguria.it

A.Li.Sa.**AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA**

C.F. / P. IVA 02421770997

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel.010/548-8561
 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
 Referente: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI - tel. 010/548-8559
 e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

**Procedura aperta ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016,
 per l'affidamento della fornitura di apparecchi per anestesia e
 ventilatori polmonari ad uso ospedaliero
 occorrenti alle aziende sanitarie liguri per un periodo di anni
 due (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) – Lotti n. 11.
 N° gara: 6621976**

Verbale di apertura delle buste delle offerte tecniche. Seduta pubblica.

Il giorno 06/04/2017, alle ore 10:02 presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 110 del 20/03/2017 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la verifica della sussistenza della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti ai fini dell'avvio delle procedure di valutazione della idoneità.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

| | | | |
|-----------|---------|---|--------------------------|
| GRATAROLA | Angelo | Direttore Dipartimento Emergenza ed Accettazione A.O./IRCCS San Martino/IST | in qualità di Presidente |
| PEZZATO | Stefano | Dirigente Medico S.C. Anestesia e Rianimazione IRCCS Gaslini | in qualità di Componente |
| BUCCHERI | Massimo | Direttore S.C. SIA Ingegneria Clinica ASL 5 Spezzina | in qualità di Componente |

E' presente il dott. Luigi Moreno Costa della Centrale, RUP della procedura, che assolve altresì alle funzioni di Ufficiale Rogante, assistito dalla Dott.ssa Tiziana Tazzoli, Collaboratore Amministrativo della Centrale.

La seduta è pubblica.

In rappresentanza delle Ditte offerenti sono presenti i Signori:

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64 16121 Genova (GE)
 tel. 010 548 8562/ 8563
 PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it
 Sito web: www.acquistiliguria.it

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

2 di 16

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------|
| Burke&Burke | Garofalo Alessandro | |
| Phillips spa | Violato Marco | |
| Drager | Campi Massimo | |
| Drager | Sartori Stefano | |
| GE | Puppo Alessandro | |
| GE | Pasotti Nadia | |
| Medigas Italia | Florato Italo | |
| Medigas Italia | Merlini Paola | |
| Medigas Italia | Cavanna Sergio | |
| Maquet | Di Carpegna Varini Massimiliano | |
| Air Liquide | De Serio Massimo | |
| Medtronic | Cottafori Marco | |
| Medtronic | Cucculin Roberto | |
| Medtronic | Giacolone Cristina | |
| Medtronic | Cerea Alessandro | |
| Mindray Medical Italia | Atzei Domenico | |
| CareFusion | Lanzone Andrea | |
| | Franco Fisher | uditore |

muniti delle necessarie procure (presentate in originale o in copia autenticata) acquisite atti di gara in caso di dichiarazioni da mettere a verbale.

Il RUP dà preliminarmente atto che nel corso della seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa svoltasi in data 9.2.2017, il Seggio di Gara aveva rilevato – relativamente all’offerta presentata dalla Società Medigas Italia srl per il Lotto 4 – la presenza di due plichi entrambi contrassegnati all’esterno con la dicitura “Offerta economica”. Il Seggio di Gara, appurato l’errore di identificazione dei plichi e non potendovi rimediare in tale sede non essendo presente alcun rappresentante della Società interessata (rif. verbale prot. n. 2406 del 15.2.2017), riteneva di escludere dalla procedura di gara l’offerta presentata dalla Società Medigas per il Lotto 4. Conseguentemente, al fine di preservare la segretezza delle offerte, il Seggio di Gara procedeva alla sigillazione separata dei plichi recanti le offerte economiche presentate dai concorrenti in gara (plico n. 1) e dei plichi erroneamente identificati dalla Società Medigas per il Lotto 4 (plico n. 2).

Successivamente, la Società Medigas Italia srl - con nota acquisita al protocollo generale A.Li.Sa n. 2531 del 16.2.2017 (All.to 2 al presente verbale) - comunicava alla Centrale di Acquisto di aver preso atto dell’esclusione dell’offerta presentata per il Lotto 4, dichiarava di essere assolutamente certa del contenuto dei plichi presentati e di poter procedere in qualunque momento alla corretta identificazione rispettivamente dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate per il Lotto 4 senza necessità di apertura dei plichi, chiedendo contestualmente la riammissione in gara.

Alla luce dell’istanza di riammissione formulata dalla Società Medigas Italia srl il RUP osserva che, in materia di irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara, l’ANAC ha più volte ribadito che esse legittimano l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara solamente laddove incidano sulla segretezza dell’offerta (es. incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, non integrità del plico o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi). In particolare, con riferimento alle modalità di presentazione

delle offerte, l'ANAC con Determinazione n. 1 dell'8/1/2015 ha affermato che: "la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse non legittima l'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorchè priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste; dovrebbe, inoltre, considerarsi sanabile l'omessa indicazione relativa al contenuto delle buste se alla medesima si possa ovviare con invito al concorrente a contrassegnarle senza necessità di apertura".

Alla luce dell'Istruttoria compiuta, considerato che l'errore di identificazione dei plichi compiuto dalla Società Medigas Italia srl non ha in alcun modo inficiato la segretezza dell'offerta ed appurata la presenza all'odierna seduta pubblica dei Sig.ri Italo Fiorato e Paola Merlini che intervengono quale Rappresentanti della Società Medigas Italia srl, il RUP ritiene di procedere nel modo seguente:

- aprire nell'odierna seduta pubblica il plico n. 2 recante le due buste entrambe identificate quali "Offerta economica Lotto 4" presentate dalla Società Medigas Italia srl;
- invitare i Sig.ri Italo Fiorato e Paola Merlini - Rappresentanti della Società Medigas Italia srl - a contrassegnare i due plichi identificando l'offerta tecnica e l'offerta economica, senza necessità di apertura;
- separare il plico identificato quale Offerta Economica Lotto 4 dal Plico identificato quale Offerta Tecnica Lotto 4;
- sigillare il plico contrassegnato quale Offerta Economica Lotto 4 insieme al Plico 1 contenente tutte le offerte economiche dei concorrenti in gara.

Preliminarmente il Sig. Marco Violato della Società Philips viene invitato a verificare l'integrità del Plico n. 2

Quindi, i Sig.ri Italo Fiorato e Paola Merlini responsabile dell'ufficio gare della Società Medigas Italia srl procedono ad identificare la busta contenente l'offerta tecnica del Lotto 4 apponendo la dicitura "Offerta Tecnica Lotto 4" e la relativa sottoscrizione autografa.

La Commissione procede ad aprire il plico identificato quale offerta offerta tecnica lotto 4 della Società Medigas Italia e verifica che effettivamente la busta così contrassegnata contiene la documentazione tecnica del Lotto 4.

La Società Medigas Italia srl viene, pertanto, riammessa alla procedura di gara per il Lotto 4.

La Commissione decide di passare all'esame della documentazione tecnica presentata dalle Ditte.

Il RUP puntualizza che le buste tecniche sono state custodite in armadio chiuso a chiave, in luogo chiuso. A questo punto il Presidente, invita le ditte a verificare l'integrità delle singole buste.

Il RUP e il Presidente della Commissione giudicatrice domandano ai presenti se hanno qualcosa da eccepire sull'esito della custodia dei plichi. I designati e gli altri presenti confermano l'integrità del plico e delle singole buste, nulla avendo da eccepire sugli esiti di custodia dei plichi.

Il RUP comunica che secondo quanto previsto dalla lex specialis la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche si svolge in seduta pubblica. Si procederà poi in seduta riservata alla valutazione delle relative offerte tecniche.

Il RUP ricorda ai presenti prende atto che il Disciplinare di gara ed i relativi allegati prevedono che la procedura verrà esperita con il sistema:

- dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponderando perciò l'elemento prezzo con i parametri di qualità definiti in sede di capitolato tecnico.

Prima di procedere all'apertura delle buste sigillate contenenti la documentazione tecnica il Presidente della Commissione illustra ai presenti le modalità di riscontro della documentazione tecnica. Saranno sommariamente confrontati gli atti presentati da ciascuna Ditta con l'elenco dei documenti tecnici allegato dalle medesime in parificazione all'elenco di documenti tecnici richiesto dal disciplinare di gara.

L'operazione non deve andare al di là del mero riscontro degli atti prodotti dall'impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto. E' ammessa la divulgazione della denominazione dei prodotti offerti.

Gli elenchi presentati dalle singole ditte saranno allegati al presente verbale.

La Commissione per razionalizzare i propri lavori stabilisce di effettuare la valutazione della documentazione, procedendo per singole offerte, e verificando le offerte tecniche pervenute nella seguente successione:

| Società | Ordine di verifica |
|-------------------|--------------------|
| Mediag Italia srl | 1 |
| Air Liquide | 2 |
| Drager | 3 |
| GE | 4 |
| Medtronic | 5 |
| Mindray Medical | 6 |
| Carefusion Italy | 7 |
| Philips | 8 |
| Maquet | 9 |
| Burke&Burke | 10 |

Il RUP ricorda ai presenti i documenti tecnici richiesti dal Disciplinare :

- scheda tecnica** in lingua italiana dei prodotti offerti, per ciascuno dei lotti partecipati, con chiara indicazione del lotto cui si fa riferimento corredata dai rispettivi **codici CND e n° di Registrazione Banca Dati**.
- dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti (Allegato F4);**
- copia della certificazione CE** (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). Nel caso di dispositivi medici, la Ditta dovrà inoltre specificare la **classe di appartenenza del prodotto** in base alla Direttiva CEE 93/42; **oppure dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento;**
- dichiarazione**, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono **segreti tecnici o commerciali**, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 53 comma 5 del D. Lgs. n° 50/2016;

- e. dichiarazione di disponibilità/Impegno a effettuare aggiornamenti tecnologici (allegato E)
- f. dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore;
- g. copia offerta economica dei prodotti offerti per ciascun lotto, **priva dei prezzi** (c.d "offerta silente");
- h. elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata, suddiviso per singolo lotto;
- i. **CD-ROM (non riscrivibile)** contenente tutta la documentazione di cui sopra salvata in formato PDF, **oltre una copia del modello F4 salvata in formato editabile dall'offerente**; nel CD-ROM dovrà altresì essere allegata la copia in formato PDF di un valido documento di identità del sottoscrittore dell'offerta.

Per comodità di cognizione dei presenti il RUP procede a riepilogare, lotto per lotto, le offerte ammesse all'apertura delle offerte tecniche:

| Società/Lotti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Air Liquid Medical Systems spa | | | | | X | | | | | | |
| Burke&Burke spa | | | X | X | X | | | X | | | |
| Carefusion Italy | | | | X | | | | | | | |
| Drager Medical Italia spa | X | X | X | X | | | | X | X | X | X |
| GE Medical Systems Italia spa | X | X | X | | | | | | | X | |
| Maquet Italia spa | X | X | X | | | | | | | X | |
| Medigas Italia spa | | | | X | | X | | | | | |
| Medtronic Italia spa | | | X | X | | | | | | X | |
| Mindray Medical Italy srl | | X | | X | | | | | | | |
| Philips spa | | | | X | | | | | | | |

Il Presidente della Commissione giudicatrice procede:

- all'apertura delle buste contenenti le documentazioni tecniche secondo ordine alfabetico
- alla verifica della presenza di tutti i documenti contenuti negli elenchi predisposti dalle Ditte offerenti

Dall'esame del contenuto delle offerte tecniche è emerso che tutte le Ditte partecipanti hanno presentato documentazione tecnica conforme a quanto richiesto dai documenti di gara.

L'esito della verifica è riportato nelle schede allegata al presente verbale (Allegato 1).

Si da atto che i Sig.ri Campi Massimo e Sartori Stefano lasciano la seduta alle ore 11:40.

Terminata la verifica dei fascicoli contenuti nelle offerte tecniche le stesse vengono raccolte in un plico opportunamente chiuso e vistato sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione giudicatrice.

In chiusura di seduta il RUP e la Commissione Giudicatrice procedono a sigillare l'offerta economica relativa al Lotto 4 della Società Medigas Italia srl insieme al Plico n. 1 (rimasto sigillato) contenente le offerte

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

6 di 16


economiche di tutte le Ditte ed a siglare il nuovo Plico sigillato, invitano i Rappresentanti intervenuti delle Ditte concorrenti a fare altrettanto.

Plichi e scatole vengono consegnati ai rappresentanti della Centrale per la custodia in armadio provvisto di serratura collocato in luogo chiuso.

La seduta è tolta alle ore 12:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Presidente: | Dott. Angelo Gratarola |
| Componente: | Dott. Stefano Pezzato |
| Componente: | Ing. Massimo Buccheri |
| Ufficiale Rogante: | Dott. Luigi Moreno Costa |
| Segretario | Dott.ssa Tiziana Tazzoli |

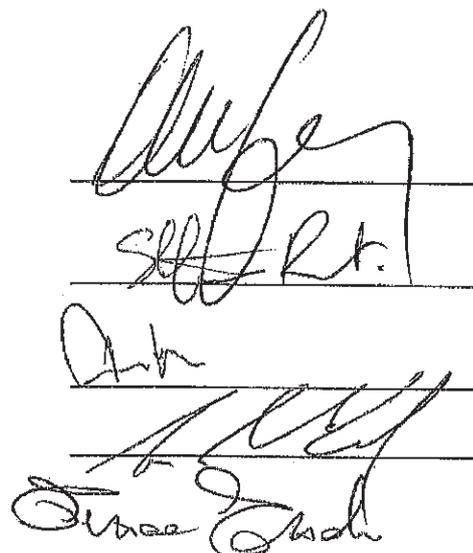

ALLEGATO 1

GARA N. 6621976 -SCHEDA VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------|
| SOCIETA': | AIR LIQUID MEDICAL SYSTEMS SPA | |
| LOTTI PARTECIPATI: | 5 | |
| PRODOTTO OFFERTO: | MONNAL T60 | |
| LOTTO 5: | | |
| CONTENUTO OFFERTA TECNICA: | CONFORMITA' | NOTE |
| a) scheda tecnica prodotti offerti con codice CND | SI | |
| b) dichiarazione allegato F4 | SI | |
| c) copia della certificazione CEE e/ conformità alle Direttive CEE | SI | |
| d) dichiarazione di presenza/assenza di segreti tecnici e/o commerciali | PRESENTE | |
| e) dichiarazione di disponibilità all'aggiornamento tecnologico | SI | |
| f) dichiarazione ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore | SI | |
| g) copia offerta economica dei prodotti offerti priva dei prezzi (c.d. offerta economica silente) | SI | |
| h) elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata suddiviso per lotto | SI | |
| i) CD/DVD contenente tutta la documentazione tecnica presentata in formato PDF | SI | |

RELAZIONE ASSISTENZA TECNICA
PIANO DI FORMAZIONE

GARA N. 6621976 -SCHEDA VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

| | | |
|---|----------------------------|-------------|
| SOCIETA': | BURKE&BURKE spa | |
| LOTTE PARTECIPATI: | 3, 4, 5, 8 | |
| PRODOTTO OFFERTO: | | |
| LOTTO 3: | HAMILTON G5 | |
| LOTTO 4: | HAMILTON C3 | |
| LOTTO 5: | HAMILTON T1 | |
| LOTTO 8: | FABIAN HFOI | |
| CONTENUTO OFFERTA TECNICA: | CONFORMITA' | NOTE |
| a) scheda tecnica prodotti offerti con codice CND | SI | |
| b) dichiarazione allegato F4 | SI | |
| c) copia della certificazione CEE e/ conformità alle Direttive CEE | SI | |
| d) dichiarazione di presenza/assenza di segreti tecnici e/o commerciali | PRESENTE | |
| e) dichiarazione di disponibilità all'aggiornamento tecnologico | SI | |
| f) dichiarazione ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore | SI | |
| g) copia offerta economica dei prodotti offerti priva dei prezzi (c.d. offerta economica silente) | SI | |
| h) elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata suddiviso per lotto | SI | |
| i) CD/DVD contenente tutta la documentazione tecnica presentata in formato PDF | SI | |

RELAZIONE ASSISTENZA TECNICA
PIANO DI FORMAZIONE

GARA N. 6621976 -SCHEDA VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

| | | |
|---|---------------------------|-------------|
| SOCIETA': | CAREFUSION ITALY | |
| LOTTE PARTECIPATI: | 4 | |
| PRODOTTO OFFERTO: | | |
| LOTTO 4: | IX 5 COMPREHENSIVE | |
| CONTENUTO OFFERTA TECNICA: | CONFORMITA' | NOTE |
| a) scheda tecnica prodotti offerti con codice CND | SI | |
| b) dichiarazione allegato F4 | SI | |
| c) copia della certificazione CEE e/ conformità alle Direttive CEE | SI | |
| d) dichiarazione di presenza/assenza di segreti tecnici e/o commerciali | PRESENTE | |
| e) dichiarazione di disponibilità all'aggiornamento tecnologico | SI | |
| f) dichiarazione ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore | SI | |
| g) copia offerta economica dei prodotti offerti priva dei prezzi (c.d. offerta economica silente) | SI | |
| h) elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata suddiviso per lotto | SI | |
| i) CD/DVD contenente tutta la documentazione tecnica presentata in formato PDF | SI | |

RELAZIONE ASSISTENZA TECNICA
PIANO DI FORMAZIONE

GARA N. 6621976 -SCHEDA VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

| | | |
|---|------------------------------------|-------------|
| SOCIETA': | DRAGER MEDICAL ITALIA spa | |
| LOTTE PARTECIPATI: | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 | |
| PRODOTTO OFFERTO: | ZEUS IE + MONITORAGGI | |
| LOTTO 1: | PRIMUS 2002 | |
| LOTTO 2: | INFINITY EVITA V500 | |
| LOTTO 3: | SAVINA 300 | |
| LOTTO 4: | BABYLOG VN 500 | |
| LOTTO 8: | EVITA V500 | |
| LOTTO 9: | EVITA V500 | |
| LOTTO 10: | PERSEUS A500 + MONITORAGGIO | |
| LOTTO 11: | | |
| CONTENUTO OFFERTA TECNICA: | CONFORMITA' | NOTE |
| a) scheda tecnica prodotti offerti con codice CND | SI | |
| b) dichiarazione allegato F4 | SI | |
| c) copia della certificazione CEE e/ conformità alle Direttive CEE | SI | |
| d) dichiarazione di presenza/assenza di segreti tecnici e/o commerciali | PRESENTE | |
| e) dichiarazione di disponibilità all'aggiornamento tecnologico | SI | |
| f) dichiarazione ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore | SI | |
| g) copia offerta economica dei prodotti offerti priva dei prezzi (c.d. offerta economica silente) | SI | |
| h) elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata suddiviso per lotto | SI | |
| i) CD/DVD contenente tutta la documentazione tecnica presentata in formato PDF | SI | |

RELAZIONE ASSISTENZA TECNICA
PIANO DI FORMAZIONE

GARA N. 6621976 -SCHEDA VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

| | | |
|---|--|-------------|
| SOCIETA': | GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA spa | |
| LOTTE PARTECIPATI: | 1, 2, 3, 10 | |
| PRODOTTO OFFERTO: | AYSIS CS 2 + MONITORAGGI | |
| LOTTO 1: | CARESTATION 650 + MONITORAGGIO E-SCALE | |
| LOTTO 2: | CARESCAPE R860 | |
| LOTTO3: | CARESCAPE R860 | |
| LOTTO 10: | CARESCAPE R860 | |
| CONTENUTO OFFERTA TECNICA: | CONFORMITA' | NOTE |
| a) scheda tecnica prodotti offerti con codice CND | SI | |
| b) dichiarazione allegato F4 | SI | |
| c) copia della certificazione CEE e/ conformità alle Direttive CEE | SI | |
| d) dichiarazione di presenza/assenza di segreti tecnici e/o commerciali | PRESENTE | |
| e) dichiarazione di disponibilità all'aggronamento tecnologico | SI | |
| f) dichiarazione ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore | SI | |
| g) copia offerta economica dei prodotti offerti priva dei prezzi (c.d. offerta economica silente) | SI | |
| h) elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata suddiviso per lotto | SI | |
| i) CD/DVD contenente tutta la documentazione tecnica presentata in formato PDF | SI | |

RELAZIONE ASSISTENZA TECNICA
PIANO DI FORMAZIONE

GARA N. 6621976 -SCHEDA VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

| | | |
|---|--|-------------|
| SOCIETA': | MAQUET ITALIA spa | |
| LOTTE PARTECIPATI: | 1, 2, 3, 10 | |
| PRODOTTO OFFERTO: | FLOW-i C20 + PHILIPS MX550+ MONITORAGGI | |
| LOTTO 1: | FLOW-i C20 + MONITORAGGIO | |
| LOTTO 2: | SERVO-U | |
| LOTTO 3: | SERVO-U | |
| LOTTO 10: | SERVO-U | |
| CONTENUTO OFFERTA TECNICA: | CONFORMITA' | NOTE |
| a) scheda tecnica prodotti offerti con codice CND | SI | |
| b) dichiarazione allegato F4 | SI | |
| c) copia della certificazione CEE e/ conformità alle Direttive CEE | SI | |
| d) dichiarazione di presenza/assenza di segreti tecnici e/o commerciali | PRESENTE | |
| e) dichiarazione di disponibilità all'aggiornamento tecnologico | SI | |
| f) dichiarazione ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore | SI | |
| g) copia offerta economica dei prodotti offerti priva dei prezzi (c.d. offerta economica silente) | SI | |
| h) elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata suddiviso per lotto | SI | |
| i) CD/DVD contenente tutta la documentazione tecnica presentata in formato PDF | SI | |

RELAZIONE ASSISTENZA TECNICA
PIANO FORMAZIONE

GARA N. 6621976 -SCHEDA VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

| | | |
|---|---------------------------|-------------|
| SOCIETA': | MEDIGAS ITALIA spa | |
| LOTTE PARTECIPATI: | 4, 6 | |
| PRODOTTO OFFERTO: | BELLAVISTA | |
| LOTTO 4: | RESMART GII C-PAP | |
| LOTTO 6: | | |
| CONTENUTO OFFERTA TECNICA: | CONFORMITA' | NOTE |
| a) scheda tecnica prodotti offerti con codice CND | SI | |
| b) dichiarazione allegato F4 | SI | |
| c) copia della certificazione CEE e/ conformità alle Direttive CEE | SI | |
| d) dichiarazione di presenza/assenza di segreti tecnici e/o commerciali | PRESENTE | |
| e) dichiarazione di disponibilità all'aggiornamento tecnologico | SI | |
| f) dichiarazione ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore | SI | |
| g) copia offerta economica dei prodotti offerti priva dei prezzi (c.d. offerta economica silente) | SI | |
| h) elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata suddiviso per lotto | SI | |
| i) CD/DVD contenente tutta la documentazione tecnica presentata in formato PDF | SI | |

RELAZIONE ASSISTENZA TECNICA
PIANO DI FORMAZIONE

GARA N. 6621976 -SCHEDA VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

| | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| SOCIETA': | MEDTRONIC ITALIA spa | |
| LOTTE PARTECIPATI: | 3, 4, 10 | |
| PRODOTTO OFFERTO: | | |
| LOTTO 3: | PB-980 P/A | |
| LOTTO 4: | PB-980 P/A | |
| LOTTO 10: | PB-980 U + NEBULIZZATORE | |
| CONTENUTO OFFERTA TECNICA: | CONFORMITA' | NOTE |
| a) scheda tecnica prodotti offerti con codice CND | SI | |
| b) dichiarazione allegato F4 | SI | |
| c) copia della certificazione CEE e/ conformità alle Direttive CEE | SI | |
| d) dichiarazione di presenza/assenza di segreti tecnici e/o commerciali | PRESENTE | |
| e) dichiarazione di disponibilità all'agglionamento tecnologico | SI | |
| f) dichiarazione ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore | SI | |
| g) copia offerta economica dei prodotti offerti priva dei prezzi (c.d. offerta economica silente) | SI | |
| h) elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata suddiviso per lotto | SI | |
| i) CD/DVD contenente tutta la documentazione tecnica presentata in formato PDF | SI | |

RELAZIONE ASSISTENZA TECNICA
PIANO DI FORMAZIONE

GARA N. 6621976 -SCHEDA VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA


| | | |
|---|-------------------------------------|-------------|
| SOCIETA': | MINDRAY MEDICAL ITALY srl | |
| LOTTE PARTECIPATI: | 2, 4 | |
| PRODOTTO OFFERTO: | WATO EX 65 PRO | |
| LOTTO 2 | SV 300 VENTILATORE A TURBINA | |
| LOTTO 4: | | |
| CONTENUTO OFFERTA TECNICA: | CONFORMITA' | NOTE |
| a) scheda tecnica prodotti offerti con codice CND | SI | |
| b) dichiarazione allegato F4 | SI | |
| c) copia della certificazione CEE e/ conformità alle Direttive CEE | SI | |
| d) dichiarazione di presenza/assenza di segreti tecnici e/o commerciali | PRESENTE | |
| e) dichiarazione di disponibilità all'aggiornamento tecnologico | SI | |
| f) dichiarazione ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore | SI | |
| g) copia offerta economica dei prodotti offerti priva dei prezzi (c.d. offerta economica silente) | SI | |
| h) elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata suddiviso per lotto | SI | |
| i) CD/DVD contenente tutta la documentazione tecnica presentata in formato PDF | SI | |

RELAZIONE ASSISTENZA TECNICA
PIANO DI FORMAZIONE


GARA N. 6621976 -SCHEDA VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

| | | |
|---|--------------------|-------------|
| SOCIETA': | PHILIPS spa | |
| LOTTE PARTECIPATI: | 4 | |
| PRODOTTO OFFERTO: | RESPIRONICS V680 | |
| LOTTO 4: | | |
| CONTENUTO OFFERTA TECNICA: | CONFORMITA' | NOTE |
| a) scheda tecnica prodotti offerti con codice CND | SI | |
| b) dichiarazione allegato F4 | SI | |
| c) copia della certificazione CEE e/ conformità alle Direttive CEE | SI | |
| d) dichiarazione di presenza/assenza di segreti tecnici e/o commerciali | PRESENTE | |
| e) dichiarazione di disponibilità all'aggiornamento tecnologico | SI | |
| f) dichiarazione ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore | SI | |
| g) copia offerta economica dei prodotti offerti priva dei prezzi (c.d. offerta economica silente) | SI | |
| h) elenco riepilogativo di tutta la documentazione tecnica presentata suddiviso per lotto | SI | |
| i) CD/DVD contenente tutta la documentazione tecnica presentata in formato PDF | SI | |

RELAZIONE ASSISTENZA TECNICA
PIANO DI FORMAZIONE



MEDIGAS Italia S.r.l.
I-20090 Assago (MI) - Via Edison, 6
Tel. +39 02 48881111 - Fax +39 02 48881150
www.medigas.it
Capitale Sociale € 4.000.000 int. vers.
Reg. Imprese Milano N. 02466440167
REA Milano 1502123
C. F. 02466440167 - P. IVA 11861240135



ALL PO 2

Spettabile
A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria
della Regione Liguria
Piazza della Vittoria, 15
16121 GENOVA (GE)

Assago, 27/01/17

Ns. Rif. Prot. n. 014/16/GF/pm

OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 - comma 4 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, con più operatori economici per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari ad uso ospedaliero occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Numero gara: 6621976
Istanza di regolarizzazione posizione mediante soccorso istruttorio

Con riferimento alla procedura in oggetto prendiamo atto della esclusione della ns. offerta relativa al lotto n. 4 come da verbale pubblicato sul sito www.acquistiliguria.it.

Relativamente alla causa di esclusione, rendiamo noto di essere assolutamente certi del contenuto tecnico all'interno di una delle due buste denominate erroneamente "offerta economica lotto 4" e di poterlo dimostrare nella sede che più si ritiene opportuna. In considerazione di ciò chiediamo la regolarizzazione della nostra posizione mediante ricorso al soccorso istruttorio.

Quanto sopra al fine di tutelare ogni nostro interesse, eventualmente anche in sede giudiziaria.

Confidando nell'accoglimento della presente istanza restiamo in attesa di Vs cortese cenno di riscontro e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti

MEDIGAS Italia S.r.l.
Il Direttore Generale
Dott. Giancarlo FONTANA



Prof. n. 5962 del 26.4.2017

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016,
per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi
per anestesia e ventilatori polmonari ad uso ospedaliero occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS
della Regione Liguria
per un periodo di anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)
Lotti n. 11 - N. gara: 6621976

Prima seduta riservata della Commissione Giudicatrice

21 aprile 2017

Il giorno 21 del mese di aprile dell'anno 2017, alle ore 10:15 presso la Sala riunioni di A.Li.Sa Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 5/2016, con determinazione n. 110 del 20.3.2017 per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice:

| Cognome | Nome | Struttura | |
|-----------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| GRATAROLA | Dott. Angelo | A.O.U./IRCCS San Martino | In qualità di Presidente |
| BUCCHERI | Ing. Massimo | ASL 5 Spezzina | In qualità di Componente |
| PEZZATO | Dott. Stefano | IRCCS Giannina Gaslini | In qualità di Componente |

E' presente per la Centrale Acquisti la Dott.ssa Tiziana Tazzoli che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice prende preliminarmente atto che la documentazione tecnica è stata adeguatamente custodita in locali chiusi della Centrale Regionale di Acquisto.

La Commissione inizia a verificare sulla documentazione tecnica prodotta dalle Ditte partecipanti la presenza dei requisiti tecnici minimi richiesti a pena di esclusione. La verifica viene effettuata per il Lotto 1 (apparecchi per anestesia di fascia alta), per il quale hanno presentato offerta le Società Drager Italia, Maquet Italia e GE Medical Systems Italia

La Commissione termina l'esame della documentazione tecnica presentata dagli offerenti per il Lotto 1 e riscontra la presenza degli elementi tecnici minimi richiesti a pena di esclusione.

La Commissione passa quindi a riscontrare i documenti tecnici relativi al Lotto 2 (apparecchio per anestesia di base), per il quale hanno presentato offerta le Società Drager Italia, Maquet Italia, GE Medical Systems Italia, Mindray Medical Italia. Anche per il Lotto 2 la Commissione riscontra la conformità delle offerte tecniche presentate ai requisiti tecnici minimi prescritti dal Capitolato di gara.

La Commissione sospende i lavori per la pausa pranzo alle ore 13:25

La seduta riprende alle ore 14:00. La Commissione esamina i documenti relativi all'offerta tecnica presentata per il Lotto 3 (Apparecchio per terapia intensiva) dalle Società Drager Medical Italia, Maquet Italia, GE Medical Systems Italia, Burke&Burke spa e Medtronic Italia. Relativamente all'offerta tecnica presentata dalla Società Medtronic la Commissione rileva che viene dichiarata una tempistica di intervento per la manutenzione correttiva di 8 ore dalla richiesta. La Commissione prende atto di quanto evidenziato nella documentazione tecnica e si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti.


Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale agli atti della Centrale.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and initials 'M' and 'DD' at the bottom center.

La seduta è tolta alle ore 18:00

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Angelo GRATAROLA
Presidente




Dott. Stefano PEZZATO
Componente



Ing. Massimo BUCCHERI
Componente



Dott.ssa Tiziana TAZZOLI
Segretario



Prot. n. 7564 del 25/05/2017

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016,
per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi
per anestesia e ventilatori polmonari ad uso ospedaliero occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS
della Regione Liguria
per un periodo di anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)
Lotti n. 11 - N. gara: 6621976

Seconda seduta riservata della Commissione Giudicatrice

24 maggio 2017

Il giorno 24 del mese di maggio dell'anno 2017, alle ore 14:30 presso la Sala riunioni di A.Li.Sa Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 5/2016, con determinazione n. 110 del 20.3.2017 per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice:

| Cognome | Nome | Struttura | |
|-----------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| GRATAROLA | Dott. Angelo | A.O.U./IRCCS San Martino | in qualità di Presidente |
| BUCCHERI | Ing. Massimo | ASL 5 Spezzina | in qualità di Componente |
| PEZZATO | Dott. Stefano | IRCCS Giannina Gaslini | in qualità di Componente |

E' presente per la Centrale Acquisti la Dott.ssa Tiziana Tazzoli che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice prende preliminarmente atto che la documentazione tecnica è stata adeguatamente custodita in locali chiusi della Centrale Regionale di Acquisto.

In apertura di seduta la Commissione ritiene di approfondire quanto evidenziato nella seduta precedente in relazione all'offerta tecnica presentata dalla Società Medtronic per il Lotto 2. In particolare, decide di riesaminare la documentazione prodotta per verificare il requisito della tempistica relativa alla manutenzione correttiva. La Commissione rileva che la documentazione tecnica denominata "Assistenza Tecnica" è stata prodotta dalla Società Medtronic in documento unico per tutti e tre i Lotti partecipati (3, 4e 10).

In tale documento è presente una dichiarazione sottoscritta con firma autografa del Procuratore di Medtronic spa (dott.ssa Maria Patané) nella quale si dichiara, relativamente al servizio di Assistenza Tecnica:

- > "Modalità e tempi di effettuazione del servizio": entro 8 ore dalla chiamata, eccetto imprevisti, esclusi festivi e week end

La Commissione rileva come al punto 1.15.2 "Manutenzione correttiva" del Paragrafo D "Altre condizioni minime valide per tutti i lotti (richieste a pena di esclusione)" del Capitolato Tecnico di Gara è prescritto: "(...)tempi di risoluzione, eventualmente con fornitura di muletto sostitutivo:

1.15.2 entro massimo 4 ore solari dalla chiamata

Inoltre, al punto 1.11 dello stesso Paragrafo D del Capitolato Tecnico prevede modalità e tempi di effettuazione del servizio: "h24 tutti i giorni (lavorativi, festivi, prefestivi). Il servizio è garantito anche in caso di scioperi, periodo di ferie, nevicate o altri impedimenti"

Invece, nel documento presentato dalla Società Medtronic spa si precisa che le modalità ed i tempi di effettuazione del servizio (entro 8 h dalla chiamata) sono garantite "eccetto imprevisti, esclusi i festivi e week end".

La Commissione, ritenendo pertanto che l'offerta tecnica presentata dalla Società Medtronic spa per i Lotti 3, 4e 10 non soddisfi i requisiti tecnici minimi richiesti dal Capitolato Tecnico di gara a pena di esclusione e ritiene di escludere, per i motivi sopra meglio esplicitati, l'offerta della Società Medtronic spa dai Lotti 3, 4e 10.

La Commissione procede, quindi, a verificare i requisiti tecnici relativi al Lotto 4 (Ventilatori Polmonari per pneumologia). Gli esiti sono riportati nell'allegato 1 (file excel) che verrà allegato al verbale conclusivo dei lavori della Commissione Giudicatrice.

Relativamente all'offerta tecnica presentata dalla Società Drager per il Lotto 4 la Commissione verifica che la modalità ventilatoria NIV è disponibile solo come opzionale mentre il Capitolato Tecnico (punto 2.1.2) la richiedeva come modalità ventilatoria minima richiesta a pena di esclusione. La Commissione decide pertanto di escludere l'offerta della Società Drager spa per il Lotto 4 per difetto dei requisiti tecnici minimi.

Anche in relazione all'offerta tecnica presentata dalla Società Carefusion per il Lotto 4 la Commissione Giudicatrice rileva che viene dichiarata una tempistica di intervento per l'assistenza tecnica di 48 ore dalla chiamata. Pertanto la Commissione decide di escludere l'offerta della Società Carefusion per difetto dei requisiti tecnici minimi prescritti a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico di gara (paragrafo D punto 1.15.2). Terminata l'esame della documentazione tecnica relativa al Lotto 4 la Commissione passa ad esaminare la documentazione tecnica presentata per il Lotto 5 (Ventilatore da trasporto/emergenza).

Terminato l'esame della documentazione relativa al Lotto 5 la Commissione passa ad esaminare l'offerta tecnica presentata per il Lotto 6 (CPAP per degenza). Terminato l'esame della documentazione presentata per il Lotto 6 la Commissione passa ad esaminare la documentazione tecnica presentata per i Lotti c.d. pediatrici (8,9,10,11) che risultano tutti idonei.

La Commissione stabilisce il calendario per le prove pratiche:

Lotti 5-8-9-10-11 presso IRCCS Gaslini – 21 giugno ore 10:00 Pad. 17 piano terra


Lotti 1-2-3 -4 -6 Policlino IRCCS San Martino – 28 giugno ore 10:00 San Martino

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale agli atti della Centrale.

La seduta è tolta alle ore 18:30

Letto, confermato e sottoscritto.


Dott. Angelo GRATAROLA
Presidente




Dott. Stefano PEZZATO
Componente



Ing. Massimo BUCCHERI
Componente



Dott.ssa Tiziana TAZZOLI
Segretario



Prot. n. 8846 del 22/06/2017

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016,
per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi
per anestesia e ventilatori polmonari ad uso ospedaliero occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS
della Regione Liguria
per un periodo di anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)
Lotti n. 11 - N. gara: 6621976

**Terza seduta riservata della Commissione Giudicatrice (prova pratica apparecchiature
offerte Lotti 5, 8, 9, 10, 11)**

21 giugno 2017

Il giorno 21 del mese di giugno dell'anno 2017, alle ore 10:00 presso l'U.O.S.D. Centro di Rianimazione Neonatale del Dipartimento di Alta Intensità di Cure e Percorso Nascita, Padiglione 17 Piano Terra dell'IRCCS Giannina Gaslini si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 5/2016, con determinazione n. 110 del 20.3.2017 per le operazioni di valutazione della idoneità/qualità delle apparecchiature presentate dalle Ditte concorrenti relativamente ai lotti 5, 8, 9, 10 e 11.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice:

| Cognome | Nome | Struttura | |
|-----------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| GRATAROLA | Dott. Angelo | A.O.U./IRCCS San Martino | in qualità di Presidente |
| BUCCHERI | Ing. Massimo | ASL 5 Spezzina | in qualità di Componente |
| PEZZATO | Dott. Stefano | IRCCS Giannina Gaslini | in qualità di Componente |

Sono presenti per la Centrale Acquisti il Dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente, e la Dott.ssa Tiziana Tazzoli, Collaboratore Amministrativo, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

In apertura di seduta la Commissione Giudicatrice prende atto delle note inviate dalla Società Carefusion Italy 311 s.r.l. prot. n. 7639 del 29/05/2017 e dalla Società Draeger Medical Italia spa prot. n. 7671 del 29/05/2017 a seguito delle esclusioni comunicate rispettivamente con nota prot. n. 7603 del 25/05/2017 e nota prot. n. 7604 del 25/05/2017.

In particolare, a fronte della contestazione ricevuta, la Società Carefusion Italy 311 s.r.l. precisa che nel documento dell'offerta tecnica specificamente dedicato all'assistenza tecnica post-vendita e denominato "Organizzazione assistenza tecnica e servizio di manutenzione" è chiaramente esplicitato un tempo di intervento di 4 ore solari dalla chiamata, mentre la diversa tempistica riportata nel documento denominato offerta economica silente (48 ore dalla chiamata) è da attribuirsi ad un mero refuso peraltro inserito in un documento che non si riferisce specificamente all'assistenza tecnica. La Commissione Giudicatrice, valutati i chiarimenti forniti ritiene fondate le ragioni addotte dalla Società Carefusion Italy 311 s.r.l. e decide, pertanto, di riammetterla in gara relativamente al Lotto 4. Per quanto riguarda invece i chiarimenti forniti dalla Società Draeger Medical Italia spa, la Commissione decide di verificare se quanto dichiarato in merito alle componenti dell'offerta tecnica definite quali "opzioni" corrisponda effettivamente all'offerta economica e decide, pertanto, di riammettere con riserva la Società Draeger Medical Italia spa alla procedura di gara relativamente al Lotto 4, riservandosi di sciogliere la riserva all'atto dell'apertura delle offerte economiche.

Il Dott. Costa ricorda, quindi, che il Disciplinare di Gara prevedeva, ai fini della valutazione delle apparecchiature offerte, la prova pratica delle medesime presso strutture del SSR. La Centrale di Acquisto, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Giudicatrice, ha provveduto - con nota prot. n. 7922 del 5/6/2017 - alla convocazione formale delle Ditte ammesse per la presentazione delle apparecchiature offerte secondo il calendario stilato a cura della Commissione Giudicatrice. Il Dott. Costa ricorda, altresì, che relativamente al Lotto 10 non è stata convocata per la prova pratica la Società Medtronic Italia spa in quanto

[Handwritten signatures and initials]

esclusa dalla Commissione Giudicatrice nel corso della precedente seduta riservata del 24/5/2017 (verbale prot. n. 7564 del 25/5/2017), esclusione comunicata con nota prot. n. 7601 del 25/5/2017.

Nella prova pratica odierna la Commissione Giudicatrice procede a valutare le apparecchiature relative ai Lotti 5, 8, 9, 10 e 11. Gli esiti della valutazione verranno riportati, per comodità di consultazione, nella tabella (file excel) denominata " Scheda valutazione Lotti 5_8_9_10_11" che verrà allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. Il Dott. Costa dà altresì atto che le Ditte convocate per i Lotti esaminati hanno regolarmente presentato la documentazione che era stata richiesta ai fini della prova pratica, ovvero dichiarazione di manleva e copia della polizza assicurativa RCT:

- Società Air Liquide prot. n. 8600 del 19.6.2017;
- Società Burke&Burke spa prot. n. 7977 del 6.6.2017
- Società Draeger Medical Italia spa prot. n. 8607 del 19.6.2017
- Società GE Medical Italia spa prot. n. 8597 del 19.6.2017
- Società Maquet Italia spa prot. n. 8271 del 9.6.2017

Espletate le verifiche di rito, la prova pratica ha inizio alle ore 10:25 La Commissione Giudicatrice verifica preliminarmente che le apparecchiature esibite in prova corrispondano ai modelli dichiarati dalle Ditte partecipanti nella documentazione tecnica, e di seguito riepilogati per comodità di consultazione:

Lotto 5 (Ventilatore da trasporto/emergenza):

- Air Liquide Medical Systems srl – Monnal T60;
- Burke&Burke spa – Hamilton T1

Lotto 8 (Ventilatore per ventilazione convenzionale e ad alta frequenza oscillatoria per terapia intensiva neonatale):

- Draeger Medical Italia spa - Babylog VN 500
- Burke&Burke spa - Fabian HOFI

Lotto 9 (Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica, con possibilità di utilizzo in modalità invasiva):

- Draeger Medical Italia spa – Evita Infinity V500

Lotto 10 (Ventilatore per ventilazione invasiva per terapia intensiva pediatrica):

- Draeger Medical Italia spa – Evita Infinity V500
- GE Medical Systems Italia spa – CareScape R860
- Maquet Italia spa – Servo-U

Lotto 11 (Apparecchio a circuito aperto, semi-chiuso e chiuso a bassi flussi per anestesia neonatale e pediatrica utilizzabile anche per pazienti adolescenti/adulti):

- Draeger Medical Italia spa – Perseus

La Commissione avrà cura di assegnare a ciascuna delle Ditte presenti lo stesso tempo di prova delle apparecchiature in proporzione ai lotti partecipati. Per ragioni di imparzialità e trasparenza la Commissione procederà per ciascun Lotto, alla presenza dei rappresentanti delle Ditte intervenuti, al sorteggio delle Ditte al fine di stabilire l'ordine di prova, ad eccezione dei Lotti 9 e 11 per i quali è presente la sola offerta della Società Draeger Medical Italia spa.

Per il Lotto 5 il sorteggio viene effettuato dal Sig. Massimo De Serio della Società Air Liquide Medical Systems srl :1° estratto Air Liquide Medical Systems srl 2° estratto: Burke&Burke spa

La Commissione inizia quindi a visionare le apparecchiature offerte per il Lotto 5 dalla Società prima estratta Air Liquide Medical Systems srl per la quale sono presenti il Sig. Massimo De Serio ed il Sig. Franco Fisher che non prende parte alla prova pratica.

La prova termina alle ore 10:54. Alle ore 11:01 la Commissione passa quindi a visionare l'apparecchiatura offerta dalla Società Burke&Burke per la quale sono presenti i Sig.ri Alessandro Garofalo e Fabio Ballone. La prova termina alle ore 11:35

La Commissione procede, quindi, ad attribuire i punteggi relativi al Lotto 5 che sono riportati nella scheda sopra indicata. I dati oggettivi relativi ai parametri 1.1,1.2,1.3,1.6.2,2.6,5.1 e 5.2 rilevati da scheda tecnica di

prodotto ed ulteriormente verificati nel corso della prova pratica vengono riportati nella scheda di valutazione formato excel sopra indicata per il calcolo automatico del punteggio sulla base dei criteri e delle formule di calcolo specificate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico.

Relativamente al parametro 1.5 la Commissione ritiene di attribuire un punteggio maggiore alla Società Burke&Burke in quanto l'apparecchio offerto è in grado di gestire anche pazienti di peso inferiore ai 3 Kg (es. prematuri) mediante un apposito sw che viene offerto in opzione. Mentre l'apparecchio offerto dalla Società Air Liquide Medical Systems srl può gestire solo pazienti con peso a partire da 3 Kg:

Relativamente al parametro 1.6.1 la Commissione ritiene di attribuire un punteggio maggiore all'interfaccia dell'apparecchio offerto da Burke&Burke in quanto più intuitivo nella gestione e lettura, inoltre effettua una rappresentazione grafica dello stato della ventilazione che risulta più immediata per gli operatori rispetto ai soli indici numerici.

Relativamente al parametro 1.6.3 la Commissione ritiene che i due apparecchi si equivalgano.

Per quanto riguarda le modalità di ventilazione offerte la Commissione attribuisce un maggior punteggio all'apparecchio della Società Burke&Burke spa in quanto presenta una gamma di modalità ventilatorie più estesa (APRV, APVcmv, APVsimv, NIV, NIV-ST ecc.);

Relativamente al parametro 2.2 la Commissione ritiene che i due apparecchi offerti si equivalgano.

Relativamente ai parametri 2.3, 2.4 e 2.5 la Commissione ritiene che i due apparecchi offerti si equivalgano, anche in relazione al parametro 2.7. L'apparecchio Air Liquide propone infatti (peraltro opzionale) la metodica CP mentre l'apparecchio Burke&Burke presenta ventilazione ASV. Presenta inoltre terapia ossigeno ad alti flussi, Neo Vent, Nasal CPAP però tutte in opzione (non incluse nella configurazione offerta).

Per quanto riguarda il monitoraggio, la Commissione ritiene che i due apparecchi si equivalgano per quanto riguarda i parametri 3.1 e 3.2, mentre in relazione al parametro 3.3 la Commissione ritiene migliore l'apparecchio offerto dalla Società Burke&Burke in quanto presenta una gamma di parametri monitorati più ampia, tra cui la funzione polmone dinamico.

Relativamente agli allarmi (parametri 4.1 e 4.2) la Commissione ritiene che i due apparecchi offerti si equivalgano.

Infine, per quanto riguarda l'assistenza tecnica e formazione la Commissione ritiene di premiare l'offerta della Società Burke&Burke in quanto propone una garanzia full risk pari a 36 mesi, quindi migliorativa rispetto al minimo (24 mesi) prescritto dal Capitolato di gara.

Si procede quindi al sorteggio relativo alle Ditte partecipanti al Lotto 8. Sorteggia il Sig. Fabrizio Delfino della Società GE Medical Systems Italia spa. Viene estratta per prima la Società Burke&Burke per la quale sono presenti i Sig.ri Frontini Massimiliano e Garofalo Alessandro. La prova inizia alle ore 11:50 e termina alle ore 12:11.

Alle ore 12:18 viene quindi visionata l'apparecchiatura offerta dalla Società seconda estratta, Draeger Medical Italia spa, per la quale sono presenti i Sig.ri Liegrazini Ettore, Sartori Stefano e Campi Massimo. La prova termina alle ore 12:50.

La Commissione procede, quindi ad attribuire i punteggi alle offerte presentate per il lotto 8. Punteggi riepilogati nella scheda excel sopra indicata. I dati oggettivi relativi ai parametri 1.1,1.2,1.3,1.6,1.9,1.10,1.11, rilevati da scheda tecnica di prodotto ed ulteriormente verificati nel corso della prova pratica vengono riportati nella scheda di valutazione formato excel sopra indicata per il calcolo automatico del punteggio sulla base dei criteri e delle formule di calcolo specificate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico.

Relativamente al parametro 1.4 la Commissione ritiene migliore l'apparecchiatura della Società Draeger Medical Italia spa in quanto anche la valvola inspiratoria è smontabile e autoclavabile.

Relativamente al parametro 1.5 la Commissione ritiene di premiare l'apparecchio Draeger in quanto dispone di migliori e più versatili modalità di posizionamento anche con dotazione di sistema di accoppiamento per il letto del paziente agevolandone il trasporto. Inoltre nell'apparecchio Burke&Burke il monitor non è separabile dall'unità pneumatica. Relativamente all'interfaccia utente la Commissione ritiene che le due apparecchiature offerte si equivalgano per quanto riguarda i parametri di cui ai punti 1.7.2 e 1.7.3, mentre in ordine ai parametri 1.7.1 e 1.7.4 la Commissione predilige l'interfaccia dell'apparecchio Draeger sia per l'ampiezza del monitor (17 pollici contro i 10,4 pollici dell'apparecchio Burke&Burke) sia per la struttura logica delle informazioni fornite essendo altresì possibile la visualizzazione in contemporanea di 9 tracce selezionabili dall'operatore mentre l'apparecchio Burke&Burke consente la visualizzazione contemporanea di sole 3 tracce. Risulta inoltre presente, sull'apparecchio Draeger, la modalità notturna di funzionamento del display particolarmente utile per il comfort del paziente pediatrico. Per quanto riguarda il parametro 1.8 la Commissione ritiene che i due apparecchi offerti siano sostanzialmente equivalenti.

In relazione al parametro 2.1 la Commissione ritiene di premiare l'apparecchio Draeger in quanto munito di sensore di ossigeno paramagnetico esente da manutenzione e da consumo, mentre l'apparecchio Burke&Burke presenta sensori elettrochimici. Per quanto riguarda il parametro 2.2 la Commissione valuta una

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

leggera preferenza per l'apparecchiatura Draeger in quanto la gamma di ventilazioni convenzionali offerte risulta più ampia. Relativamente al parametro 2.3 la Commissione ritiene che le due apparecchiature abbiano prestazioni equivalenti, mentre in relazione al parametro 2.4 la Commissione ritiene di premiare l'apparecchiatura Burke&Burke in quanto presente anche la Nasal-CPAP. Relativamente al parametro 2.5 la Commissione ritiene di attribuire un punteggio maggiore all'apparecchio Draeger in quanto dispone di due tipi di sensore di flusso, entrambi autoclavabili, in grado di leggere sia il flusso inspiratorio che espiratorio.

In merito ai parametri 2.6 e 2.7 la Commissione ritiene che le due apparecchiature abbiano prestazioni equivalenti, mentre in relazione al parametro 2.8 la Commissione ritiene di attribuire un punteggio maggiore all'apparecchio Draeger in quanto presenta la funzione ATC con calcolo inclusivo del diametro interno del tubo. Per quanto riguarda i parametri di valutazione relativi al sistema di monitoraggio, 3.1, 3.2 e 3.3 la Commissione ritiene che le due apparecchiature offrano funzionalità e prestazioni sostanzialmente equivalenti tranne che per il parametro di cui al punto 3.4 in relazione al quale la Commissione ritiene di attribuire un punteggio maggiore all'apparecchio Draeger in quanto presenta la memorizzazione dell'ultima pressione garantita in caso di attivazione allarme e misurazione tracheale.

Relativamente al parametro 4.1 la Commissione ritiene di premiare l'offerta della Società Burke&Burke in quanto presenta una garanzia full risk di 36 mesi, pertanto migliorativa rispetto a quella minima di 24 mesi richiesta dal Capitolato di gara. Relativamente al parametro 4.2 la Commissione ritiene migliorativo il piano formativo presentato dalla Società Draeger Medical Italia spa in quanto risulta più strutturato e presenta anche corsi di "Advanced Trainings". Infine, relativamente al parametro 4.3 la Commissione ritiene che, ricorrendo alla trattazione dei temi richiesti presente in entrambi i piani formativi offerti senza particolari specificazioni, entrambe siano soddisfacenti.

Alle ore 13:30 la Commissione sospende la seduta per la pausa pranzo e comunica alle società presenti che la visione delle apparecchiature restanti (Lotti 9, 10 e 11) riprenderà alle ore 14:30.

Alle ore 14:30 la Commissione riprende i lavori e procede al sorteggio per la visione delle apparecchiature del Lotto 10 (Ventilatore per ventilazione invasiva per terapia intensiva pediatrica) per il quale concorrono le Società Draeger Medical Italia, GE Medical Systems Italia e Maquet Italia. Sorteggia il Sig. Lorenzo Pandolfi. Viene sorteggiato il seguente ordine:

1° Maquet Italia spa, 2° GE Medical Systems Italia, 3° Draeger Medical Italia.

Alle ore 14:35 inizia la prova pratica dell'apparecchiatura Servo-U presentata dalla società prima estratta Maquet Italia spa per la quale sono presenti i Signori Federico Araldi e Stefano Sartori. La prova termina alle ore 15:04. La Commissione passa quindi a visionare l'apparecchio Carescape R860 offerto dalla Società GE per la quale sono presenti la Signora Valentina Di Diego e la Signora Benedetta Mangiante. La prova ha inizio alle ore 15:10 e termina alle ore 15:42. Infine, viene visionata l'apparecchiatura Infinity Evita V500 presentata dalla Società Draeger. Poiché la Società Draeger ha presentato la medesima apparecchiatura anche per il Lotto 9 (Ventilatore per ventilazione non-invasiva per terapia intensiva pediatrica, con possibilità di utilizzo in modalità invasiva) per il quale risulta l'unica offerente, la Commissione decide di visionare l'apparecchiatura in relazione ad entrambi i lotti. La prova inizia alle ore 15:49 e termina alle ore 16:27. La Commissione procede, dunque, all'attribuzione dei punteggi relativi al Lotto 10. I punteggi sono riportati nel file excel Scheda valutazione lotti_5_8_9_10_11 allegata al presente verbale. Relativamente al Lotto 10 i dati oggettivi relativi ai parametri 1.1, 1.2, 1.8, 1.9, 1.10, rilevati da scheda tecnica di prodotto ed ulteriormente verificati nel corso della prova pratica vengono riportati nella scheda di valutazione formato excel sopra indicata per il calcolo automatico del punteggio sulla base dei criteri e delle formule di calcolo specificate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico. I parametri qualitativi di natura intangibile vengono valutati tramite il metodo del confronto a coppie come previsto dal Disciplinare di Gara, secondo la matrice riportata nella Scheda valutazione allegata al presente verbale (file excel). Relativamente al Lotto 9, per il quale è presente l'unica offerta della Società Draeger la Commissione, ritenuta l'idoneità dell'apparecchiatura offerta, valuta come più che soddisfacenti le caratteristiche della medesima ed assegna i punteggi di qualitativi riportati nella scheda di valutazione allegata al presente verbale (file excel).

Alle ore 17:30 la Commissione, terminate le valutazioni dei Lotti 9 e 10, passa ad esaminare l'apparecchiatura offerta dalla Società Draeger Medical Italia, unica offerente per il Lotto 11 (Apparecchio a circuito aperto, semi-chiuso e chiuso a bassi flussi per anestesia neonatale e pediatrica utilizzabile anche su pz adulto). La macchina offerta è Perseus A500. La prova pratica termina alle ore 18:02. La Commissione ritiene l'apparecchiatura offerta idonea e giudica come più che soddisfacenti le caratteristiche tecniche e prestazionali della medesima, attribuendo i punteggi di qualità riportati nella scheda di valutazione allegata al presente verbale.

In chiusura di seduta la Commissione, valutata la tempistica necessaria all'effettuazione delle prove pratiche, ritiene preferibile modificare il calendario inizialmente fissato per la prova dei Lotti 1, 2, 3, 4 e 6, suddividendo le prove in due giornate distinte, come di seguito specificato:



- Lotti 1, 2 e 3: 28 giugno 2017 dalle ore 9:00 presso Ospedale Policlinico San Martino – Padiglione Specialità 1° piano
- Lotti 4 e 6: 26 luglio 2017 dalle ore 10:00, stessa sede.


La Centrale di Acquisto provvederà a comunicare quanto sopra deciso alle Ditte concorrenti.

* Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale agli atti della Centrale.


La seduta è tolta alle ore 18:30

Letto, confermato e sottoscritto.


Dott. Angelo GRATAROLA
Presidente




Dott. Stefano PEZZATO
Componente



Ing. Massimo BUCCHERI
Componente



Dott. Luigi Moreno COSTA



Dott.ssa Tiziana TAZZOLI
Segretario



All.to
Scheda di valutazione lotti 5_8_9_10_11

| LOTTO 5 | | Max. punti | Parametri di valutazione e valori alla base di gara | Air Liquide Mornal T60 | Burke&Burke Hamilton T1 | Valutazioni Individuali | Valutazioni Individuali |
|---|-------|-------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ventilatore da trasporto/emergenza | | | | | | | |
| Requisiti essenziali | | | | PRESENTI | PRESENTI | | |
| 1. Caratteristiche generali: | | | | | | | |
| 1.1 Peso complessivo (<7 Kg): a minor peso corrisponde maggior punteggio | 1 | Q4 | | 4,00 | 5,60 | | 7 base gara |
| | | | | Punteggio | 1,000 | 0,467 | |
| 1.2 Dimensioni in cm (L*A*P): a minori dimensioni corrisponde maggior punteggio | 1 | Q4* | | 7975 | 15624 | | 18749 base gara |
| | | | | Punteggio | 1,000 | 0,290 | |
| 1.3 Anno di immissione in commercio: fino al 2014 (incluso)=0 p.ti successivamente al 2014=1 p.ti | 1 | ≤2014=0 p.ti >2014=1 p.ti | | 2016 | 2016 | | |
| | | | | Punteggio | 1,000 | 1,000 | |
| 1.4 Certificazione per uso in elicottero con compensazione automatica ai cambiamenti di pressione atmosferica (ON/OFF) | 4 | Q5 | X | ON | ON | | |
| | | | | Punteggio | 4,000 | 4,000 | |
| 1.5 Utilizzabile anche su pz neonatale (Air Liquide pz da 3 Kg; Burke&Burke anche su prematuro) | 3 | Q1 | GRATAROLA | 0,30 | 0,80 | | |
| | | | PEZZATO | 0,10 | 0,80 | | |
| | | | BUCCHERI | 0,30 | 0,80 | | |
| | | | Media coefficienti | 0,23 | 0,80 | | |
| | | | riportata a 1 | 0,29 | 1,00 | | |
| Punteggio | 0,875 | 3,000 | | | | | |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.6.1 Intuitività dell'interfaccia utente con particolare attenzione alla struttura logica delle informazioni | 2 | Q1 | GRATAROLA | 0,50 | 1,00 | | |
| | | | PEZZATO | 0,40 | 1,00 | | |
| | | | BUCCHERI | 0,50 | 1,00 | | |
| | | | Media coefficienti | 0,47 | 1,00 | | |
| | | | riportata a 1 | 0,47 | 1,00 | | |
| Punteggio | 0,933 | 2,000 | | | | | |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.6.2 Display touch screen (ON/OFF) | 1 | Q5 | | ON | ON | | |
| | | | | Punteggio | 1,000 | 1,000 | |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.6.3 Ridotto numero di menù | 2 | Q1 | GRATAROLA | 0,50 | 0,50 | | |
| | | | PEZZATO | 0,50 | 0,50 | | |
| | | | BUCCHERI | 0,50 | 0,50 | | |
| | | | Media coefficienti | 0,50 | 0,50 | | |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 | | |
| Punteggio | 2,000 | 2,000 | | | | | |
| 2. Modalità di ventilazione: | | | | | | | |
| 2.1 Caratteristiche delle modalità ventilatorie offerte | 2 | Q1 | GRATAROLA | 0,50 | 1,00 | | |
| | | | PEZZATO | 0,50 | 1,00 | | |
| | | | BUCCHERI | 0,50 | 1,00 | | |
| | | | Media coefficienti | 0,50 | 1,00 | | |
| | | | riportata a 1 | 0,50 | 1,00 | | |
| Punteggio | 1,000 | 2,000 | | | | | |
| 2.2 Presenza di blocco espiratorio manuale (verificare in prova per Burke&Burke) | 2 | Q1 | GRATAROLA | 0,50 | 0,50 | | |
| | | | PEZZATO | 0,50 | 0,50 | | |
| | | | BUCCHERI | 0,50 | 0,50 | | |
| | | | Media coefficienti | 0,50 | 0,50 | | |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 | | |
| Punteggio | 2,000 | 2,000 | | | | | |
| 2.3 Rispondenza in termini di precisione e scostamento % dal target di volume minuto corrente impostabile a partire da 35 ml in condizioni di normale compliance e resistenze | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 | | |
| Punteggio | 3,000 | 3,000 | | | | | |
| 2.4 Rispondenza in termini di precisione e scostamento % dal target di frequenza respiratoria regolabile tra 6 o 40 atti/min in condizioni di normale compliance e resistenze | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 | | |
| Punteggio | 3,000 | 3,000 | | | | | |
| 2.5 Rispondenza in termini di precisione e scostamento % dal target di PEEP regolabile almeno nel range 1-20 cmH2O in condizioni di normale compliance e resistenze | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 | | |
| Punteggio | 3,000 | 3,000 | | | | | |
| 2.6 Valori dichiarati di flusso di picco inspiratorio (superiori a 90 l/min) | 1 | ≤90 l/min= 0 p.ti >90 l/min= 1 p.ti | | 230 | 260 | | |
| | | | | Punteggio | 1,000 | 1,000 | |
| 2.7 Modalità ventilatorie ulteriori rispetto a quelle previste in capitolato | 1 | Q1 | GRATAROLA | 0,50 | 0,50 | | |
| | | | PEZZATO | 0,50 | 0,50 | | |
| | | | BUCCHERI | 0,50 | 0,50 | | |
| | | | Media coefficienti | 0,50 | 0,50 | | |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 | | |
| Punteggio | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| 3. Monitoraggio: | | | | | | | |
| 3.1 Semplicità di avvio delle procedure di misura e delle manovre | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 | | |
| Punteggio | 3,000 | 3,000 | | | | | |

[Handwritten signatures and initials]

| | | | | | |
|---|---|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| 3.2 Monitoraggio frequenza respiratoria spontanea | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 | 3,000 |
| 3.3 Possibilità di interfacciamento con monitor esterni (ON/OFF) | 3 | Q5 | | ON | ON |
| | | | Punteggio | 1,000 | 1,000 |
| 3.4 Altri parametri monitorati di interesse clinico ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti dal capitolato | 3 | Q1 | GRATAROLA | 0,30 | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 0,30 | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 0,30 | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 0,30 | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 0,30 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 0,900 | 3,000 |
| 4. Gestione allarmi | | | | | |
| 4.1 Modalità di segnalazione allarmi con particolare attenzione alla struttura ed al trend delle informazioni | 5 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 5,000 | 5,000 |
| 4.2 Altri allarmi disponibili ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti dal capitolato | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 | 3,000 |
| 5. Alimentazione pneumatica ed elettrica | | | | | |
| 5.1 Sistema alimentabile anche ad aria (ON/OFF) | 3 | Q5 | | ON | ON |
| | | | Punteggio | 3,000 | 3,000 |
| 5.2 Autonomia batteria > 4 ore in modalità di ventilazione standard (ON/OFF) | 2 | Q5 | | ON | ON |
| | | | Punteggio | 2,000 | 2,000 |
| 6. Assistenza tecnica e formazione | | | | | |
| Valutazione relazione post-vendita e piano formativo | 5 | Q1 | GRATAROLA | 0,80 | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 0,80 | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 0,80 | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 0,80 | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 0,80 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 4,000 | 5,000 |
| Totale punteggio di qualità | | 60,00 | | 50,708 | 56,757 |
| Totale punteggio di qualità riparametrato | | | | 53,606 | 60,000 |

| LOTTO 5: VENTILATORE PER VENTILAZIONE CONVENZIONALE E AD ALTA FREQUENZA OSCILLATORIA PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE | | Max 6mmH ₂ O | Parametri di valutazione - valori a base di gara | Valutazioni Individuali | Valutazioni Individuali | |
|--|-------|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Requisiti essenziali | | | | PRESENTI | PRESENTI | |
| 1. Caratteristiche generali | | | | | | |
| 1.1 Peso (Kg): a minor peso corrisponde maggior punteggio | 1 | Q4* | | 16,00 | 20,00 | 24 base gara |
| | | | Punteggio | 1,000 | 0,500 | |
| 1.2 Dimensioni in cm (L*A*P): a minori dimensioni corrisponde maggior punteggio | 1 | Q4* | | 52966 | 44400 | 63599 base gara |
| | | | Punteggio | 0,554 | 1,000 | |
| 1.3 Anno di immissione in commercio: fino al 2014(incluso)=0 p.ti successivamente al 2014=1 p.ti | 1 | ≤2014=0 p.ti >2014=1 p.ti | | 2016 | 2015 | |
| | | | Punteggio | 1,000 | 1,000 | |
| 1.4 Facilità di smontaggio, smontaggio e pulizia dei blocchi in/espiratori | 2 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 0,20 | |
| | | | PEZZATO | 0,80 | 0,30 | |
| | | | BUCCHERI | 0,80 | 0,30 | |
| | | | Media coefficienti | 0,87 | 0,20 | |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 0,30 | |
| Punteggio | 2,000 | 0,600 | | | | |
| 1.5 Soluzioni di posizionamento | 1 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 0,30 | |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 0,20 | |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 0,20 | |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 0,20 | |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 0,20 | |
| Punteggio | 1,000 | 0,200 | | | | |
| 1.6 Orientabilità/Separabilità dei monitor (ON/OFF) | 1 | Q5 | | ON | OFF | |
| | | | Punteggio | 1,000 | 0,000 | |
| 1.7 Interfaccia utente: 1.7.1 Intuitività dell'interfaccia utente con particolare attenzione alla struttura logica delle informazioni | 3 | Q1 | GRATAROLA | 0,50 | 0,20 | |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 0,40 | |
| | | | BUCCHERI | 0,50 | 0,50 | |
| | | | Media coefficienti | 0,60 | 0,30 | |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 0,50 | |
| Punteggio | 3,000 | 1,500 | | | | |
| * 1.7 Interfaccia utente: 1.7.2 Ridotto numero di menù | 1 | Q1 | GRATAROLA | 0,50 | 0,50 | |
| | | | PEZZATO | 0,50 | 0,50 | |
| | | | BUCCHERI | 0,50 | 0,50 | |
| | | | Media coefficienti | 0,50 | 0,50 | |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 | |
| Punteggio | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 1.7 Interfaccia utente: 1.7.3 Accessibilità alle funzioni standard e avanzate con particolare attenzione alle modalità di recupero e visualizzazione dei dati di trend e di eventi | 2 | Q1 | GRATAROLA | 0,50 | 0,50 | |
| | | | PEZZATO | 0,50 | 0,50 | |
| | | | BUCCHERI | 0,50 | 0,50 | |
| | | | Media coefficienti | 0,50 | 0,50 | |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 | |
| Punteggio | 2,000 | 2,000 | | | | |
| 1.7 Interfaccia utente: 1.7.4 Caratteristiche del display migliorative con particolare riferimento alle dimensioni (esprese in pollici) | 2 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 0,40 | |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 0,30 | |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 0,30 | |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 0,30 | |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 0,30 | |
| Punteggio | 2,000 | 0,600 | | | | |
| 1.8 Facilità di impostazione delle modalità di ventilazione e di esecuzione delle manovre diagnostico/terapeutiche (es. P 0,1, nebulizzazione) | 3 | Q1 | GRATAROLA | 0,50 | 0,50 | |
| | | | PEZZATO | 0,50 | 0,50 | |
| | | | BUCCHERI | 0,50 | 0,50 | |
| | | | Media coefficienti | 0,50 | 0,50 | |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 | |
| Punteggio | 3,000 | 3,000 | | | | |
| 1.9 Funzione di help in linea per guidare l'operatore nell'impostazione dei parametri e nelle procedure (ON/OFF) | 3 | Q5 | | ON | ON | |
| | | | Punteggio | 3,000 | 3,000 | |
| 1.10 Nebulizzatore per aerosolterapia integrato nel corpo macchina (ON/OFF) | 2 | Q5 | | ON | ON | |
| | | | Punteggio | 2,000 | 2,000 | |
| 1.11 Requisiti di rendimento energetico E(KW/giorno) | 2 | Q4* | | N.D. | 2,40 | |
| | | | Punteggio | 0,000 | 2,000 | |
| 2. Modalità di ventilazione | | | | | | |
| 2.1 Facilità di avvio della ventilazione e calibrazione dei sensori | 2 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 0,30 | |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 0,20 | |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 0,20 | |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 0,20 | |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 0,20 | |
| Punteggio | 2,000 | 0,400 | | | | |
| 2.2 Ventilazioni convenzionali | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 0,90 | |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 0,90 | |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 0,90 | |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 0,90 | |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 0,90 | |
| Punteggio | 3,000 | 2,700 | | | | |
| 2.3 Ventilazioni PEEP | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 1,00 | |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 1,00 | |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 1,00 | |

| 2.3 Ventilazione | 2 | Q1 | Media coefficienti | 1,00 | 1,00 |
|--|---|----|--------------------|--------------|--------------|
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 | 3,000 |
| 2.4 Ventilazioni non Invasive neonatali | 2 | Q1 | GRATAROLA | 0,90 | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 0,90 | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 0,90 | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 0,90 | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 0,90 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 1,800 | 2,000 |
| 2.5 Presenza di sensore di flusso prossimale con anemometro a filo caldo o tecnologia equivalente | 4 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 0,80 |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 0,70 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 0,70 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 0,70 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 0,70 |
| | | | Punteggio | 4,000 | 2,800 |
| 2.6 Funzionalità del trigger | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 | 3,000 |
| 2.7 Controllo del volume tidale in ventilazione oscillatoria ad alta frequenza | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 | 3,000 |
| 2.8 Funzioni avanzate ed innovative di ventilazione protettiva con particolare riferimento al controllo del volume tidale anche in pz gravemente prematuri | 5 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 0,80 |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 0,80 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 0,70 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 0,70 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 0,70 |
| | | | Punteggio | 5,000 | 3,500 |
| 3. Caratteristiche del monitoraggio a lamina | | | | | |
| 3.1 Struttura e gestione dei dati monitorati: 3.1.1 numero e tipologia tracce e parametri | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 | 3,000 |
| 3.1 Struttura e gestione dei dati monitorati: 3.1.2 schermate predefinite | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 | 3,000 |
| 3.2 Tipologia e gestione degli allarmi | 4 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 4,000 | 4,000 |
| 3.3 Presenza di parametri monitorati di Interesse clinico ulteriori rispetto a quelli minimi indicati in capitolo | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 | 3,000 |
| 3.4 Presenza di allarmi ulteriori rispetto a quelli minimi indicati in capitolo | 2 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 | 0,50 |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 0,50 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 0,50 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 0,50 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 0,50 |
| | | | Punteggio | 2,000 | 1,000 |
| 4. Assistenza tecnica e formazione | | | | | |
| 4.1 condizioni migliorative assistenza post-vendita | 2 | Q1 | GRATAROLA | 0,50 | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 0,50 | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 0,50 | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 0,50 | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 0,50 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 1,000 | 2,000 |
| | | | GRATAROLA | 0,80 | 0,40 |
| | | | PEZZATO | 0,80 | 0,40 |

[Handwritten signature]

Scheda valutazione_lotti_5_8_9_10_11

| | | | | | |
|---|--------------|----|--------------------|---------------|---------------|
| 4.2 condizioni migliorative del piano formativo | 2 | Q1 | BUCCHERI | 0,80 | 0,40 |
| | | | Media coefficienti | 0,80 | 0,40 |
| | | | riportata a 1 | 0,80 | 0,40 |
| | | | Punteggio | 1,500 | 0,800 |
| | | | GRATARCLA | 1,00 | 1,00 |
| 4.3 Presenza, nel piano formativo, di tematiche dedicate all'ottimizzazione dell'efficienza energetica nell'utilizzo/manutenzione delle apparecchiature fornite | 1 | Q1 | PEZZATO | 1,00 | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 1,000 | 1,000 |
| Totale punteggio di qualità | 70,00 | | | 65,954 | 56,600 |
| Totale punteggio di qualità riparametrato | | | | 70,000 | 60,072 |

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a circular mark on the right, and initials 'AF' at the bottom.

| Lotto 9: Ventilatore per ventilazione non-invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità invasiva | Max punti | Parametri di valutazione (valori a base di gara) | Dräger Medical Italia spa - Evita Infinity V500 |
|--|-----------|--|---|
| Requisiti essenziali | | | Valutazioni Individuali |
| 1. Caratteristiche generali: | | | PRESENTI |
| 1.1 Peso (Kg): a minor peso corrisponde maggior punteggio | 1 | Q4* | 16,00 Punteggio 1,000 |
| 1.2 Dimensioni in cm (L*A*P): a minori dimensioni corrisponde maggior punteggio | 1 | Q4* | 117957 Punteggio 1,000 |
| 1.3 Anno di immissione in commercio: fino al 2014(incluso)=0 p.ti successivamente al 2014=1 p.ti | 1 | ≤2014=0 p.ti >2014=1 p.ti | 2009 Punteggio 0,000 |
| 1.4 Facilità di smontaggio, smontaggio e pulizia dei blocchi in/esplosori | 2 | Q1 | GRATAROLA 1,00 PEZZATO 1,00 BUCCHERI 1,00 Media coefficienti 1,00 riportata a 1 1,00 Punteggio 2,000 |
| 1.5 Soluzioni di posizionamento | 2 | Q1 | GRATAROLA 1,00 PEZZATO 1,00 BUCCHERI 1,00 Media coefficienti 1,00 riportata a 1 1,00 Punteggio 2,000 |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.6.1 Facilità avvio della ventilazione e calibrazione sensori | 2 | Q1 | GRATAROLA 0,80 PEZZATO 0,70 BUCCHERI 0,60 Media coefficienti 0,70 riportata a 1 1,00 Punteggio 2,000 |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.6.2 Intuitività dell'interfaccia utente con particolare attenzione alla struttura logica delle Informazioni accessibili | 3 | Q1 | GRATAROLA 0,60 PEZZATO 0,70 BUCCHERI 0,80 Media coefficienti 0,70 riportata a 1 1,00 Punteggio 3,000 |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.6.3 Ridotto numero di menù | 1 | Q1 | GRATAROLA 0,60 PEZZATO 0,70 BUCCHERI 0,80 Media coefficienti 0,70 riportata a 1 1,00 Punteggio 1,000 |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.6.4 Accessibilità alle funzioni standard e avanzate con particolare attenzione alle modalità di recupero e visualizzazione dei dati di trend e di eventi | 3 | Q1 | GRATAROLA 1,00 PEZZATO 1,00 BUCCHERI 1,00 Media coefficienti 1,00 riportata a 1 1,00 Punteggio 3,000 |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.6.5 Caratteristiche del display migliorativo rispetto a quelle minime indicate in capitolato | 1 | Q1 | GRATAROLA 0,60 PEZZATO 0,70 BUCCHERI 0,60 Media coefficienti 0,63 riportata a 1 1,00 Punteggio 1,000 |
| 1.7 Facilità di impostazione delle modalità di ventilazione ed esecuzione delle manovre diagnostico/terapeutiche (es. P0.1, nebulizzazione) | 3 | Q1 | GRATAROLA 1,00 PEZZATO 1,00 BUCCHERI 1,00 Media coefficienti 1,00 riportata a 1 1,00 Punteggio 3,000 |
| 1.8 Funzione di help in linea per guidare l'operatore nell'impostazione dei parametri e nelle procedure | 3 | Q5 | ON Punteggio 3,000 |
| 1.9 Nebulizzatore per aerosolterapia integrato nel corpo macchina | 2 | Q5 | ON Punteggio 2,000 |
| 1.11 Requisiti di rendimento energetico E(KW/giorno) | 2 | Q4* | n.d. Punteggio 0,000 |
| 2. Modalità di ventilazione: | | | GRATAROLA 1,00 PEZZATO 1,00 |

Handwritten signature and initials in the right margin of the table.

Scheda valutazione_Jotti_5_8_9_10_11

| | | | | |
|---|---|----|--------------------|-------|
| 2.1 Modalità di ventilazione convenzionale | 3 | Q1 | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 |
| | | | | |
| 2.2 Varietà delle opzioni ventilatorie effettuabili in modalità non-invasiva | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 |
| | | | | |
| 2.3 Ossigeno terapia ad alti flussi | 3 | Q5 | | ON |
| | | | Punteggio | 3,000 |
| 2.4 presenza di sensore di flusso prossimale con anemometro a filo caldo per la ventilazione neonatale o tecnologia equivalente | 4 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 4,000 |
| 2.5 Sistemi di calcolo punti di flessio | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 |
| 2.6 Opzioni ventilatore che assistano il pz in fase di svezzamento con passaggio automatico dalla modalità assistita a quella assistita-controllata | 4 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 4,000 |
| 2.7 Entità della compensazione delle perdite migliorativa rispetto a quella minima indicata in capitolato (> 50 L/min) | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 |
| 3. Caratteristiche del monitoraggio allarmi: | | | | |
| 3.1 Struttura e gestione dei dati monitorati: 3.1.1 numero e tipologia tracce e parametri | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 |
| 3.1 Struttura e gestione dei dati monitorati: 3.1.2 schermate predefinite | 3 | Q1 | GRATAROLA | 0,70 |
| | | | PEZZATO | 0,60 |
| | | | BUCCHERI | 0,70 |
| | | | Media coefficienti | 0,67 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 |
| 3.2 Tipologia e gestione degli allarmi | 4 | Q1 | GRATAROLA | 0,80 |
| | | | PEZZATO | 0,80 |
| | | | BUCCHERI | 0,80 |
| | | | Media coefficienti | 0,80 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 4,000 |
| 3.3 Presenza di parametri monitorati di interesse clinico ulteriori rispetto a quelli minimi indicati in capitolato | 3 | Q1 | GRATAROLA | 0,80 |
| | | | PEZZATO | 0,90 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 0,90 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 |
| 3.4 Presenza di allarmi ulteriori rispetto a quelli minimi indicati in capitolato | 2 | Q1 | GRATAROLA | 0,80 |
| | | | PEZZATO | 0,90 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 0,90 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |

Handwritten signature and initials.

| | | | Punteggio | 2,000 |
|---|--------------|----|--------------------|---------------|
| 4. Assistenza tecnica e formazione | | | | |
| 4.1 condizioni migliorative assistenza post-vendita | 2 | Q1 | GRATAROLA | 0,70 |
| | | | PEZZATO | 0,70 |
| | | | BUCCHERI | 0,70 |
| | | | Media coefficienti | 0,70 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 2,000 |
| 4.2 condizioni migliorative del piano formativo | 2 | Q1 | GRATAROLA | 0,70 |
| | | | PEZZATO | 0,70 |
| | | | BUCCHERI | 0,70 |
| | | | Media coefficienti | 0,70 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 2,000 |
| 4.3 Presenza, nel piano formativo, di tematiche dedicate all'ottimizzazione dell'efficienza energetica nell'utilizzo/manutenzione delle apparecchiature fornite | 1 | Q1 | GRATAROLA | 0,50 |
| | | | PEZZATO | 0,50 |
| | | | BUCCHERI | 0,50 |
| | | | Media coefficienti | 0,50 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 1,000 |
| Totale punteggio di qualità | 70,00 | | | 63,000 |
| Totale punteggio di qualità riparametrato | | | | 70,000 |

[Handwritten signatures and initials]

| Requisiti essenziali | Caratteristiche generali | Parametri di Valutazione (Valori base di gara) | Valutazioni Individuali | | | |
|--|--------------------------|--|----------------------------------|----------|----------|-------|
| | | | PRESENTI | PRESENTI | PRESENTI | |
| 1.1 Peso (Kg): a minor peso corrisponde maggior punteggio | 1 | Q4* | 16,00 | 31,00 | 19,00 | |
| 1.2 Dimensioni in cm (L*P): a minori dimensioni corrisponde maggior punteggio | 1 | Q4* | 117957 | 100958 | 126420 | |
| 1.3 Anno di immissione in commercio: fino al 2014 (inclusive)=0 p.u. successivamente al 2014=1 p.u. | 1 | ≤2014=0 p.u. >2014=1 p.u. | 2009 | 2015 | 2015 | |
| 1.4 Facilità di montaggio, smontaggio e pulizia dal Bocchi In/inspiratori | 2 | Q2 | GRATAROLA | 2,00 | 0,00 | 8,00 |
| | | | PEZZATO | 3,000 | 0 | 9,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,000 | 0 | 9,00 |
| | | | Media coefficienti riportata a 1 | 2,667 | 0 | 8,67 |
| | | | Punteggio | 0,308 | 0,000 | 1,000 |
| 1.5 Soluzioni di posizionamento | 2 | Q2 | GRATAROLA | 4,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | | PEZZATO | 3,00 | 0,00 | 9,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 0,00 | 9,00 |
| | | | Media coefficienti riportata a 1 | 3,33 | 0,00 | 9,33 |
| | | | Punteggio | 0,36 | 0,00 | 1,00 |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.5.1 Inutilità dell'interfaccia utente con particolare attenzione alla struttura logica delle informazioni accessibili | 3 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | | PEZZATO | 2,60 | 0,00 | 10,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | | Media coefficienti riportata a 1 | 2,67 | 0,00 | 10,00 |
| | | | Punteggio | 0,27 | 0,00 | 1,00 |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.6.2 Facilità di avvio della ventilazione e calibrazione dei sensori | 2 | Q2 | GRATAROLA | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | PEZZATO | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | BUCCHERI | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | Media coefficienti riportata a 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | Punteggio | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.6.3 Ridotto numero di menu | 1 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | PEZZATO | 3,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | Media coefficienti riportata a 1 | 3,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | Punteggio | 0,50 | 0,00 | 1,00 |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.6.4 Accessibilità alle funzioni standard e avanzate con particolare attenzione alle modalità di recupero e visualizzazione dei dati di trend e di eventi | 3 | Q2 | GRATAROLA | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | | | PEZZATO | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | | | BUCCHERI | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | | | Media coefficienti riportata a 1 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | | | Punteggio | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.6.5 Caratteristiche del display migliorativo rispetto a quello minimo indicato in capitolato | 1 | Q2 | GRATAROLA | 5,00 | 0,00 | 3,00 |
| | | | PEZZATO | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | | | BUCCHERI | 6,00 | 0,00 | 3,00 |
| | | | Media coefficienti riportata a 1 | 5,00 | 0,00 | 3,33 |
| | | | Punteggio | 1,00 | 0,00 | 0,67 |
| 1.7 Facilità di impostazione delle modalità di ventilazione e di esecuzione delle manovre diagnostico/terapeutiche (es. P.O.1, nebulizzazione) | 3 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 0,00 | 4,00 |
| | | | PEZZATO | 4,00 | 0,00 | 3,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | Media coefficienti riportata a 1 | 3,33 | 0,00 | 4,00 |
| | | | Punteggio | 0,83 | 0,00 | 1,00 |
| 1.8 Funzione di help in linea per guidare l'operatore nell'impostazione dei parametri e nelle procedure | 3 | Q6 | ON | ON | ON | |
| 1.9 Nebulizzatore per aerosolterapia integrato nel corpo macchina | 2 | Q5 | ON | ON | ON | |
| 1.10 Requisiti di rendimento energetico E[KW/giorno] | 2 | Q4* | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 2. Modalità di ventilazione: | | | | | | |
| 2.1 Modalità di ventilazione convenzionale | 3 | Q2 | GRATAROLA | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | PEZZATO | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | BUCCHERI | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | Media coefficienti riportata a 1 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | Punteggio | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.2 Presenza di sensore di flusso prossimale con anemometro a filo caldo per la ventilazione neonatale | 3 | Q2 | GRATAROLA | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | PEZZATO | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | BUCCHERI | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | Media coefficienti riportata a 1 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | Punteggio | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.3 Modalità di ventilazione non invasiva opzionali | 3 | Q2 | GRATAROLA | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | PEZZATO | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | BUCCHERI | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | Media coefficienti riportata a 1 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | Punteggio | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.4 Opzioni ventilatorie che assistono il pz. in fase di svegliamento con passaggio automatico dalle modalità assistite a quelle assistita-controlate | 3 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 4,00 | 3,00 |
| | | | PEZZATO | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | | | Media coefficienti riportata a 1 | 3,33 | 1,33 | 3,33 |
| | | | Punteggio | 1,00 | 0,40 | 1,00 |
| 2.5 Software di assistenza al reclutamento alveolare che non prevedano l'utilizzo di metilene di ossigeno | 3 | Q2 | GRATAROLA | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | PEZZATO | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | BUCCHERI | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | Media coefficienti riportata a 1 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | Punteggio | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

37 base gara
151704 base gara

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 2 | 3 | 3 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 4 | 3 | 4 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 4 | 3 | 5 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 4 | 3 | 3 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 4 | 3 | 3 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 6 | 6 | 6 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 3 | 2 | 3 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 4 | 4 | 4 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 8 | 6 | 6 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 4 | 4 | 4 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 4 | 4 | 4 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 2 | 2 | 2 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 4 | 4 | 4 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 3 | 3 | 3 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 3 | 3 | 3 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 2 | 3 | 4 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 2 | 2 | 2 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 3 | 4 | 3 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 2 | 3 | 2 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 3 | 2 | 4 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 2 | 3 | 2 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 2 | 3 | 2 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|---|--------------|----|---|---|---|---|
| 2.5 Funzioni avanzate ed innovative di: 2.5.1 Ventilazione prolettiva | 3 | Q2 | PEZZATO BUCCHERI Media coefficienti riferita a 1 Punteggio | 2,00 2,00 2,00 1,00 3,000 | 2,00 2,00 2,00 1,00 3,000 | 2,00 2,00 2,00 1,00 3,000 |
| 2.6 Funzioni avanzate ed innovative di: 2.6.2 Soluzioni tecnologiche per la sincronizzazione macchina-paziente | 5 | Q2 | GRATAROLA PEZZATO BUCCHERI Media coefficienti riferita a 1 Punteggio | 1,00 1,00 1,00 1,00 0,14 0,714 | 1,00 1,00 1,00 1,00 0,14 0,714 | 8,00 6,00 7,00 7,00 1,00 5,000 |
| 3. Caratteristiche del monitoraggio e allarmi | | | | | | |
| 3.1 Struttura e gestione dei dati monitorati: 3.1.1 numero e tipologia tracce e parametri | 3 | Q2 | GRATAROLA PEZZATO BUCCHERI Media coefficienti riferita a 1 Punteggio | 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,000 | 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,000 | 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,000 |
| 3.1 Struttura e gestione dei dati monitorati: 3.1.2 schermate predefinite | 3 | Q2 | GRATAROLA PEZZATO BUCCHERI Media coefficienti riferita a 1 Punteggio | 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,000 | 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,000 | 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,000 |
| 3.2 Tipologia e gestione degli allarmi | 4 | Q2 | GRATAROLA PEZZATO BUCCHERI Media coefficienti riferita a 1 Punteggio | 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 4,000 | 2,00 2,00 2,00 2,00 0,20 0,800 | 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 4,000 |
| 3.3 Presenza di parametri monitorati di interesse clinico ulteriori rispetto a quelli minimi indicati in capitolato | 3 | Q2 | GRATAROLA PEZZATO BUCCHERI Media coefficienti riferita a 1 Punteggio | 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,000 | 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,000 | 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,000 |
| 3.4 Presenza di allarmi ulteriori rispetto a quelli minimi indicati in capitolato | 2 | Q2 | GRATAROLA PEZZATO BUCCHERI Media coefficienti riferita a 1 Punteggio | 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,000 | 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,000 | 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,000 |
| 4. Assistenza tecnica e formazione | | | | | | |
| 4.1 condizioni migliorative assistenza post-vendita | 2 | Q2 | GRATAROLA PEZZATO BUCCHERI Media coefficienti riferita a 1 Punteggio | 1,00 1,00 1,00 1,00 0,13 0,250 | 8,00 8,00 8,00 8,00 1,00 2,000 | 1,00 1,00 1,00 1,00 0,13 0,250 |
| 4.2 condizioni migliorative del piano formativo | 2 | Q2 | GRATAROLA PEZZATO BUCCHERI Media coefficienti riferita a 1 Punteggio | 9,00 7,00 9,00 8,33 1,00 2,000 | 3,00 4,00 3,00 3,33 0,40 0,800 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 |
| 4.3 Presenza, nel piano formativo, di tematiche dedicate all'ottimizzazione dell'efficienza energetica nell'utilizzo/manutenzione delle apparecchiature fornite | 1 | Q2 | GRATAROLA PEZZATO BUCCHERI Media coefficienti riferita a 1 Punteggio | 4,00 5,00 4,00 4,33 1,00 1,000 | 4,00 5,00 4,00 4,33 1,00 1,000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 |
| Totale punteggio di qualità | 70,00 | | | 54,859 | 39,800 | 62,272 |
| Totale punteggio di qualità riparametrato | | | | 61,667 | 44,739 | 70,000 |

| Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH | Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH |
|-------------------|--------|-------|-------|-------------------|--------|-------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH | Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH |
|-------------------|--------|-------|-------|-------------------|--------|-------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 3 | 2 | 4 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 5 | 4 | 3 |

| Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH | Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH |
|-------------------|--------|-------|-------|-------------------|--------|-------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH | Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH |
|-------------------|--------|-------|-------|-------------------|--------|-------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH | Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH |
|-------------------|--------|-------|-------|-------------------|--------|-------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH | Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH |
|-------------------|--------|-------|-------|-------------------|--------|-------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH | Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH |
|-------------------|--------|-------|-------|-------------------|--------|-------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH | Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH |
|-------------------|--------|-------|-------|-------------------|--------|-------|-------|
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | GE MEDICAL ITALIA | 4 | 4 | 4 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 4 | 4 | 4 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |

| Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH | Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH |
|-------------------|--------|-------|-------|-------------------|--------|-------|-------|
| DRAEGER | 4 | 3 | 4 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 6 | 4 | 5 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| GE MEDICAL ITALIA | 3 | 4 | 3 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |

| Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH | Ditta | GRATIA | PEZZA | BUCCH |
|-------------------|--------|-------|-------|-------------------|--------|-------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 3 | 4 | 3 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| GE MEDICAL ITALIA | 3 | 4 | 3 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |

[Handwritten signatures and initials]

| LOTTO 11 - Apparecchio a circuito aperto, semi-chiuso e chiuso a bassi flussi per anestesia neonatale e pediatrica utilizzabile anche su pz adulto | Max. punti | Parametri di valutazione: valori a base di gara | | Strategia Medical Italia SpA - Persues |
|---|-------------------|--|--------------------|---|
| | | | | Valutazioni Individuali |
| Requisiti essenziali | | | | PRESENTI |
| 1. Caratteristiche generali: | | | | |
| 1.1 Peso (Kg): a minor peso corrisponde maggior punteggio | 1 | Q4* | | 150,00 |
| | | | <i>Punteggio</i> | 1,000 |
| 1.2 Dimensioni in cm (L*A*P): a minori dimensioni corrisponde maggior punteggio | 1 | Q4* | | 1344580 |
| | | | <i>Punteggio</i> | 1,000 |
| 1.3 Anno di immissione in commercio: fino al 2014(incluso)=0 p.ti successivamente al 2014=1 p.ti | 1 | ≤2014=0 p.ti >2014=1 p.ti | | 2012 |
| | | | <i>Punteggio</i> | 0,000 |
| 1.4 Smontaggio testata paziente senza ausilio di attrezzi (ON/OFF) | 2 | Q6 | | ON |
| | | | <i>Punteggio</i> | 2,000 |
| 1.5 Disponibilità di ganoli, illuminazione, cassettei portoggetti | 2 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | <i>Punteggio</i> | 2,000 |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.6.1 Ridotto numero di menù | 2 | Q1 | GRATAROLA | 0,80 |
| | | | PEZZATO | 0,70 |
| | | | BUCCHERI | 0,80 |
| | | | Media coefficienti | 0,77 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | <i>Punteggio</i> | 2,000 |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.6.2 accessibilità alle funzioni standard | 3 | Q1 | GRATAROLA | 0,70 |
| | | | PEZZATO | 0,70 |
| | | | BUCCHERI | 0,60 |
| | | | Media coefficienti | 0,67 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | <i>Punteggio</i> | 3,000 |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.6.3 Accessibilità alle funzioni avanzate con particolare attenzione alle modalità di recupero e visualizzazione dei dati di trend e grafici | 3 | Q1 | GRATAROLA | 0,70 |
| | | | PEZZATO | 0,50 |
| | | | BUCCHERI | 0,80 |
| | | | Media coefficienti | 0,67 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | <i>Punteggio</i> | 3,000 |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.6.4 Configurazione e personalizzazione del display | 2 | Q1 | GRATAROLA | 0,90 |
| | | | PEZZATO | 0,80 |
| | | | BUCCHERI | 0,90 |
| | | | Media coefficienti | 0,87 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | <i>Punteggio</i> | 2,000 |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.6.5 Cambio modalità ventilatoria ed impostazione | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | <i>Punteggio</i> | 3,000 |
| 1.6 Interfaccia utente: 1.6.6 Integrità con sistema di infusione per la registrazione ed interpretazione dei dati di farmacocinetica e farmacodinamica | 3 | Q1 | GRATAROLA | 0,60 |
| | | | PEZZATO | 0,70 |
| | | | BUCCHERI | 0,50 |
| | | | Media coefficienti | 0,60 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | <i>Punteggio</i> | 3,000 |
| 2. Caratteristiche del ventilatore: | | | | |
| 2.1 Modalità di ventilazione richieste e impostazione | 5 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | <i>Punteggio</i> | 5,000 |
| 2.2 Modalità di ventilazione avanzate | 5 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|-----|--------------------|--------------|
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 5,000 |
| 2.3 Ventilazione manuale con arricchimento di gas alogenato | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 |
| 2.4 Funzionamento e disaccoppiamento dei gas freschi | 3 | Q1 | GRATAROLA | 0,50 |
| | | | PEZZATO | 0,50 |
| | | | BUCCHERI | 0,50 |
| | | | Media coefficienti | 0,50 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 |
| 2.5 Assenza di Auto-Peep | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 |
| 2.6 Ulteriori modalità di ventilazione protettiva implementabili (APRV-BiLevel) | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 |
| 2.7 Calcolo della compliance e delle perdite del sistema respiratorio inclusi i tubi pz | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 3,000 |
| 2.8 Requisito di rendimento energetico | 2 | Q4* | | N.D. |
| | | | Punteggio | 0,000 |
| 3. Caratteristiche del monitoraggio acquistabile separatamente | | | | |
| 3.1. Modulo da trasporto | 4 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 4,000 |
| 3.2 Configurabilità schermate | 2 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 2,000 |
| 3.3 Integrazione con ulteriori parametri (es. PVI, SpHb, SpiVet) | 2 | Q1 | GRATAROLA | 0,80 |
| | | | PEZZATO | 0,90 |
| | | | BUCCHERI | 0,80 |
| | | | Media coefficienti | 0,83 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 2,000 |
| 3.4 Monitoraggio SpO2 con tecnologia Oximax-Masimo o equivalente | 2 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 2,000 |
| 3.4 Dimensioni del display (> 19 pollici) | 1 | Q3 | | 20,10 |
| | | | Punteggio | 1,000 |
| | | | GRATAROLA | 1,00 |

| | | | | |
|---|--------------|----|--------------------|---------------|
| 3.5 Visualizzazione in contemporanea dal monitor di lavoro dei dati monitorati presso diversi posti letto pz | 2 | Q1 | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 2,000 |
| 3.6 Ulteriori caratteristiche migliorative del sistema di monitoraggio | 2 | Q1 | GRATAROLA | 0,60 |
| | | | PEZZATO | 0,50 |
| | | | BUCCHERI | 0,60 |
| | | | Media coefficienti | 0,50 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| Punteggio | 2,000 | | | |
| 4. Assistenza tecnica e formazione | | | | |
| 4.1 condizioni migliorative assistenza post-vendita | 2 | Q1 | GRATAROLA | 0,00 |
| | | | PEZZATO | 0,00 |
| | | | BUCCHERI | 0,00 |
| | | | Media coefficienti | 0,00 |
| | | | riportata a 1 | 0,00 |
| Punteggio | 0,000 | | | |
| 4.2 condizioni migliorative del piano formativo | 2 | Q1 | GRATAROLA | 0,80 |
| | | | PEZZATO | 0,70 |
| | | | BUCCHERI | 0,80 |
| | | | Media coefficienti | 0,70 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| Punteggio | 2,000 | | | |
| 4.3 Presenza, nel piano formativo, di tematiche dedicate all'ottimizzazione dell'efficienza energetica nell'utilizzo/manutenzione delle apparecchiature fornite | 1 | Q1 | GRATAROLA | 0,00 |
| | | | PEZZATO | 0,00 |
| | | | BUCCHERI | 0,00 |
| | | | Media coefficienti | 0,00 |
| | | | riportata a 1 | 0,00 |
| Punteggio | 0,000 | | | |
| Totale punteggio di qualità | 70,00 | | | 64,000 |
| Totale punteggio di qualità riparametrato | | | | 70,00 |

4

Prof. n. 9162 del 29/06/2017

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016,
per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi
per anestesia e ventilatori polmonari ad uso ospedaliero occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS
della Regione Liguria
per un periodo di anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)
Lotti n. 11 - N. gara: 6621976

**Quarta seduta riservata della Commissione Giudicatrice (prova pratica apparecchiature
offerte Lotti 1, 2 e 3)**

28 giugno 2017

Il giorno 28 del mese di giugno dell'anno 2017, alle ore 10:00 presso il Padiglione Specialità dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, al 1° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 5/2016, con determinazione n. 110 del 20.3.2017 per le operazioni di valutazione della idoneità/qualità delle apparecchiature presentate dalle Ditte concorrenti relativamente ai lotti 1, 2 e 3.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice:

| Cognome | Nome | Struttura | |
|-----------|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| GRATAROLA | Dott. Angelo | A.O.U./IRCCS San Martino | in qualità di Presidente |
| BUCCHERI | Ing. Massimo | ASL 5 Spezzina | in qualità di Componente |
| PEZZATO | Dott. Stefano | IRCCS Giannina Gaslini | in qualità di Componente |

Sono presenti per la Centrale Acquisti il Dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente, e la Dott.ssa Tiziana Tazzoli, Collaboratore Amministrativo, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

Il Dott. Costa ricorda, quindi, che il Disciplinare di Gara prevedeva, ai fini della valutazione delle apparecchiature offerte, la prova pratica delle medesime presso strutture del SSR. La Centrale di Acquisto, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Giudicatrice nella precedente seduta del 21 giugno 2017, ha provveduto – con nota prot. n. 8937 del 23.6.2017 – alla convocazione formale delle Ditte ammesse per la presentazione delle apparecchiature relative ai Lotti 1, 2 e 3.

Gli esiti della valutazione verranno riportati, per comodità di consultazione, nella tabella (file excel) denominata "Scheda valutazione Lotti 1_2_3" allegata al presente verbale quale parte integrante sostanziale.

Il Dott. Costa dà altresì atto che le Ditte convocate per i Lotti esaminati hanno regolarmente presentato la documentazione che era stata richiesta ai fini della prova pratica, ovvero dichiarazione di manleva e copia della polizza assicurativa RCT.

Lotto 1 (Apparecchio per anestesia di alta fascia + monitoraggi):

- Draeger Medical Italia spa: Zeus IE
- GE Medical Systems Italia spa: Aysis CS2
- Maquet Italia spa: Flow iC20

Lotto 2 (Apparecchio per anestesia di base):

- Draeger Medical Italia spa - Primus 2002
- GE Medical Systems spa - Carestation 650

- Maquet Italia spa: Flow IC20
- Mindray Medical Italy s.r.l.: Wato ex 65 pro

Lotto 3 (Apparecchio per terapia intensiva):

- Draeger Medical Italia spa – Evita Infiniy V500
- * ➤ GE Medical Systems Italia spa – Careescape R860
- Maquet Italia spa – Servo-U
- Burke&Burke spa: Hamilton G5

La Commissione Giudicatrice verificherà preliminarmente che le apparecchiature esibite in prova corrispondano ai modelli dichiarati dalle Ditte partecipanti nella documentazione tecnica, come sopra riportati.

La Commissione avrà cura di assegnare a ciascuna delle Ditte presenti lo stesso tempo di prova delle apparecchiature in proporzione ai lotti partecipati. Per ragioni di imparzialità e trasparenza la Commissione procede per ciascun Lotto, alla presenza dei rappresentanti delle Ditte intervenuti, al sorteggio delle Ditte al fine di stabilire l'ordine di prova.

- Lotto 1: sorteggio effettuato dalla Sig.ra Di Diego Valentina della Società GE Medical Systems spa :1° estratto GE Medical Systems Italia spa; 2° estratto Draeger Medical Italia spa; 3° estratto Maquet Italia spa.

La Commissione inizia quindi a visionare l'apparecchiatura offerta per il Lotto 1 dalla Società GE prima estratta, per la quale sono presenti i Sig.ri Alessandro Puppo, Nadia Pasotti, Valentina Di Diego ed Emanuele Vandone. La prova ha inizio alle ore 10:00 e termina alle ore 10:26.

La Commissione procede, quindi, a visionare l'apparecchiatura offerta dalla Società 2°estratta, Draeger Medical Italia, per la quale sono presenti i Sig.ri Lorenzo Pandolfi, Stefano Sartori e Tatiana Baruffi.

La prova ha inizio alle ore 10:33 e termina alle ore 11:00.

Viene, quindi, visionata l'apparecchiatura offerta dalla Società Maquet Italia, terza estratta, per la quale sono presenti i Sig.ri Emiliano Pagani e Massimo Di Carpegna Varini. La prova inizia alle ore 11:07 termina alle ore 11:35.

La Commissione procede, quindi ad attribuire i punteggi alle offerte presentate per il lotto 1. I punteggi sono riportati nel file excel Scheda valutazione lotti_1_2_3 allegata al presente verbale. Relativamente al Lotto 1 i dati oggettivi relativi ai parametri 1.1,1.2,1.3,1.6,1.7.1,1.7.2,1.8.4,1.8.5 e 2.7, rilevati da scheda tecnica di prodotto ed ulteriormente verificati nel corso della prova pratica vengono riportati nella scheda di valutazione formato excel sopra indicata per il calcolo automatico del punteggio sulla base dei criteri e delle formule di calcolo specificate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico. I parametri qualitativi di natura intangibile vengono, invece, valutati tramite il metodo del confronto a coppie come previsto dal Disciplinare di Gara, secondo la matrice riportata nella Scheda valutazione allegata al presente verbale (foglio excel).

Terminate le valutazioni relative al Lotto 1, la Commissione procede alla prova delle apparecchiature offerte per il Lotto 2. Anche in questo caso si procede al sorteggio effettuato dal Sig. Massimo Campi della Società Draeger. Viene sorteggiato il seguente ordine di prova:1° GE Medical Systems Italia spa; 2° Maquet Italia spa; 3°Mindray Medical Italy spa; 4° Draeger Medical Italia spa.

La prova dell'apparecchiatura offerta dalla Società GE per il Lotto 2 (Carestation 650), per la quale si confermano gli stessi rappresentanti della prova relativa al Lotto 1, ha inizio alle ore 12:27 e termina alle ore 12:41. La Commissione procede quindi a visionare l'apparecchiatura offerta dalla Società seconda estratta, Maquet Italia spa, per la quale sono presenti gli stessi rappresentanti indicati per il Lotto 1. La prova ha inizio alle ore 12:44 e termina alle ore 13:00.

La Commissione sospende i lavori dalle ore 13:30 alle ore 14:30 per la pausa pranzo.

I lavori della Commissione riprendono alle ore 14:41 con l'esame dell'apparecchio Wato ex 65 pro offerto dalla Società Mindray Medical Italy (3° estratta), per la quale sono presenti i Sig.ri Domenico Atzei, Andrea Lanzoni, Fabio Sgarella. La prova termina alle ore 15:20. Viene quindi visionata l'ultima apparecchiatura offerta per il Lotto 2 della Società Draeger ultima estratta (Primus 2002), per la quale è presente altresì il Sig. Massimo Campi. La prova inizia alle ore 15:24 e termina alle ore 15:40.

La Commissione procede, quindi, all'attribuzione dei punteggi relativi al Lotto 2. I punteggi sono riportati nel file excel Scheda valutazione lotti_1_2_3 allegata al presente verbale. Relativamente al Lotto 2 i dati oggettivi relativi ai parametri 1.1, 1.2,1.3,1.6,1.7.1,1.7.2,1.8.4,1.8.5,2.7 rilevati da scheda tecnica di prodotto ed ulteriormente verificati nel corso della prova pratica vengono riportati nella scheda di valutazione formato excel sopra indicata per il calcolo automatico del punteggio sulla base dei criteri e delle formule di calcolo specificate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico. I parametri qualitativi di natura intangibile vengono, invece,

valutati tramite il metodo del confronto a coppie come previsto dal Disciplinare di Gara, secondo la matrice riportata nella Scheda valutazione allegata al presente verbale (foglio excel).

Terminata la valutazione del Lotto 2, si procede al sorteggio per il Lotto 3. Sorteggia il Sig. Marco Bombarolo della Società Burke&Burke spa. Viene sorteggiato il seguente ordine di prova:

1° Maquet Italia spa; 2° GE Medical Systems Italia spa; 3° Draeger Medical Italia spa; 4° Burke&Burke spa. Alle ore 16:25 inizia la prova dell'apparecchio (Servo-U) offerto per il Lotto 3 dalla Società Maquet Italia spa, per la quale è presente il Sig. Federico Araldi. La prova termina alle ore 16:40.

Viene quindi esaminata l'apparecchiatura offerta dalla società 2° estratta GE Medical Systems Italia spa (Carescape R860) per la quale interviene la Sig.ra Benedetta Mangiante. La prova inizia alle ore 16:42 e termina alle ore 16:58.

La Commissione passa ad esaminare lo strumento offerto dalla Società Draeger Medical Systems spa (3° estratta), Infinity Evita VS 500. Per la Società Draeger è altresì presente il Sig. Enrico Buttafuoco. La prova inizia alle ore 17:00 e termina alle ore 17:15.

Infine, viene esaminata l'apparecchiatura (Hamilton G5) offerta dalla Società Burke&Burke ultima estratta, per la quale sono presenti i Sig.ri Bombarolo, Brambilla, Zodiaci e Garofalo. La prova ha inizio alle ore 17:20 e termina alle ore 17:40.

Terminata la prova pratica delle apparecchiature offerte per il Lotto 3, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi di qualità. I punteggi sono riportati nel file excel Scheda valutazione lotti_1_2_3 allegata al presente verbale. Relativamente al Lotto 3 i dati oggettivi relativi ai parametri 1.1,1.2,1.3, 1.5,1.7, 1.9.5, 1.10, rilevati da scheda tecnica di prodotto ed ulteriormente verificati nel corso della prova pratica vengono riportati nella scheda di valutazione formato excel sopra indicata per il calcolo automatico del punteggio sulla base dei criteri e delle formule di calcolo specificate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico. I parametri qualitativi di natura intangibile vengono, invece, valutati tramite il metodo del confronto a coppie come previsto dal Disciplinare di Gara, secondo la matrice riportata nella Scheda valutazione allegata al presente verbale (foglio excel).

In chiusura di seduta la Commissione conferma che le prove pratiche relative ai Lotti 4 e 6 si svolgeranno, stessa sede, in data 26 luglio 2017 dalle ore 10:00.

Si mette altresì a verbale che il RUP e la Commissione Giudicatrice hanno comunicato ai rappresentanti delle Ditte intervenuti alle prove pratiche che l'apertura delle offerte economiche verrà effettuata in data 17 agosto 2017 e che i rappresentanti medesimi hanno confermato la propria disponibilità ad essere presenti.

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale agli atti della Centrale.

La seduta è tolta alle ore 18:40

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Angelo GRATAROLA
Presidente

Dott. Stefano PEZZATO
Componente

Ing. Massimo BUCCHERI
Componente

Dott. Luigi Moreno COSTA

Dott.ssa Tiziana TAZZOLI
Segretario

All.to
Scheda di valutazione lotti 1, 2, 3

| REQUISITI ESSENZIALI | | | Valore base | | |
|--|---|----------------------------|-------------|----------|----------|
| REQUISITI ESSENZIALI | | | PRESENTI | PRESENTI | PRESENTI |
| 1. Caratteristiche generali | | | | | |
| 1.1 Peso (Kg) e minor peso corrisponde maggior punteggio | 1 | Q4* | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 1.2 Dimensioni in cm (L*P*P), a minori dimensioni corrisponde maggior punteggio | 1 | Q4* | 1270000 | 746222 | 1022490 |
| 1.3 Anno di formulazione in commercio fino al 2014 (incluso) o p.f. successivamente al 2014=1 p.f. | 1 | S282790 P.M. > 2014=1 p.f. | 2015 | 2013 | 2010 |
| 1.4 Disponibilità di grandi supporti di lettura, lamina, cinescopi touch screen | 2 | Q2 | 0,00 | 5,00 | 2,00 |
| 1.5 Facilità di accensione, pulizia, disinfezione | 2 | Q2 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.6 Dotazione di funzioni avanzate help in linea | 2 | Q5 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.7 Consenso di unico software: 1.7.1 possibilità di utilizzo di canali di colore esotici (grappoli o riutilizzabili senza rischio di addebiatori) | 2 | Q5 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.7 Consenso di unico software: 1.7.2 Possibilità di sostituzione della sonda esotica senza interferenza della visualizzazione | 1 | Q3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 Interfaccia utente: 1.8.1 Configurazione e personalizzazione del Display | 2 | Q2 | 0,00 | 2,00 | 0,300 |
| 1.8 Interfaccia utente: 1.8.2 Inibibilità test di sistema | 2 | Q2 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 1.8 Interfaccia utente: 1.8.3 Accessibilità alla Anziani visuale e avanzata | 2 | Q2 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 1.8 Interfaccia utente: 1.8.4 Display orientabile a 350° | 1 | Q6 | 0,00 | 1,000 | 1,000 |
| 1.8 Interfaccia utente: 1.8.5 Display touch screen | 1 | Q5 | 0,00 | 1,000 | 1,000 |
| 2. Caratteristiche del ventilatore | | | | | |
| 2.1 Sistema di ventilazione con concezione ascendente ben visibile | 2 | Q2 | 1,00 | 12,00 | 1,00 |
| 2.2 Compensazione del volume corrente e del flusso gas freschi | 3 | Q2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2.3 Programmabilità automatica di insonore per il richiamo polmonare | 2 | Q2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2.4 Manutenzione e gestione del vaporizzatore | 2 | Q2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2.5 Funzionalità del sistema di verifica della perfusione | 2 | Q2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2.6 Modalità vascolare aggiuntive rispetto a quelle previste in capitolato | 2 | Q2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2.7 Requisiti di rendimento energetico (elettronici come specificato al paragrafo E) | 2 | Q4* | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Caratteristiche del monitor, display e schermo | | | | | |
| 3.1 Consistenza interfaccia utente con qualità del venditore | 3 | Q2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3.2 Modularità | 3 | Q2 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3.3 Altri parametri di interesse clinico forniti in offerta aggiuntiva rispetto a quelli indicati in capitolato | 2 | Q2 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |

Handwritten notes and signatures:
 28
 1524600 base gara

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | GE MEDICAL ITALIA | 4 | 0 | 4 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 2 | 2 | 5 |
| GE MEDICAL ITALIA | 2 | 2 | 2 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | GE MEDICAL ITALIA | 4 | 3 | 3 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | GE MEDICAL ITALIA | 3 | 2 | 4 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 2 | 8 | 4 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | GE MEDICAL ITALIA | 4 | 3 | 3 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 3 | 4 | 3 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | GE MEDICAL ITALIA | 6 | 0 | 6 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | GE MEDICAL ITALIA | 2 | 2 | 2 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 2 | 2 | 2 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH | Ditta | GRAT | PEZZ | BUCCH |
|-------------------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | GE MEDICAL ITALIA | 2 | 2 | 2 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 2 | 2 | 2 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| | | | | 0,000 | 2,000 | 2,000 |
|---|--------------|----|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.4 Caratteristica del insonnifero del blocco materacolare (es. possibilità insonorizzazione, possibilità di scegliere il tipo di insonorizzazione, il tipo di materacolare ecc.) | 2 | 02 | GRATAROLA | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | | PEZZATO | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | | BUCCHERI | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | | Media coefficienti | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | | ripetibile a 1 | 4,00 | 0,25 | 0,25 |
| | | | Riporto | 2,000 | 0,500 | 0,500 |
| | | | Punteggio | | | |
| 4. Funzioni di sicurezza | | | | | | |
| 4.1 Volume interno del coccodrillo e protezione a base di busti | 3 | 02 | GRATAROLA | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | PEZZATO | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | BUCCHERI | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | Media coefficienti | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | ripetibile a 1 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Riporto | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| | | | Punteggio | | | |
| 4.2 Filtranti di protezione contro l'ipotesi | 3 | 02 | GRATAROLA | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | PEZZATO | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | BUCCHERI | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | Media coefficienti | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | ripetibile a 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Riporto | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| | | | Punteggio | | | |
| 4.3 Modalità di protezione automatica di gestione dell'annatale inalata basata su target | 4 | 02 | GRATAROLA | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | PEZZATO | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | BUCCHERI | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | Media coefficienti | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | ripetibile a 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Riporto | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| | | | Punteggio | | | |
| 5. Funzionalità cliniche | | | | | | |
| 5.1 Loop e misure di insonorizzazione respiratoria | 6 | 02 | GRATAROLA | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | PEZZATO | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | BUCCHERI | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | Media coefficienti | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | ripetibile a 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Riporto | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| | | | Punteggio | | | |
| 6.2 Funzioni di supporto alla ventilazione polmonare protettiva | 4 | 02 | GRATAROLA | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | PEZZATO | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | BUCCHERI | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | Media coefficienti | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | ripetibile a 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Riporto | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| | | | Punteggio | | | |
| 6. Assistenza tecnica e formazione | | | | | | |
| 6.1 Condizioni migliorativa dell'assistenza post-vendita | 2 | 02 | GRATAROLA | 1,00 | 8,00 | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 8,00 | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 8,00 | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 8,00 | 1,00 |
| | | | ripetibile a 1 | 0,15 | 1,00 | 0,15 |
| | | | Punteggio | 0,250 | 2,000 | 0,250 |
| | | | Punteggio | | | |
| 6.2 Condizioni migliorativa del piano formativo | 2 | 02 | GRATAROLA | 9,00 | 3,00 | 0,00 |
| | | | PEZZATO | 7,00 | 4,00 | 0,00 |
| | | | BUCCHERI | 9,00 | 3,00 | 0,00 |
| | | | Media coefficienti | 8,33 | 3,33 | 0,00 |
| | | | ripetibile a 1 | 1,00 | 0,40 | 0,00 |
| | | | Punteggio | 2,000 | 0,800 | 0,000 |
| | | | Punteggio | | | |
| 6.3 Presenza nel piano formativo di tematiche dedicate all'utilizzazione dell'efficace erogazione nell'utilizzazione dell'apparecchiatura | 1 | 02 | GRATAROLA | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| | | | PEZZATO | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| | | | BUCCHERI | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| | | | Media coefficienti | 4,33 | 4,33 | 0,00 |
| | | | ripetibile a 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | | Riporto | 3,000 | 4,000 | 0,000 |
| | | | Punteggio | | | |
| Totale punteggio di qualità | 70,00 | | | 49,577 | 64,722 | 56,704 |
| Totale punteggio di qualità riparametrato | | | | 53,619 | 70,00 | 61,328 |

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|-------------------|-----------|---------|----------|-------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 2 | 2 | 2 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 2 | 2 | 2 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|-------------------|-----------|---------|----------|-------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|-------------------|-----------|---------|----------|-------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|-------------------|-----------|---------|----------|-------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|-------------------|-----------|---------|----------|-------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|-------------------|-----------|---------|----------|-------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|-------------------|-----------|---------|----------|-------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | GE MEDICAL ITALIA | 4 | 4 | 4 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 4 | 4 | 4 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|-------------------|-----------|---------|----------|-------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 4 | 3 | 4 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 3 | 4 | 5 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| GE MEDICAL ITALIA | 3 | 4 | 3 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|-------------------|-----------|---------|----------|-------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 3 | 4 | 3 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| GE MEDICAL ITALIA | 3 | 4 | 3 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |

[Handwritten signatures and initials]

| Descrizione | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
|--|--------------------|--------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|-----|
| 3.2 Modularità | GRATAROLA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| | PEZZATO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| | BUCCHIERI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| | Medie coefficienti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| | Apertura n°1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | Punteggio | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | | | |
| 3.3 Altri parametri di ingresso collegati in offerta a aggiunta riposte e quoti indicati in capitolato | GRATAROLA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | |
| | PEZZATO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | |
| | BUCCHIERI | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | |
| | Medie coefficienti | 2,00 | 2,33 | 2,00 | 2,00 | | | | | |
| | Apertura n°1 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 1,00 | | | | | |
| | Punteggio | 0,444 | 0,515 | 0,444 | 2,000 | | | | | |
| 4.4 Altri parametri indicati in offerta | GRATAROLA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| | PEZZATO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| | BUCCHIERI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| | Medie coefficienti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| | Apertura n°1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | Punteggio | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | | | | |
| 4. Funzioni di sicurezza | | | | | | | | | | |
| 4.1 Valore interno del circuito a protezione a bassa frequenza | GRATAROLA | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | PEZZATO | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | BUCCHIERI | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Medie coefficienti | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Apertura n°1 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Punteggio | 0,000 | 0,592 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 4.2 Funzioni di protezione contro l'ipotesi | GRATAROLA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| | PEZZATO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| | BUCCHIERI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| | Medie coefficienti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| | Apertura n°1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | Punteggio | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | | | | |
| 4.3 Presenza di sensori di supporto decisionale per l'impostazione del basso flusso | GRATAROLA | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | PEZZATO | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | BUCCHIERI | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Medie coefficienti | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Apertura n°1 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Punteggio | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 5. Funzionalità di base | | | | | | | | | | |
| 5.1 Loop a misura di meccanica respiratoria | GRATAROLA | 3,00 | 2,00 | 14,00 | 2,00 | | | | | |
| | PEZZATO | 2,00 | 2,00 | 15,00 | 2,00 | | | | | |
| | BUCCHIERI | 3,00 | 2,00 | 15,00 | 2,00 | | | | | |
| | Medie coefficienti | 3,00 | 2,00 | 14,67 | 2,00 | | | | | |
| | Apertura n°1 | 0,14 | 0,14 | 1,00 | 0,14 | | | | | |
| | Punteggio | 6,118 | 0,818 | 6,000 | 0,018 | | | | | |
| 5.2 Parametri di supporto alle ventilazioni polmonari protetta | GRATAROLA | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | | | |
| | PEZZATO | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | | | |
| | BUCCHIERI | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | | | |
| | Medie coefficienti | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | | | |
| | Apertura n°1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | Punteggio | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | | | | | |
| 6. Assistenza tecnica e formazione | | | | | | | | | | |
| 6.1 Condizioni migliorative dell'assistenza post-vendita | GRATAROLA | 2,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | |
| | PEZZATO | 2,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | |
| | BUCCHIERI | 2,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | |
| | Medie coefficienti | 2,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | |
| | Apertura n°1 | 0,17 | 1,00 | 0,17 | 0,17 | | | | | |
| | Punteggio | 0,288 | 2,016 | 0,288 | 0,288 | | | | | |
| 6.2 Condizioni migliorative del piano formativo | GRATAROLA | 13,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | PEZZATO | 10,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | BUCCHIERI | 13,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | Medie coefficienti | 13,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | Apertura n°1 | 1,00 | 0,50 | 0,08 | 0,08 | | | | | |
| | Punteggio | 2,000 | 1,000 | 0,100 | 0,100 | | | | | |
| 6.3 Presenza nel piano formativo di tecniche dedicate all'ottimizzazione dell'efficienza energetica nell'utilizzo/manutenzione dell'apparato | GRATAROLA | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | PEZZATO | 9,00 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | BUCCHIERI | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | Medie coefficienti | 7,67 | 7,67 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | Apertura n°1 | 1,00 | 1,00 | 0,13 | 0,13 | | | | | |
| | Punteggio | 1,000 | 1,000 | 0,130 | 0,130 | | | | | |
| Totale punteggio di qualità | | 70,00 | | | 35,760 | 51,741 | 58,713 | 52,947 | | |
| Totale punteggio di qualità riparametrato | | | | | 40,250 | 61,688 | 70,000 | 63,125 | | |

| Ditta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| DRABER | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |

| Ditta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| DRABER | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |

| Ditta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| DRABER | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |

| Ditta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| DRABER | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| Ditta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| DRABER | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |

| Ditta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| DRABER | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| Ditta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| DRABER | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |

| Ditta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| DRABER | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| Ditta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| DRABER | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |

| Ditta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| DRABER | 4 | 3 | 4 | | | | | | | |
| GE MEDICAL ITALIA | 4 | 3 | 4 | | | | | | | |
| MAQUET ITALIA | 4 | 3 | 4 | | | | | | | |

| Ditta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| DRABER | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |

Handwritten signature and initials.

| Requisiti essenziali | Quantità | Unità di misura | Valutazione | | | | |
|---|----------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|-------|
| | | | PRESENTI | PRESENTI | PRESENTI | PRESENTI | |
| 1.1 Peso (kg) a mina pieno conforme maggior paragrafo | 1 | Q4 | 16,00 | 31,00 | 19,00 | 42,00 | |
| 1.2 Dimensione in cm (L*P*P) a minima (dimensioni) conforme maggior paragrafo | 1 | Q4 | 1,000 | 0,150 | 0,910 | 0,250 | |
| 1.3 Anno di immissione in commercio fino al 2014 (incluso) o più successivamente al 2014 (escluso) | 1 | 2014-0 più 101-0-0-1 | 2009 | 2013 | 2015 | 2009 | |
| 1.4 Modulo HW e SW | 2 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | PEZZATO | 3,00 | 3 | 3,00 | 3,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 3 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Media coefficienti | 3,00 | 3 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Apertura a 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.5 Sistema integrabile con generatore di flusso (ON/OFF) | 2 | Q5 | ON | ON | ON | ON | |
| 1.6 Facilità di smontaggio, pulizia e disinfezione del circuito pz | 1 | Q2 | GRATAROLA | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
| | | | PEZZATO | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 |
| | | | BUCCHERI | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
| | | | Media coefficienti | 3,67 | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
| | | | Apertura a 1 | 0,52 | 0,60 | 1,00 | 1,00 |
| 1.7 Sensori necessari per la ventilazione integrati nell'apparecchiatura (ON/OFF) | 2 | Q5 | ON | ON | ON | ON | |
| 1.8 Facilità di accesso e smontaggio della valvola aspirante | 2 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | PEZZATO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| | | | Media coefficienti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,67 |
| | | | Apertura a 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,89 |
| 1.9 Interfaccia utente 1.0.1 InfoMM del trasformatore utente con per lo meno situazione alla struttura logica delle informazioni | 2 | Q2 | GRATAROLA | 4,00 | 0,00 | 12,00 | 4,00 |
| | | | PEZZATO | 4,00 | 0,00 | 12,00 | 5,00 |
| | | | BUCCHERI | 4,00 | 0,00 | 12,00 | 4,00 |
| | | | Media coefficienti | 4,00 | 0,00 | 12,00 | 4,33 |
| | | | Apertura a 1 | 0,33 | 0,00 | 1,00 | 0,33 |
| 1.9 Interfaccia utente 1.0.2 InfoMM del sistema di supporto decisionale all'impostazione delle modalità ventilatorie | 1 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 |
| | | | PEZZATO | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 9,00 |
| | | | BUCCHERI | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 6,00 |
| | | | Media coefficienti | 4,00 | 0,00 | 3,33 | 8,33 |
| | | | Apertura a 1 | 0,48 | 0,00 | 0,40 | 1,00 |
| 1.10 Interfaccia utente 1.0.3 Ritardo manico di mano | 1 | Q2 | GRATAROLA | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 |
| | | | PEZZATO | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 |
| | | | BUCCHERI | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 |
| | | | Media coefficienti | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 |
| | | | Apertura a 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,33 |
| 1.9 Interfaccia utente 1.0.4 Accessibilità alle funzioni standard di servizio con particolare attenzione alle modalità di accesso e visualizzazione dei dati di trend e di eventi | 2 | Q2 | GRATAROLA | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | PEZZATO | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | BUCCHERI | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | Media coefficienti | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | Apertura a 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.9 Interfaccia utente 1.0.5 Display touch screen | 1 | Q5 | ON | ON | ON | ON | |
| | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 1.10 Regole di rendimento energetico | 2 | Q4 | N.D. | N.D. | N.D. | 2,40 | |
| 2. Modalità di ventilazione | 3 | Q2 | GRATAROLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,000 |
| | | | PEZZATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,000 |
| | | | BUCCHERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,000 |
| | | | Media coefficienti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,000 |
| | | | Apertura a 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Modalità ventilatorio alterno | 3 | Q2 | GRATAROLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | PEZZATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| | | | BUCCHERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | Media coefficienti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67 |
| | | | Apertura a 1 | 1,00 | 0,00 | 0,27 | 0,77 |
| 2.2 Ventilazione PIV con frequenza minima impostabile dall'utente | 3 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | PEZZATO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Media coefficienti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Apertura a 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.3 Ventilazione VS con frequenza minima impostabile dall'utente | 3 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | PEZZATO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Media coefficienti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Apertura a 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.4 Ventilazione su 2 livelli di pressione e volume garantito | 2 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | PEZZATO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Media coefficienti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Apertura a 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.5 Impostazione estensibile protetta del volume corrente rispetto al pieno componente statico | 2 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | PEZZATO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Media coefficienti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Apertura a 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.6 Modalità ventilazione avanzata con metodologie innovative di sicurezza clinica | 2 | Q2 | GRATAROLA | 12,00 | 1,00 | 7,00 | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 11,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 12,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 11,67 | 1,00 | 8,00 | 1,00 |
| | | | Apertura a 1 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 3. Altre caratteristiche tecniche e funzionali | 3 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | PEZZATO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Media coefficienti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Apertura a 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

[Handwritten signatures and initials]

| Ditta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ditta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| DRABER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DRABER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DRABER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ditta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| DRABER | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRABER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| DRABER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BURKESBURKE | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BURKESBURKE | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ditta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| DRABER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DRABER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DRABER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ditta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| DRABER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRABER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| DRABER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BURKESBURKE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BURKESBURKE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BURKESBURKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ditta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ditta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| DRABER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRABER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DRABER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BURKESBURKE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BURKESBURKE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BURKESBURKE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Ditta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ditta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| DRABER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRABER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DRABER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BURKESBURKE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ditta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| DRABER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRABER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DRABER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | BURKESBURKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BURKESBURKE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MAQUET ITALIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | BURKESBURKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ditta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ditta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| DRABER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DRABER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DRABER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Ditta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ditta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|
| DRABER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DRABER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DRABER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | Spesita n° 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|--|---|----|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Prezzo | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 3.3 Flow-by regolabile direttamente da dipendente o in ventola a iniezione in NIV | 2 | Q1 | GRATAROLA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | PEZZATO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | BUCCHERI | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | Media coefficienti | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | Spesita n° 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Prezzo | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3.5 Pressione di una linea di pressione assorbita per la misura della pressione respiratoria | 2 | Q2 | GRATAROLA | 1,00 | 13,00 | 1,00 | 13,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 13,00 | 1,00 | 13,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 13,00 | 1,00 | 13,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 13,00 | 1,00 | 13,00 |
| | | | Spesita n° 1 | 0,05 | 1,00 | 0,05 | 1,00 |
| | | | Prezzo | 6,154 | 2,000 | 0,154 | 2,000 |
| 3.4 Prova di respiro apertoneo per svegliamento pz | 2 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | PEZZATO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Media coefficienti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Spesita n° 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Prezzo | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3.4.1 Nebulizzazione sincronizzata con la ventilazione | 2 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | PEZZATO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Media coefficienti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Spesita n° 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Prezzo | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3.6 Sistema di compensazione dell'umidità presente nel circuito pz | 2 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | PEZZATO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Media coefficienti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Spesita n° 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Prezzo | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3.6 Funzionalità dei dispositivi offerti per il supporto della ventilazione protettiva | 2 | Q2 | GRATAROLA | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | PEZZATO | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 |
| | | | Media coefficienti | 7,57 | 0,00 | 5,58 | 5,00 |
| | | | Spesita n° 1 | 1,00 | 0,00 | 0,23 | 0,78 |
| | | | Prezzo | 2,000 | 0,000 | 0,270 | 1,555 |
| 4. Caratteristiche del monitoraggio e allarme | | | | | | | |
| 4.1 Monitoraggio continuo della pressione esofagea | 3 | Q2 | GRATAROLA | 1,00 | 13,00 | 1,00 | 13,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 13,00 | 1,00 | 13,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 13,00 | 1,00 | 13,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 13,00 | 1,00 | 13,00 |
| | | | Spesita n° 1 | 0,05 | 1,00 | 0,05 | 1,00 |
| | | | Prezzo | 0,234 | 9,000 | 0,234 | 3,000 |
| 4.2 Semplificazione di alcuni delle procedure di misura o di cura manovre | 2 | Q2 | GRATAROLA | 10,00 | 0,00 | 7,00 | 4,00 |
| | | | PEZZATO | 11,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | BUCCHERI | 10,00 | 0,00 | 7,00 | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 10,33 | 0,00 | 6,33 | 4,89 |
| | | | Spesita n° 1 | 1,00 | 0,00 | 0,61 | 0,42 |
| | | | Prezzo | 2,000 | 0,000 | 1,226 | 0,836 |
| 4.3 Strumenti offerti per il calcolo della PEEP critica o della incidenza polmonare del pz | 2 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | PEZZATO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Media coefficienti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Spesita n° 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Prezzo | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 4.4 Modalità di ventilazione protettiva integrata con sistemi di svegliamento automatico | 2 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | PEZZATO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Media coefficienti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Spesita n° 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Prezzo | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 4.5 Sistemi insonori di incoraggiamento e mischiatori | 2 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | PEZZATO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Media coefficienti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Spesita n° 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Prezzo | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 4.6 Allarme di PEEP critica | 2 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | PEZZATO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Media coefficienti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Spesita n° 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Prezzo | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 4.7 Alti allarmi con FIM regolabili | 2 | Q2 | GRATAROLA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | PEZZATO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | BUCCHERI | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Media coefficienti | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | Spesita n° 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Prezzo | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 5. Assistenza tecnica e formazione | | | | | | | |
| 5.1 Condizionamento dell'assistenza post-ventilata | 2 | Q2 | GRATAROLA | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| | | | Spesita n° 1 | 0,11 | 1,00 | 0,11 | 1,00 |
| | | | Prezzo | 0,222 | 2,000 | 0,222 | 2,000 |
| 5.2 Capitoli migliorativi del piano formativo | 2 | Q2 | GRATAROLA | 14,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 11,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 14,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 13,00 | 6,57 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Spesita n° 1 | 1,00 | 0,31 | 0,08 | 0,08 |
| | | | Prezzo | 2,000 | 1,226 | 0,154 | 0,154 |

| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 |
|-------------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|
| MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 |
| Dräger | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| Dräger | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| Dräger | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 |
| MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 |
| Dräger | 0 | 0 | 0 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| Dräger | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| Dräger | 0 | 0 | 0 | BURKESBURKE | 0 | 0 | 0 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 |
| MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 | BURKESBURKE | 0 | 0 | 0 |
| Dräger | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| Dräger | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 |
| Dräger | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 |
| MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 |
| Dräger | 1 | 1 | 1 | GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| Dräger | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| Dräger | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 |
| MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 |
| Dräger | 0 | 0 | 0 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| Dräger | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| Dräger | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | BURKESBURKE | 0 | 0 | 0 |
| MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 | BURKESBURKE | 0 | 0 | 0 |
| Dräger | 0 | 0 | 0 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| Dräger | 1 | 1 | 1 | MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| Dräger | 0 | 0 | 0 | BURKESBURKE | 0 | 0 | 0 |
| GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| GE MEDICAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 |
| MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 | BURKESBURKE | 0 | 0 | 0 |
| Dräger | 4 | 3 | 4 | GE MEDICAL ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| Dräger | 0 | 4 | 3 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| Dräger | 6 | 4 | 3 | BURKESBURKE | 0 | 0 | 0 |
| GE MEDICAL ITALIA | 3 | 4 | 3 | MAQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| GE MEDICAL ITALIA | 3 | 4 | 3 | BURKESBURKE | 0 | 0 | 0 |
| MAQUET ITALIA | 1 | 1 | 1 | BURKESBURKE | 1 | 1 | 1 |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

| | | | | | | | |
|---|---|----|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SA Presenza, nel piano formativo, di tematico dedicato all'ottimizzazione energetica nell'ultrastrutturazione della apparecchiatura fonte | 1 | 02 | GRATACOLA | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | PEZZATO | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | | | BUDGETE | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | Moduli capacitivi | 5,33 | 5,33 | 0,00 | 5,33 |
| | | | Spazio a 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | | Protezione | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| | | | Totale punteggio di qualità | 70,00 | | | 56,918 |
| Totale punteggio di qualità riparametrato | | | | 65,181 | 58,046 | 59,372 | 70,000 |

| Ditta | Q | A | B | Ditta | Q | A | B |
|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|
| DRASGER | 1 | 1 | 1 | SEMEDIAL ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| DRASGER | 3 | 4 | 3 | MACQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| DRASGER | 1 | 1 | 1 | BUNDESBUKKE | 1 | 1 | 1 |
| SEMEDIAL ITALIA | 3 | 4 | 3 | MACQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| SEMEDIAL ITALIA | 1 | 1 | 1 | BUNDESBUKKE | 1 | 1 | 1 |
| MACQUET ITALIA | 0 | 0 | 0 | BUNDESBUKKE | 3 | 4 | 3 |

[Handwritten signatures and initials]

Prot. n. 10715 del 27/07/2017

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016,
per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi
per anestesia e ventilatori polmonari ad uso ospedaliero occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS
della Regione Liguria
per un periodo di anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)
Lotti n. 11 - N. gara: 6621976

Quinta seduta riservata della Commissione Giudicatrice (prova pratica apparecchiature offerte Lotti 4 e 6)

26 luglio 2017

Il giorno 26 del mese di luglio dell'anno 2017, alle ore 10:00 presso il Padiglione Specialità, 1° piano, dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 5/2016, con determinazione n. 110 del 20.3.2017 per le operazioni di valutazione della idoneità/qualità delle apparecchiature presentate dalle Ditte concorrenti relativamente ai lotti 4 e 6

Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice:

| Cognome | Nome | Struttura | |
|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| GRATAROLA | Dott. Angelo | A.O.U./IRCCS San Martino | in qualità di Presidente |
| BUCCHERI | Ing. Massimo | ASL 5 Spezzina | in qualità di Componente |
| PEZZATO | Dott. Stefano | IRCCS Giannina Gaslini | in qualità di Componente |

E' presente per la Centrale Acquisti la Dott.ssa Tiziana Tazzoli, Collaboratore Amministrativo, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

Il Presidente ricorda, quindi, che il Disciplinare di Gara prevedeva, ai fini della valutazione delle apparecchiature offerte, la prova pratica delle medesime presso strutture del SSR. La Centrale di Acquisto, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Giudicatrice, ha provveduto - con nota prot. n. 9279 del 30/06/2017 alla convocazione formale delle Ditte ammesse per la presentazione delle apparecchiature offerte.

Nella prova pratica odierna la Commissione Giudicatrice procede a valutare le apparecchiature relative ai Lotti 4 (ventilatori polmonari per pneumologia) e 6 (CPAP per degenza). Gli esiti della valutazione vengono riportati, nella tabella (file excel) denominata "Scheda di valutazione Lotti_4_6", allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. Relativamente al Lotto 4 non è stata convocata per la prova pratica la Società Medtronic Italia spa in quanto esclusa dalla Commissione Giudicatrice nel corso della seduta riservata del 24/5/2017 (verbale prot. n. 7564 del 25/5/2017), esclusione comunicata con nota prot. n. 7601 del 25/5/2017.

Il Presidente dà altresì atto che le Ditte convocate per i Lotti esaminati hanno regolarmente presentato la documentazione che era stata richiesta ai fini della prova pratica, ovvero dichiarazione di manleva e copia della polizza assicurativa RCT.

Lotto 4 (Ventilatori polmonari per pneumologia):

- Burke&Burke spa: Hamilton C3
- Carefusion Italy 311:IX5 Comprehensive
- Draeger Medical Italia spa: Savina 300
- Medigas Italia sri: Bellavista
- Mindray Medical Italy sri: SV 300
- Philips Healthcare spa: Respironics V680

Lotto 6 (CPAP per degenza):

- > Medigas Italia srl: ResMart Gli C-PAP

La Commissione Giudicatrice verifica preliminarmente che le apparecchiature esibite in prova corrispondano ai modelli dichiarati dalle Ditte partecipanti nella documentazione tecnica, e di seguito riepilogati per comodità di consultazione:

La Commissione avrà cura di assegnare a ciascuna delle Ditte presenti lo stesso tempo di prova delle apparecchiature in proporzione ai lotti partecipati. Per ragioni di imparzialità e trasparenza la Commissione procede, relativamente al Lotto 4, alla presenza dei rappresentanti delle Ditte intervenuti, al sorteggio delle Ditte al fine di stabilire l'ordine di prova.

Il sorteggio è effettuato dal Sig. Massimo Campi della Società Draeger Medical Italia spa. Il sorteggio stabilisce questo ordine di prova:

- 1° Draeger Medical Italia spa
- 2° Mindray Medical Italy spa
- 3° Burke&Burke spa
- 4° Philips Healthcare spa
- 5° Carefusion Italy 311 srl
- 6° Medigas Italia srl

La Commissione decide di procedere, quindi, alla visione dell'apparecchiatura offerta dalla Società Medigas Italia srl, in quanto unica partecipante al Lotto 6 (CPAP per degenza). Per la Società Medigas Italia sono presenti i Sig.ri Fiorato, Zarini e Perego. La prova pratica ha inizio alle ore 10:13 e termina alle ore 10:40. La Commissione valuta l'idoneità dell'apparecchiatura offerta dalla Società Medigas Italia srl e ritiene più che soddisfacenti le caratteristiche tecniche e prestazionali della medesima, procedendo all'attribuzione dei punteggi di qualità riepilogati nella "Scheda di valutazione Lotto 6" (Foglio excel) allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

La Commissione procede, quindi, alla visione delle apparecchiature offerte per il lotto 4. Viene visionata l'apparecchiatura presentata per il Lotto 4 dalla Società prima estratta, Draeger Medical Italia spa, per la quale sono presenti i Sig.ri Buttafuoco, Sartori e Campi. La prova ha inizio alle ore 10:40 e termina alle ore 11:08.

La Commissione passa all'esame dello strumento offerto dalla Società seconda estratta, Mindray Medical Italia srl, per la quale sono intervenuti i Sig.ri Atzel e Sgarella. La prova inizia alle ore 11:10 e termina alle ore 11:38. Viene quindi esaminata l'apparecchiatura offerta dalla Società terza estratta, Burke&Burke, per la quale intervengono i Sig.ri Brambilla e Bombonato. La prova inizia alle ore 11:40 e termina alle ore 12:00.

La Commissione passa a visionare l'apparecchiatura offerta dalla Società quarta estratta, Philips Healthcare spa, per la quale sono presenti i Sig.ri Traballi Castelli e Violato. La prova ha inizio alle ore 12:02 e termina alle ore 12:25.


Viene quindi esaminata l'apparecchiatura offerta dalla Società quinta estratta, Carefusion Italy 311 srl, per la quale sono presenti i Sig.ri Staltari, Monaco e Lanzone. La prova ha inizio alle ore 12:30 e termina alle ore 12:50.

Infine viene visionata l'apparecchiatura della Società ultima estratta, Medigas Italia srl, per la quale sono presenti i Sig.ri Fiorato e Perego. La prova inizia alle ore 12:55 e termina alle ore 13:15.

Alle ore 13:30 la Commissione sospende i lavori per la pausa pranzo. I lavori riprendono alle ore 14:30

Terminate le prove pratiche, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi di qualità relativi alle apparecchiature offerte per il Lotto 4 e riportati nella Scheda valutazione lotto_4 (foglio excel) allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. I dati oggettivi relativi ai parametri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.2, 1.6, 1.7 rilevati da scheda tecnica di prodotto ed ulteriormente verificati nel corso della prova pratica vengono riportati nella scheda di valutazione formato excel sopra indicata per il calcolo automatico del punteggio sulla base dei criteri e delle formule di calcolo specificate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico. I parametri qualitativi di natura intangibile vengono valutati tramite il metodo del confronto a coppie come previsto dal Disciplinare di Gara, secondo la matrice riportata nella Scheda valutazione allegata al presente verbale (foglio excel).

Si mette altresì a verbale che la Commissione Giudicatrice ha comunicato ai rappresentanti delle Ditte intervenuti alle prove pratiche che l'apertura delle offerte economiche verrà effettuata in data 17 agosto 2017 e che i rappresentanti medesimi hanno confermato la propria disponibilità ad essere presenti.

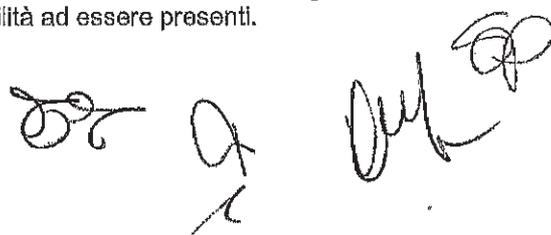

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale agli atti della Centrale.

La seduta è tolta alle ore 17:00



Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Angelo GRATAROLA
Presidente

Dott. Stefano PEZZATO
Componente

Ing. Massimo BUCCHERI
Componente

Dott.ssa Tiziana TAZZOLI
Segretario



All.to
Scheda valutazione Lotti 4 e 6

| CATEGORIA: PRODOTTI DI NEUMONIA PERIOPERATORIA | | | | Empio Medical Italia spa | Competition Italy | Benevento spa | Ministry Medical Italia | Palire Healthcare spa | Macrogamma spa |
|--|---|---|--------------------------|--|---|---|---|--|-------------------------|
| Modello: DOLBY | | | | Servizi 300 | Orta Comprehensive | Hardizza CA | SV 300 | Respircor V80 | BellaVista |
| Requisiti essenziali | | | | Valutazioni Individuali | Valutazioni Individuali | Valutazioni Individuali | Valutazioni Individuali | Valutazioni Individuali | Valutazioni Individuali |
| Caratteristiche generali | | | | PRESENTI | PRESENTI | PRESENTI | PRESENTI | PRESENTI | PRESENTI |
| 1.1 | Peso (Kg): a minor peso corrisponde maggior punteggio | 1 | Q4* | 26,00 0,240 | 12,00 0,889 | 9,50 1,000 | 10,00 0,977 | 13,50 0,871 | 12,50 0,868 |
| 1.2 | Dimensioni in cm (L*P*P): a minori dimensioni corrisponde maggior punteggio | 1 | Q4* | 64123 0,222 | 24800 0,869 | 24800 0,596 | 1,000 0,955 | 27766 0,258 | 29325 0,950 |
| 1.3 | Anno di immissione in commercio fino al 2014 (Incluso) o p.f. successivamente al 2014=1 p.f. | 1 | 2014=0 p.f. >2014=1 p.f. | 2013 0,000 | N.D. 0,000 | 2012 0,000 | N.D. 0,000 | 2014 0,000 | 2015 1,000 |
| 1.4.1 | Possibilità di interfacciamento con sistemi informativi (ON/OFF) | 2 | Q5 | ON 2,000 | ON 2,000 | ON 2,000 | ON 2,000 | ON 2,000 | ON 2,000 |
| 1.4.2 | Possibilità di interfacciamento con cartelle cliniche (ON/OFF) | 2 | Q5 | ON 2,000 | ON 2,000 | ON 3,000 | ON 2,000 | ON 2,000 | ON 2,000 |
| 1.4.3 | Possibilità di interfacciamento con sistemi di monitoraggio esterno (ON/OFF) | 3 | Q5 | ON 3,000 | ON 3,000 | ON 3,000 | ON 3,000 | ON 3,000 | ON 3,000 |
| 1.6 | Interfaccia utente: 1.6.1 Intuitività dell'interfaccia utente con particolare attenzione alla struttura logica delle informazioni | 3 | Q2 | GRATAROLA 4,00 PEZZATO 3,00 BUCCHERI 4,00 Media coefficienti 4,85 ripetibile a 1 0,21 Punteggio 0,639 | 16,00 17,00 17,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 16,67 16,67 16,67 0,82 0,82 0,82 | 4,00 3,00 4,00 21,00 19,00 21,00 2,00 2,00 2,00 3,67 3,67 3,67 1,00 1,00 1,00 | 3,000 3,000 3,000 8,000 8,000 8,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 | 0,00 0,00 0,00 10,00 11,00 10,00 10,00 10,33 10,33 0,00 0,00 0,51 | |
| 1.6 | Interfaccia utente: 1.6.2 Display touch screen | 1 | Q5 | ON 1,000 | ON 1,000 | ON 1,000 | ON 1,000 | ON 1,000 | ON 1,000 |
| 1.5 | Interfaccia utente: 1.5.3 Ridotto numero di menu | 2 | Q2 | GRATAROLA 4,00 PEZZATO 3,00 BUCCHERI 4,00 Media coefficienti 3,57 ripetibile a 1 0,25 Punteggio 0,458 | 19,00 14,00 19,00 2,00 2,00 2,00 16,00 16,00 16,00 19,33 19,33 19,33 0,83 0,83 0,83 | 2,00 2,00 2,00 16,00 16,00 16,00 1,00 1,00 1,00 2,000 2,000 2,000 | 1,00 1,00 1,00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | |
| 1.6 | Riduzione del circuito paziente | 2 | Q5 | ON 2,000 | ON 2,000 | ON 2,000 | ON 2,000 | ON 2,000 | ON 2,000 |
| 1.7 | Requisiti di rendimento energetico | 2 | Q4* | N.D. 0,000 | N.D. 0,000 | 2,85 2,000 | N.D. 0,000 | N.D. 0,000 | N.D. 0,000 |
| 2. Modalità di ventilazione | | | | | | | | | |
| 2.1 | Caratteristiche delle modalità ventilatorie offerte | 5 | Q2 | GRATAROLA 5,00 PEZZATO 5,00 BUCCHERI 5,00 Media coefficienti 5,00 ripetibile a 1 1,00 Punteggio 5,000 | 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 | 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 | 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 | 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 | |
| 2.2 | Modalità ventilatorie sterioti indicate in offerta | 5 | Q2 | GRATAROLA 2,00 PEZZATO 2,00 BUCCHERI 2,00 Media coefficienti 2,00 ripetibile a 1 0,11 Punteggio 0,566 | 10,00 11,00 10,00 2,00 2,00 2,00 18,00 18,00 18,00 11,99 11,99 11,99 0,64 0,64 0,64 | 2,00 2,00 2,00 17,00 17,00 17,00 2,00 2,00 2,00 17,67 17,67 17,67 1,00 1,00 1,00 | 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 | 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0,79 0,79 0,79 3,982 3,982 3,982 | |
| 2.3 | Modalità ventilatorie ulteriori disponibili in opzione | 5 | Q2 | GRATAROLA 5,00 PEZZATO 5,00 BUCCHERI 5,00 Media coefficienti 5,00 ripetibile a 1 1,00 Punteggio 5,000 | 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 | 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 | 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 | 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 | |
| 3. Monitoraggio | | | | | | | | | |
| 3.1 | Scopriti di avvio della procedura di misura e della rimozione | 5 | Q2 | GRATAROLA 4,00 PEZZATO 5,00 BUCCHERI 4,00 Media coefficienti 4,33 ripetibile a 1 0,23 Punteggio 1,163 | 16,00 17,00 17,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 16,67 16,67 16,67 0,89 0,89 0,89 | 4,00 3,00 4,00 18,00 18,00 18,00 20,00 20,00 20,00 18,67 18,67 18,67 1,00 1,00 1,00 | 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 | 10,00 11,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,33 10,33 0,00 0,00 0,56 | |
| 3.2 | Parametri monitorati con particolare riferimento al range di misure | 3 | Q2 | GRATAROLA 5,00 PEZZATO 5,00 BUCCHERI 5,00 Media coefficienti 5,00 ripetibile a 1 1,00 Punteggio 3,000 | 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 | 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 | 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 | 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 | |
| 3.3.1 | Altri parametri monitorati di interesse clinico ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti in capitolato inclusi in offerta | 4 | Q2 | GRATAROLA 7,00 PEZZATO 8,00 BUCCHERI 8,00 Media coefficienti 7,67 ripetibile a 1 0,85 Punteggio 3,407 | 8,00 9,00 9,00 3,00 3,00 3,00 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 9,00 0,33 0,33 0,33 | 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,22 0,22 0,22 | 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 | 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 | |
| 3.3.2 | Altri parametri monitorati di interesse clinico ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti in capitolato disponibili in opzione | 3 | Q2 | GRATAROLA 7,00 PEZZATO 8,00 BUCCHERI 8,00 Media coefficienti 7,67 ripetibile a 1 0,85 Punteggio 2,596 | 8,00 9,00 9,00 3,00 3,00 3,00 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 9,00 0,33 0,33 0,33 | 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,22 0,22 0,22 | 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 | 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 | |
| 4. Gestione allarmi | | | | | | | | | |
| 4.1 | Modalità di segnalazione allarmi con particolare attenzione alla struttura ed al tipo delle informazioni | 3 | Q2 | GRATAROLA 5,00 PEZZATO 5,00 BUCCHERI 5,00 Media coefficienti 5,00 ripetibile a 1 1,00 Punteggio 3,000 | 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 | 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 | 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 | 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 | |
| 4.2 | Altri allarmi disponibili ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti in capitolato | 2 | Q2 | GRATAROLA 3,00 PEZZATO 3,00 BUCCHERI 3,00 Media coefficienti 3,00 ripetibile a 1 0,29 Punteggio 0,583 | 8,00 9,00 9,00 2,00 2,00 2,00 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 9,00 0,19 0,19 0,19 | 2,00 2,00 2,00 14,00 14,00 14,00 15,00 15,00 15,00 10,33 10,33 10,33 1,00 1,00 1,00 | 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 | 14,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,94 0,94 1,677 1,677 1,677 | |
| 5. Assistenza tecnica e formazione | | | | | | | | | |
| | | | | GRATAROLA 6,00 PEZZATO 6,00 | 6,00 9,00 6,00 12,00 | 11,00 12,00 | 0,00 0,00 | 2,00 7,00 | 14,00 17,00 |

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Scheda valutazione Lotti 4 e 6

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5.1 Condizioni migliorativa dell'assistenza post-vendita | 2 | Q2 | BUCCHERI | 5,00 | 10,00 | 12,00 | 0,00 | 3,00 | 15,00 |
| | | | Media coefficienti | 5,00 | 6,33 | 11,67 | 0,00 | 2,33 | 15,33 |
| | | | ripetuta a 1 | 0,39 | 0,54 | 0,76 | 0,00 | 0,15 | 1,00 |
| | | | Punteggio | 0,783 | 1,087 | 1,522 | 0,000 | 0,208 | 2,000 |
| | | | | | | | | | |
| 5.2 Condizioni migliorativa del piano formativo | 2 | Q2 | GRATAROLA | 14,00 | 14,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 14,00 |
| | | | PEZZATO | 11,00 | 11,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 11,00 |
| | | | BUCCHERI | 14,00 | 14,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 14,00 |
| | | | Media coefficienti | 13,00 | 13,00 | 2,00 | 4,67 | 1,00 | 13,00 |
| | | | ripetuta a 1 | 1,00 | 1,00 | 0,15 | 0,86 | 0,08 | 1,00 |
| Punteggio | 2,000 | 2,000 | 0,308 | 0,718 | 0,154 | 2,000 | | | |
| 5.3 Progettista, nel piano formativo, di tematica dedicata all'ottimizzazione energetica nell'efficienza/elettrodomestici della apparecchiatura funita | 1 | Q2 | GRATAROLA | 14,00 | 2,00 | 14,00 | 2,00 | 2,00 | 14,00 |
| | | | PEZZATO | 11,00 | 2,00 | 11,00 | 2,00 | 2,00 | 11,00 |
| | | | BUCCHERI | 14,00 | 2,00 | 14,00 | 2,00 | 2,00 | 14,00 |
| | | | Media coefficienti | 13,00 | 2,00 | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 13,00 |
| | | | ripetuta a 1 | 1,00 | 0,15 | 1,00 | 0,15 | 0,15 | 1,00 |
| Punteggio | 1,000 | 0,154 | 1,000 | 0,154 | 0,154 | 1,000 | | | |
| Totale punteggio di qualità | | 60,00 | | 39,712 | 46,867 | 42,452 | 47,404 | 35,296 | 47,004 |
| Totale punteggio di qualità riparametrato | | | | 50,264 | 59,320 | 53,732 | 60,000 | 44,674 | 59,493 |

Handwritten signatures and initials:
 A large signature, possibly "G. G. G.", and several smaller initials or marks.

1.5 Interfaccia utente:
1.5.1 Intuitività
dell'interfaccia utente con
particolare attenzione alla
struttura logica delle
informazioni Peso: 3

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|--------------------|-----------|---------|----------|--------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | CAREFUSION | 4 | 5 | 4 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MINDRAY MEDICAL | 5 | 5 | 5 |
| DRAEGER | 3 | 4 | 3 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 2 | 3 | 3 |
| CAREFUSION | 3 | 4 | 3 | BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 6 | 5 | 6 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| CAREFUSION | 2 | 2 | 3 | MEDIGAS ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 | MINDRAY MEDICAL | 5 | 4 | 5 |
| BURKE&BURKE | 3 | 2 | 3 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 4 | 5 | 4 |
| MINDRAY MEDICAL | 6 | 6 | 6 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| MINDRAY MEDICAL | 4 | 3 | 4 | MEDIGAS ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 4 | 3 | 3 |

1.5 Interfaccia utente:
1.5.3 Ridotto numero di
menù Peso: 2

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|--------------------|-----------|---------|----------|--------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | CAREFUSION | 4 | 3 | 3 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MINDRAY MEDICAL | 4 | 4 | 4 |
| DRAEGER | 3 | 2 | 3 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 2 | 3 | 4 |
| CAREFUSION | 3 | 4 | 4 | BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 4 | 5 | 4 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 | MINDRAY MEDICAL | 4 | 4 | 4 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 3 | 4 | 3 |
| MINDRAY MEDICAL | 6 | 6 | 6 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 5 | 6 | 5 |

2.1 Caratteristiche delle
modalità ventilatorie
offerte peso: 5

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|--------------------|-----------|---------|----------|--------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | CAREFUSION | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |

2.2 Modalità ventilatorie
ulteriori incluse in offerta
Peso: 5

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|--------------------|-----------|---------|----------|--------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | CAREFUSION | 4 | 3 | 4 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MINDRAY MEDICAL | 4 | 4 | 4 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 3 | 4 | 4 |
| CAREFUSION | 3 | 4 | 5 | BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 |
| CAREFUSION | 0 | 0 | 0 | MINDRAY MEDICAL | 3 | 2 | 3 |
| CAREFUSION | 3 | 4 | 4 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| CAREFUSION | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 2 | 2 | 2 |
| BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 | MINDRAY MEDICAL | 4 | 4 | 4 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 2 | 2 | 2 |
| MINDRAY MEDICAL | 6 | 6 | 6 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 6 | 5 | 5 |

2.3 Modalità ventilatorie
ulteriori disponibili in
opzione Peso: 5

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|--------------------|-----------|---------|----------|--------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | CAREFUSION | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |

2.4 Capacità di...

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|------------|-----------|---------|----------|--------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | CAREFUSION | 4 | 5 | 4 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MINDRAY MEDICAL | 5 | 4 | 5 |
| DRAEGER | 3 | 4 | 3 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 2 | 3 | 3 |
| CAREFUSION | 3 | 4 | 3 | BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 |

[Handwritten signature and initials]

Scheda valutazione Lotti 4 e 6

3.2 Parametri monitorati delle procedure di misura e della manovre Peso: 5

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|--------------------|---|---|---|
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 6 | 5 | 6 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| CAREFUSION | 2 | 2 | 3 | MEDIGAS ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 | MINDRAY MEDICAL | 8 | 4 | 5 |
| BURKE&BURKE | 3 | 2 | 3 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 4 | 5 | 4 |
| MINDRAY MEDICAL | 6 | 6 | 6 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| MINDRAY MEDICAL | 3 | 3 | 3 | MEDIGAS ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 4 | 3 | 3 |

3.2.1 Parametri monitorati con particolare riferimento ai ranges di misura peso: 3

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|--------------------|-----------|---------|----------|--------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | CAREFUSION | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |

3.2.1 Altri parametri monitorati di interesse clinico ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti in capitolato Inclusi in offerta Peso: 4

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|--------------------|-----------|---------|----------|--------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | CAREFUSION | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 2 | 3 | 2 | MINDRAY MEDICAL | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 2 | 2 | 3 | MEDIGAS ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| CAREFUSION | 0 | 0 | 0 | BURKE&BURKE | 2 | 2 | 3 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 0 | 0 | 0 | PHILIPS HEALTHCARE | 2 | 2 | 3 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 2 | 3 | 2 | MINDRAY MEDICAL | 0 | 0 | 0 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 2 | 2 | 3 | MEDIGAS ITALIA | 0 | 0 | 0 |
| MINDRAY MEDICAL | 0 | 0 | 0 | PHILIPS HEALTHCARE | 2 | 2 | 2 |
| MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| PHILIPS HEALTHCARE | 2 | 2 | 2 | MEDIGAS ITALIA | 0 | 0 | 0 |

3.3 Altri parametri monitorati di interesse clinico ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti dal capitolato disponibili in opzione Peso: 3

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|--------------------|-----------|---------|----------|--------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 2 | 2 | 2 | CAREFUSION | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 0 | 0 | 0 | BURKE&BURKE | 2 | 3 | 2 |
| CAREFUSION | 0 | 0 | 0 | MINDRAY MEDICAL | 2 | 2 | 2 |
| CAREFUSION | 0 | 0 | 0 | PHILIPS HEALTHCARE | 2 | 2 | 2 |
| CAREFUSION | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 2 | 3 | 2 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |

4.1 Modalità di segnalazione allarmi con particolare attenzione alla struttura ed al trend delle informazioni Peso: 3

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|--------------------|-----------|---------|----------|--------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | CAREFUSION | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 2 |
| MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |

4.2 Altri allarmi disponibili ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti dal capitolato Peso: 2

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|-----------------|-----------|---------|----------|--------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | CAREFUSION | 2 | 3 | 3 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MINDRAY MEDICAL | 3 | 3 | 3 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 2 | 3 | 2 |
| CAREFUSION | 2 | 2 | 2 | BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 2 | 2 | 3 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 | MINDRAY MEDICAL | 2 | 3 | 2 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 2 | 3 | 2 |
| MINDRAY MEDICAL | 3 | 3 | 3 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |

Scheda valutazione Lotti 4 e 6

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|----------------|---|---|---|
| MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 2 | 2 | 2 |

5.1 Condizioni migliorative dell'assistenza post-vendita Peso: 2

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|--------------------|-----------|---------|----------|--------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | CAREFUSION | 2 | 3 | 3 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | BURKE&BURKE | 2 | 2 | 2 |
| DRAEGER | 3 | 4 | 3 | MINDRAY MEDICAL | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 3 | 2 | 3 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 2 | 2 | 2 |
| CAREFUSION | 0 | 0 | 0 | BURKE&BURKE | 2 | 3 | 2 |
| CAREFUSION | 2 | 3 | 4 | MINDRAY MEDICAL | 0 | 0 | 0 |
| CAREFUSION | 2 | 3 | 3 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| CAREFUSION | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 2 | 3 | 2 |
| BURKE&BURKE | 4 | 5 | 5 | MINDRAY MEDICAL | 0 | 0 | 0 |
| BURKE&BURKE | 3 | 2 | 3 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 2 | 2 | 2 |
| MINDRAY MEDICAL | 0 | 0 | 0 | PHILIPS HEALTHCARE | 2 | 2 | 3 |
| MINDRAY MEDICAL | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 5 | 6 | 5 |
| PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 3 | 4 | 4 |

5.2 Condizioni migliorative del piano formativo Peso: 2

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|--------------------|-----------|---------|----------|--------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | CAREFUSION | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 4 | 3 | 4 | BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 4 | 3 | 4 | MINDRAY MEDICAL | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 4 | 2 | 4 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 4 | 3 | 4 | BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 |
| CAREFUSION | 4 | 3 | 4 | MINDRAY MEDICAL | 0 | 0 | 0 |
| CAREFUSION | 4 | 3 | 4 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| BURKE&BURKE | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 4 | 3 | 4 |
| MINDRAY MEDICAL | 4 | 3 | 4 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| MINDRAY MEDICAL | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 4 | 3 | 4 |
| PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 4 | 3 | 4 |


5.3 Presenza, nel piano formativo, di tematiche dedicate all'ottimizzazione energetica nell'utilizzo/manutenzione e delle apparecchiature fornite Peso: 1

| Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI | Ditta | GRATAROLA | PEZZATO | BUCCHERI |
|--------------------|-----------|---------|----------|--------------------|-----------|---------|----------|
| DRAEGER | 4 | 3 | 4 | CAREFUSION | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 |
| DRAEGER | 4 | 3 | 4 | MINDRAY MEDICAL | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 4 | 3 | 4 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| DRAEGER | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 0 | 0 | 0 | BURKE&BURKE | 4 | 3 | 4 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | MINDRAY MEDICAL | 3 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| CAREFUSION | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 4 | 3 | 4 |
| BURKE&BURKE | 4 | 3 | 4 | MINDRAY MEDICAL | 0 | 0 | 0 |
| BURKE&BURKE | 4 | 3 | 4 | PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 |
| BURKE&BURKE | 1 | 1 | 1 | MEDIGAS ITALIA | 1 | 1 | 1 |
| MINDRAY MEDICAL | 1 | 1 | 1 | PHILIPS HEALTHCARE | 1 | 1 | 1 |
| MINDRAY MEDICAL | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 4 | 3 | 4 |
| PHILIPS HEALTHCARE | 0 | 0 | 0 | MEDIGAS ITALIA | 4 | 3 | 4 |

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
 7A

| LOTTO 6 - CPAP per degenza | | Max punti | Parametri di valutazione valori a base di gara | Medias Italia srl |
|---|-------|--------------------------|--|-------------------------|
| Modello offerto | | | | RESmart GII CPAP |
| Requisiti essenziali | | | | Valutazioni Individuali |
| 1. Caratteristiche generali | | | | PRESENTI |
| 1.1 Peso complessivo < 2 Kg (a minor peso corrisponde maggior punteggio) | 5 | Q4 | | 1,50 Punteggio 5,000 |
| 1.2 Dimensioni in cm (L*A*P): a minori dimensioni corrisponde maggior punteggio | 3 | Q4* | | 3932 Punteggio 3,000 |
| 1.3 Anno di Immissione In commercio: fino al 2014(incluso)=0 p.ti successivamente al 2014=1 p.ti | 2 | ≤2014=0 p.ti >2014=2p.ti | | 2016 Punteggio 2,000 |
| 1.4 Modalità di erogazione pressione positiva (range, precisione, rampa) | 5 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| Punteggio | 5,000 | | | |
| 1.5 Eventuali funzioni di monitoraggio aggiuntive | 5 | Q1 | GRATAROLA | 0,30 |
| | | | PEZZATO | 0,20 |
| | | | BUCCHERI | 0,30 |
| | | | Media coefficienti | 0,27 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| Punteggio | 5,000 | | | |
| 1.6 Rumorosità < 30dB (misurata ad 1 metro di distanza alla pressione di 10 cmH2O) | 4 | Q4 | | 30,00 |
| | | | Punteggio | 4,000 |
| 1.7 Umidificatore Integrato | 5 | Q5 | | ON Punteggio 5,000 |
| 1.8 Intuitività interfaccia utente con particolare riferimento alla struttura logica delle informazioni fornite | 5 | Q1 | GRATAROLA | 0,80 |
| | | | PEZZATO | 0,80 |
| | | | BUCCHERI | 0,80 |
| | | | Media coefficienti | 0,80 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| Punteggio | 5,000 | | | |
| 1.9 Tipologia e Funzionalità allarmi | 3 | Q1 | GRATAROLA | 0,70 |
| | | | PEZZATO | 0,80 |
| | | | BUCCHERI | 0,80 |
| | | | Media coefficienti | 0,77 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| Punteggio | 3,000 | | | |
| 1.10 Presenza di allarmi ulteriori rispetto a quelli minimi previsti in capitolato | 3 | Q1 | GRATAROLA | 0,50 |
| | | | PEZZATO | 0,60 |
| | | | BUCCHERI | 0,60 |
| | | | Media coefficienti | 0,57 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| Punteggio | 3,000 | | | |
| 1.11 Display touch screen | 2 | Q5 | | OFF Punteggio 0,000 |
| 1.12 Dimensione memoria (GB) | 2 | Q3* | | 8 Punteggio 2,000 |
| 1.13 Dati memorizzabili | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| Punteggio | 3,000 | | | |
| 1.14 Modalità disponibili di esportazione dei dati | 3 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |
| Punteggio | 3,000 | | | |
| 2. Assistenza tecnica e formazione | | | | |
| 2 Assistenza tecnica e formazione | 10 | Q1 | GRATAROLA | 1,00 |
| | | | PEZZATO | 1,00 |
| | | | BUCCHERI | 1,00 |
| | | | Media coefficienti | 1,00 |
| | | | riportata a 1 | 1,00 |





Scheda valutazione Lotti 4 e 6

| | | | Punteggio | 10,000 |
|--|---|-------|-----------|--------|
| | Totale punteggio di qualità | 60,00 | | 58,000 |
| | Totale punteggio di qualità riparametrato | | | 60,000 |

[Handwritten signatures and initials]



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

* AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

**Procedura aperta ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016,
per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori
economici per l'affidamento della fornitura di
"Apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari ad uso
ospedaliero" occorrenti alle aziende sanitarie liguri per un
periodo di anni due (con opzione di rinnovo per un ulteriore
anno) – Lotti n. 11 - n° gara 6621976**

**Verbale III seduta pubblica
Apertura delle buste contenenti l'offerta economica
Verbale di proposta di aggiudicazione
17 agosto 2017**

Il giorno 17/8/2017, alle ore 11.00, presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto n. 110 del 20/3/2017, per la comunicazione degli esiti della valutazione tecnica, la lettura dei punteggi tecnici, l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e l'aggiudicazione provvisoria.

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice nelle persone dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| • Dott. Angelo GRATAROLA | Ospedale Policlinico San Martino | Presidente |
| • Dott. Stefano PEZZATO | IRCCS Giannina Gaslini | Componente |
| • Dott. Ing. Massimo BUCCHERI | ASL 5 Spezzina | Componente |

| Nominativo | Ditta |
|------------------------------------|---------------------------------|
| DE SERIO Massimo FISCHER Franco | Air Liquide Medical Systems srl |
| QUARATO Renato | Burke&Burke spa |
| STALTARI Sergio | Carefusion Italy 311 srl |

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162
MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

2 di 5

| | |
|--|-------------------------------|
| SARTORI Stefano CAMPI Massimo | Draeger Medical Italia spa |
| PAGANI Emiliano DI CARPEGNA VARINI Massimiliano | Maquet Italia spa |
| PASOTTI Nadl PUPPO Alessandro | GE Medical Systems Italia spa |
| ZORINI Gianluca CAVANNA Sergio FIORATO Italo | Medigas Italia srl |
| | Medtronic Italia spa |
| ATZEI Domenico SCARELLA Fabio | Mindray Medical Italy srl |
| VIOLATO Marco | Philips Healthcare spa |

la cui identità è nota ai presenti, muniti delle necessarie procure (*) che la Centrale si riserva di acquisire agli atti in caso di dichiarazione a verbale.

E' altresì presente, al completo, il Seggio di gara nominato con Determinazione n. 42 del 7/2/2017 composto dal RUP della procedura Dott. Luigi Moreno COSTA, Dirigente della Centrale, svolge anche le funzioni di Ufficiale Rogante, dalla Dott.ssa Tiziana TAZZOLI, collaboratore amministrativo della Centrale che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante e dalla Dott.ssa Silvana BERLENGIERO, collaboratore amministrativo della Centrale, che interviene in sostituzione della Dott.ssa Francesca Elia, assente.

La seduta è pubblica.

La Commissione rende noti ai presenti i punteggi di valutazione della qualità assegnati a seguito della valutazione delle offerte tecniche, indicando tra parentesi il punteggio riparametrato.

| LOTTO | Air Liquide | Burke & Burke | Carefusion Italy 331 | Draeger Medical Italia | GE Medical Systems | Maquet Italia | Medigas Italia | Mindray Medical Italy | Philips Healthca re |
|-------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | - | - | - | 49,577 (53,619) | 64,722 (70,00) | 56,704 (61,328) | - | - | - |
| 2 | - | - | - | 33,760 (40,250) | 51,741 (61,688) | 58,713 (70,00) | - | 52,947 (63,125) | - |
| 3 | - | 61,116 (70,00) | - | 56,918 (65,191) | 49,719 (56,946) | 51,837 (59,372) | - | - | - |
| 4 | - | 42,452 (53,732) | 46,867 (59,320) | 39,712 (50,264) | - | - | 47,004 (59,493) | 47,404 (60,00) | 35,296 (44,674) |
| 5 | 50,708 (53,606) | 56,757 (60,00) | - | - | - | - | - | - | - |

A.I.Sa. - Azienda Ligura Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

3 di 5

| LOTTO | Air Liquide | Burke & Burke | Carefusion Italy 311 | Draeger Medical Italia | GE Medical Systems | Maquet Italia | Medigas Italia | Mindray Medical Italy | Phillips Healthcare |
|-------|----------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| 6 | - | - | - | - | - | - | IDONEO (60,00) | - | - |
| 7 | DESERTO | | | | | | | | |
| 8 | - | 56,600 (60,072) | - | 65,954 (70,00) | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | IDONEO (70,00) | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | 54,859 (61,667) | 39,800 (44,739) | 62,272 (70,00) | - | - | - |
| 11 | - | - | - | IDONEO (70,00) | - | - | - | - | - |

Come previsto dal disciplinare di gara, non vengono ammesse alla successiva fase di valutazione economica le offerte della Società Medtronic Italia spa per i Lotti 3, 4 e 10 in quanto escluse in fase di valutazione tecnica. Relativamente al Lotto 4 l'offerta della Società Draeger Medical Italia spa è stata ammessa con riserva.

Il RUP ricorda che l'aggiudicazione avverrà in base al metodo disposto all'art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, ossia a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, (comunemente detto qualità/prezzo) sulla base degli elementi valutativi indicati nel Capitolato tecnico e del prezzo offerto. Il Presidente ricorda altresì che come previsto nel Disciplinare di gara, per ciascun Lotto dell'Accordo Quadro, il 60% della fornitura verrà aggiudicato al primo classificato nella graduatoria finale. Il 40% potrà essere attinto, laddove presenti richieste adeguatamente motivate ex art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. La Centrale di Acquisto si riserva l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro anche in presenza di un'unica offerta valida da graduatoria finale.

I punteggi economici saranno attribuiti secondo la formula prevista dal Disciplinare gara.

Il RUP ricorda altresì che, pena esclusione dalla gara, i prezzi proposti dalle ditte dovranno essere, per ciascun prodotto incluso nei lotti di cui alla Sezione "A" del Capitolato tecnico, uguali o migliori rispetto ai prezzi base indicati nell'Allegato A1.

Ciò determinato, previa positiva verifica, effettuata dal Sig. Massimo Campi della Società Draeger Medical Italia spa, della integrità del plico contenente le buste di offerta economica e regolarità delle buste e dei sigilli apposti sulle singole buste, il Presidente procede all'operazione d'apertura delle offerte economiche ed alla verifica della presenza su tutte le offerte degli elementi previsti dal disciplinare di gara (sottoscrizione della scheda offerta, presenza del bollo, indicazione separata dei costi per la sicurezza etc.).

Indi la Commissione delibera di procedere, lotto per lotto, offerta per offerta come segue:

1. alla lettura del punteggio di Qualità come formalizzato nel Verbale della Commissione Tecnica.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

4 di 5

2. alla lettura dei prezzi proposti dai concorrenti ammessi a questa fase di gara (in caso di difformità nell'offerta tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la Centrale).
3. a determinare, in base alla formula descritta, il punteggio relativo al Prezzo.
4. a individuare la Ditta che ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. In caso di parità tra più offerte, l'aggiudicazione sarà a favore del prodotto al quale è stato attribuito un punteggio di qualità maggiore, e, in caso di ulteriore parità, si procederà ad una richiesta di miglioramento ai Legali Rappresentanti delle Ditte interessate concorrenti; qualora non siano presenti entrambe le Ditte che hanno presentato offerta uguale, sarà effettuato un sorteggio.
6. a dichiarare la migliore offerta salvo verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. n. 50/2016.

L'operazione avviene in tempo reale attraverso la compilazione di un foglio di calcolo opportunamente predisposto a cura della Centrale di Acquisto. Vengono letti i punteggi tecnici, le offerte economiche e calcolato il punteggio complessivo, lotto per lotto.

In relazione all'offerta presentata per il Lotto 4 dalla Società Draeger Medical Italia la Commissione, verificata la corrispondenza tra quanto dichiarato nell'offerta tecnica e quanto dichiarato nell'offerta economica in merito alle Opzioni NIN e BiPAP, entrambe incluse in offerta, scoglie la riserva ed ammette a pieno titolo la Società Draeger Medical Italia spa al prosieguo della procedura di gara.

Per quanto sopra esposto, risultano migliori offerenti in via provvisoria, salvo verifica dell'anomalia dell'offerta, le ditte come riepilogate nella tabella allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale la documentazione relativa agli esiti di ogni lotto, nonché copia delle offerte economiche delle Ditte aggiudicatrici in via provvisoria.

La seduta è tolta alle ore 12:15

Il presente verbale, composto da n. cinque fogli (più allegati), viene acquisito agli atti per gli adempimenti consequenziali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente: Dott. Angelo GRATAROLA

Componente: Dott. Stefano PEZZATO

Componente: Dott. Ing. Massimo BUCCHERI

L'Ufficiale Rogante: Dott. Luigi Moreno COSTA



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI

5 di 5

Collaboratore: Dott.ssa Silvana BERLENGIERO

All.ti

Shede riepilogative punteggi economici Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,9,10,11

Copia offerte economiche lotti 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria


C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

| LOTTO 2 - APPARECCHI PER ANESTESIA DI BASE | Max punti | Parametri di valutazione - valori a base di gara | Draeger Medical Italia spa - Primus 2002 | GE Medical Systems Italia spa - Carestation 650 | Maqueta spa - Flow IC20 | Mindray Medical Italia spa - Wato EX 65 PRO |
|--|-----------|--|--|---|-------------------------|---|
| Totale punteggio di qualità | 70,00 | | 33,760 | 51,741 | 58,713 | 52,947 |
| Totale punteggio di qualità riparametrato | | | 40,250 | 61,688 | 70,000 | 63,125 |
| Prezzo offerto | | | 152.000,00 | 144.000,00 | 224.000,00 | 131.496,00 |
| Base gara per lotto | | 35.000,00 | 152.000,00 | 144.000,00 | 224.000,00 | 131.496,00 |
| | | | 45.714 | 48.571 | 20.000 | 53.037 |
| Punteggio offerta economica | Ribasso % | 41,831 | 28,040 | 28,805 | 12,909 | 30,000 |
| Punteggio totale | 30,00 | | 68,290 | 90,495 | 82,909 | 93,125 |
| DITTA | 100,00 | | DRAEGER PRIMUS 2002 | GE MEDICAL CARESTATION 650 | MAQUET FLOW IC20 | MINDRAY WATO EX 65 PRO |
| PRODOTTO | | | 304,0000 | 576,0000 | 2.240,0000 | 1.315,0000 |

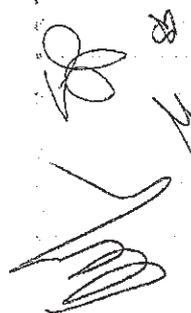





| | LOTTO 3: APPARECCHI PER TERAPIA INTENSIVA | Max punti | Parametri di valutazione a base di gara | | Dräger Medical Italia s.p.a. Medical Italia E118V500 | GE Medical s.p.a. S/stems Italia R860 | Magquitalia spa. Servo-U | Burke&Burke pa. Hamilton G5 |
|-----------------------------|---|-----------|---|----------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Totale punteggio di qualità | 70,00 | | | 56,918 | 49,719 | 51,837 | 61,116 |
| | Totale punteggio di qualità riparametrato | | | | 65,191 | 56,946 | 59,372 | 70,000 |
| Prezzo offerto | | | | | 22,900,000 | 21,300,000 | 24,000,000 | 15,500,000 |
| Base gara per lotto | | | 35,008,000 | 177,45,000,000 | 1.122.100,00 | 1.038.800,00 | 1.176.000,00 | 906.500,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 38,143 | | 34,571 | 39,429 | 31,429 | 47,143 |
| Punteggio offerta economica | | 30,00 | | | 24,472 | 27,429 | 22,247 | 30,000 |
| | | | | | | | | |
| Punteggio totale | | 100,00 | | | 89,663 | 84,375 | 81,620 | 100,000 |
| DITTA | | | | | DRAEGER EVITA INFINITY V500 | GE MEDICAL CARESCAPE R860 | MIAQUET SERVO-U | BURKE&BURKE HAMILTON G5 |
| PRODOTTO | | | | | 2.244,200 | 4.155,200 | 11.760,000 | 4.532,500000 |

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

| LOTTO 4 VENTILATORI POLMONARI PER PNEUMOLOGIA | Modello offerto | Parametri di valutazione a base di gara | Max punti | Parametri di valutazione a base di gara | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------|--|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | Draeger Medical Italia S.p.A. Saving 300 | Carefusion (Italy) Carefusion Comprehensive IXG | Burke&Burke S.p.A. Hamilton C3 | Mindray Medical Italia S.p.A. SV-300 | Philips Healthcare S.p.A. Respiromics Y680 | Medigas Italia S.p.A. Bellavista |
| Totale punteggio di qualità | 60,00 | | | 39,712 | 46,867 | 42,452 | 47,404 | 35,296 | 47,004 |
| Totale punteggio di qualità riparametrato | | | | 50,264 | 59,320 | 53,732 | 60,000 | 44,674 | 59,493 |
| Prezzo offerto | | | | 115,000,00 | 9,400,000 | 13,800,000 | 7,750,000 | 10,400,000 | 12,950,000 |
| Base gara per lotto | | 115,000,000 | | 103,500,00 | 84,600,00 | 124,400,00 | 68,750,00 | 93,600,00 | 116,550,00 |
| | | | Ribasso % | 23,333 | 37,333 | 8,000 | 48,333 | 30,667 | 13,667 |
| Punteggio offerta economica | 40,00 | | | 31,240 | 37,948 | 10,711 | 40,000 | 36,705 | 18,298 |
| Punteggio totale | 100,00 | | | 81,504 | 97,268 | 64,443 | 100,000 | 81,379 | 77,791 |

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

| | LOTTO 5 Ventilatore da trasporto/emergenza | Max punti | Parametri di valutazione (valori a base di gara) | | AIR LIQUIDE MOMMAI T60 | BURKE & BURKE HAMILTON T1 |
|-----------------------------------|--|--------------|--|------------|---------------------------|------------------------------|
| | Totale punteggio di qualità | 60,00 | | | 50,708 | 56,757 |
| | Totale punteggio di qualità riparametrato | | | | 53,606 | 60,000 |
| Prezzo offerto | | | | | 1.123,880 | 168.000,00 |
| Base gara per lotto | | | 17.000,00 | 170.000,00 | 112.388,00 | 168.000,00 |
| | | | | | 33,889 | 1,176 |
| | | Ribasso % | 5,844 | | 33,889 | 1,176 |
| Punteggio offerta economica | | 40,00 | | | 40,000 | 26,759 |
| Punteggio totale | | 100,00 | | | 93,606 | 86,759 |
| DITTA | | | | | AIR LIQUIDE | BURKE & BURKE |
| PRODOTTO | | | | | Momma T60 | Hamilton T1 |

1.123,880

840,000

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials 'SB' on the right.

Scheda valutazione Lotti 4 e 6

| LOTTO 6 - CPAP perdegenza | | Max punti | Parametri di valutazione - valori a base di gara | Medigas Italia Srl |
|-----------------------------|---|-----------|--|--------------------|
| Modello offerto | | | | RESmart GII CPAP |
| | Totale punteggio di qualità | 60,00 | | 58,000 |
| | Totale punteggio di qualità riparametrato | | | 60,000 |
| Prezzo offerto | | | 5.225,00 | 275,000 |
| Base gara per lotto | | 800,00 | 15.200,00 | |
| | Ribasso % | | 65,625 | 65,625 |
| Punteggio offerta economica | | 40,00 | | 40,000 |
| Punteggio totale | | 100,00 | | 100 |
| DITTA | | | | MEDIGAS |
| PRODOTTO | | | | RESMART GII CPAP |

6,1750

[Handwritten signatures and initials]

| | LOTTO 8- VENTILATORE PER VENTILAZIONE CONVENZIONALE E AD ALTA FREQUENZA OSCILLATORIA PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE | Max punti | Parametri di valutazione- valori a base di gara | | Draeger Italia spa "Babylog VN 500" | Burke&Burke spa "Fabian Hofi" |
|-----------------------------|--|-----------|---|------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | Totale punteggio di qualità | 70,00 | | | 65,954 | 56,600 |
| | Totale punteggio di qualità riparametrato | | | | 70,000 | 60,072 |
| Prezzo offerto | | | | | 30.200,00 | 22.500,00 |
| Base gara per lotto | | | 35.000,00 | 140.000,00 | 120.800,00 | 90.000,00 |
| | | | | | 13,714 | 35,714 |
| | | Ribasso % | | | 13,714 | 35,714 |
| Punteggio offerta economica | | 30,00 | | | 22,351 | 30,000 |
| Punteggio totale | | 100,00 | | | 92,351 | 90,072 |
| DITTA | | | | | DRAEGER | BURKE&BURKE |
| PRODOTTO | | | | | BABYLOG VN 500 | FABIAN HOFI |

241,600

450,000

| | LOTTO 9 - Ventilatore per ventilazione non-invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità invasiva | Max punti | Parametri di valutazione - valori a base di gara | | Draeger Medical Italia spa - Evita Infinity V500 |
|-----------------------------|---|-----------|--|------------|--|
| | Totale punteggio di qualità | 70,00 | | | 63,000 |
| | Totale punteggio di qualità riparametrato | | | | 70,000 |
| Prezzo offerto | | | | | 23.000,00 |
| Base gara per lotto | | | 35.000,00 | 140.000,00 | 92.000,00 |
| | | | | | 34,286 |
| | | Ribasso % | 34,286 | 100,000 | 34,286 |
| Punteggio offerta economica | | 30,00 | | | 30,000 |
| Punteggio totale | | 100,00 | | | 100,00 |
| DITTA | | | | | DRAEGER EVITA INFINITY V500 |
| PRODOTTO | | | | | |

184,000

Handwritten signature and initials

| | LOTTO 10: VENTILATORE PER VENTILAZIONE INVASIVA PER TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA | Max punti | Parametri di valutazione - valori a base di gara | | DRAEGER Medical Italia s.p.a. - LEVIA Infinity V500 | GE Medical Systems Italia s.p.a. - CARESCAPE R860 | Maquet Italia s.p.a. - SERVO-U |
|-----------------------------|--|-----------|--|------------|---|---|--------------------------------|
| | Totale punteggio di qualità | 70,00 | | | 54.859 | 39.800 | 62.272 |
| | Totale punteggio di qualità riparametrato | | | | 61.667 | 44.739 | 70.000 |
| Prezzo offerto | | | | | 23.000,00 | 18.300,00 | 28.000,00 |
| Base gara per lotto | | | 35.000,00 | 140.000,00 | 92.000,00 | 73.200,00 | 112.000,00 |
| | | | | | 34,286 | 47,714 | 20,000 |
| | Ribasso % | | 34,000 | | 34,286 | 47,714 | 20,000 |
| Punteggio offerta economica | | 30,00 | | | 27.063 | 30.000 | 15.882 |
| Punteggio totale | | 100,00 | | | 88.729 | 74.739 | 85.882 |
| DITTA | | | | | DRAEGER | GE MEDICAL | MAQUET |
| PRODOTTO | | | | | EVITA INFINITY V500 | CARESCAPE R860 | SERVO-U |

184,000

292,800

1.120,000

Handwritten signatures and initials:
 Top left: [Signature]
 Top right: [Signature]
 Middle left: 9
 Middle right: [Signature]
 Far right: sb

| | LOTTO 11 - Apparecchio a circuito aperto, semi-chiuso e chiuso a bassi flussi per anestesia neonatale e pediatrica utilizzabile anche su pz. adulto | Max punti | Parametri di valutazione - valori a base di gara | | Draeger Medical Italia spa - Perseus |
|-----------------------------|---|---------------|--|------------|--------------------------------------|
| | Totale punteggio di qualità | 70,00 | | | 64,000 |
| | Totale punteggio di qualità riparametrato | | | | 70,00 |
| Prezzo offerto | apparecchio | | 35.000,00 | 210.000,00 | 245.000,00 |
| | monitoraggio | | 5.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| Base gara per lotto | totale | | 40.000,00 | 240.000,00 | 280.000,00 |
| | | Ribasso % | | 24,250 | 24,250 |
| Punteggio offerta economica | | 30,00 | | | 30,000 |
| Punteggio totale | | 100,00 | | | 100 |
| DITTA | | | | | DRAEGER |
| PRODOTTO | | | | | PERSEUS |

363,600

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari occorrenti¹⁾

occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria

LOTTO 1

N. gara: 6621976

CIG: 692801392E

OFFERTA ECONOMICA n. 17/G.35/ANE/E/ME

| Descrizione lotto (1) | Prezzo unitario posto a base d'asta (IVA esclusa) (2) | Nome commerciale prodotto offerto (3) | N° reperitorio (4) | Codice C.A.D. (5) | Prezzo unitario prodotto offerto (IVA esclusa) (6) | | Quantitativo triennale (espresso in numero di pezzi unitari) (7) | Importo complessivo triennale lotto (IVA esclusa) (8) | | % di sconto (9) | % IVA da applicare (10) |
|--|--|--|-----------------------|-------------------------|---|--|---|---|---|--------------------|----------------------------|
| | | | | | In dote | In kit/box | | In dote | In kit/box | | |
| Apparecchio per anestesia di alta fascia | 55.000,00 | AISYS CS ² | 943195 | Z1203010101 | € 25.480,00 | venticinquemilaquattrocentotantafai/00 | 35 | € 891.800,00 | ottocentonovantunomilaottocentofai/00 | | |
| Monitoraggio parametri vitali (acquisibile separatamente) | 5.000,00 | Carescape B660 | 950996 | Z1203020201 | € 4.981,00 | quattromilanoventiconovantunoi/00 | 33 | € 189.658,00 | centofianovemilašeicentocinquantaio/00 | | |
| Colorecervaglio parametri emodinamici (acquisibile separatamente) | 10.000,00 | E-PICCO | 906878 | Z1203020280 | € 1.090,00 | millenovantafai/00 | 34 | € 37.060,00 | trentasettemilasestantafai/00 | | |
| Monitoraggio del livello di anidossido (acquisibile separatamente) | 15.000,00 | E-ENTROPY | 874976 | Z1203020280 | € 875,00 | ottocentosestantacinque/00 | 37 | € 32.375,00 | trentadueemilatrecentosestantacinque/00 | | |
| Monitoraggio della trasmissione ultrasonografica | 10.000,00 | E-NMT | | Z1203020280 | € 775,00 | settecentosestantacinque/00 | 33 | € 29.450,00 | ventinovemilaquattrocentocinquantaifai/00 | | |
| Importo complessivo Lotto 1 | | | | | | | | € 1.180.343,00 | unmilioneottotantamilairecentoquarantatrafai/00 | 58,121% | 22% |

1) - Modulo 80
 1) - Modulo 80
 2) - Nome commerciale di prodotto e codice (modello) di cui è applicabile il D.Lgs. n. 50/2016 art. 101 comma 1 lett. a)
 3) - Proprietario di diritto esclusivo di Distribuzione Major per il territorio di fornitura con rapporto di esclusiva (modello) di cui è applicabile il D.Lgs. n. 50/2016 art. 101 comma 1 lett. a)
 4) - In caso di offerta con più di un numero di reperitorio, il prezzo unitario per ogni voce deve essere indicato in base d'asta.
 5) - In caso di offerta con più di un numero di codice C.A.D., il prezzo unitario per ogni voce deve essere indicato in base d'asta.
 6) - Il prezzo unitario deve essere espresso in euro e arrotondato a due cifre decimali.
 7) - Il quantitativo triennale deve essere espresso in numero di pezzi unitari.
 8) - Il prezzo unitario deve essere espresso in euro e arrotondato a due cifre decimali.
 9) - Il prezzo unitario deve essere espresso in euro e arrotondato a due cifre decimali.
 10) - Il prezzo unitario deve essere espresso in euro e arrotondato a due cifre decimali.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) per il presente lotto, è pari ad Euro 4.721.372 (in lettere quattromilaseicentotrentaduecentoventuno/372)

Timbro e firma leggibile
 del legale Rappresentante della Ditta offerente

Data: 02/02/2017

N.B.: DA STAMPARE SU FORMATO A3

GE Medical Systems Italia S.p.A.

Sede: Chitica
 Procurement



Denominazione Sociale: GE Medical Systems
 Italia S.p.A.
 Codice Fiscale: 93027710016
 Partita IVA: 03663500969

ALLEGATO F2)

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.L.gs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari occorrenti" occorrenti" alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria

LOTTO 2

N. gara: 6621976
 CIG: 6928019E20

OFFERTA ECONOMICA n. 17.G.36.ANE.E/me

| Descrizione lotto (1) | Prezzo unitario prezzo a base fissa (IVA esclusa) (2) | Nome commerciale prodotto offerto (3) | N° requisitoro (4) | Codice C.N.D. (5) | Prezzo unitario prodotto offerto (IVA esclusa) (6) | | Quantitativo triennale (espresso in numero di pezzi unitari) (7) | Importo complessivo triennale lotto (IVA esclusa) (8) | | % di sconto (9) | % IVA da applicare (10) |
|-----------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|---|------------------|---|---|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | In cifra | In lettere | | In cifra | In lettere | | |
| Apparecchio per anestesia di base | 25.000,000 | Caromation CS650 | 1309450 | Z1203010191 | € 18.000,000 | dieciottomila/00 | 8 | € 144.000,000 | centoquarantaquattromila/00 | 43,571% | 22% |

LEGGENDO:
 (1) - Descrizione lotto
 (2) - Prezzo unitario offerto per base fissa (IVA esclusa)
 (3) - Nome commerciale del prodotto offerto e codice di identificazione del prodotto
 (4) - Numero di riferimento del lotto
 (5) - Codice C.N.D. (Codice Nazionale di Identificazione) del prodotto offerto
 (6) - Prezzo unitario offerto per base fissa (IVA esclusa)
 (7) - Quantitativo triennale (espresso in numero di pezzi unitari)
 (8) - Importo complessivo triennale lotto (IVA esclusa)
 (9) - Sconto applicato sul prezzo unitario offerto (IVA esclusa)
 (10) - Percentuale di IVA applicabile al prezzo unitario offerto (IVA esclusa)

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad Euro 578,00 (in lettere cinquecentosettantasei/00)

Timbro e firma leggibile
 del legale Rappresentante della Ditta offerente

Data: 02/02/2017
 M.S. : DA STAMPARE SU FORMATO A3

GE Medical Systems Italia S.p.A.
 Sara Pichica
 Procuratore


ALLEGATO F2)

OFFERENTE: MAQUET Italia S.p.A. - Via Gozzano n. 14 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - partita IVA 03992220966

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari occorrenti**

occorrenti** alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria

LOTTO 2

N. gara: 6621976

CIG: 6928019E20

OFFERTA ECONOMICA

| Descrizione lotto (1) | Prezzo unitario prezzo a base creata (IVA esclusa) (2) | Nome commerciale prodotto offerto (3) | N° repartito (4) | Codice C.A.D. (5) | Prezzo unitario prezzo offerto (IVA esclusa) (6) | | Quantitativo finale (espresso in numero di pezzi offerti) (7) | Importo complessivo totale (IVA esclusa) (8) | | % IVA da applicare (10) |
|-----------------------------------|---|---|---------------------|-------------------------|---|------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| | | | | | in euro | in lire | | in euro | in lire | |
| Apparecchio per anestesia di base | 250.000,0000 | Apparecchio per anestesia modello Fibre-1 C29 | 344577R | Z1203916161 | 28.000,000 | ventoottomila/00 | 0 | 224.000,000 | dieciottoventiquattromila/00 | 22% |

Produttore: Maquet Criticat Care AB - Sotna - Svezia - partita IVA SE55604872101

Leggenda:
 (1) - Descrizione del lotto.
 (2) - Prezzo unitario offerto per ogni pezzo offerto.
 (3) - Nome commerciale del prodotto offerto.
 (4) - Numero di pezzi offerti.
 (5) - Codice CAD (Classificazione Anestesiologica) del prodotto offerto.
 (6) - Prezzo unitario offerto per ogni pezzo offerto (IVA esclusa).
 (7) - Quantitativo finale offerto.
 (8) - Importo complessivo offerto (IVA esclusa).
 (9) - Importo complessivo offerto (IVA inclusa).
 (10) - Percentuale di IVA da applicare.

La Offerta economica del lotto è valida solo in caso di accettazione dell'offerta complessiva.
 Per il presente lotto il prezzo è pari ad Euro 2.500,000
 in lettere duecentocinquanta/000

Data: 02/02/2017

N.B. : DA STAMPARE SU FIORNATO A3

Timbro e firma leggibile
 del Legale Rappresentante della Offerta

MAQUET ITALIA S.p.A.
 MAURO MARIO MARGARINI
 Procuratore

Mauro Mario Margarini

BURKE & BURKE S.p.A.
Via Einstein 32 - 20090 ASSAGO (MI)
C.F. 02737030151 - P. IVA 01059580107

23 8



ALLEGATO F2)

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari occorrenti

occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria

LOTTO 3
N. gara: 6621976
CIG: 6928028590

OFFERTA ECONOMICA (N. PREV. N. 032/HM/17)

| Descrizione lotto (1) | Prezzo unitario posto a base d'asta (IVA inclusa) (2) | Quantità commerciale proposta offerta (3) | Codice C.A.D. (4) | Prezzo unitario proposto offerto (IVA inclusa) (5) | | Quantitativo (rimborso) espresso in numero di pezzi/unitari (6) | Importo complessivo stimato lotto (IVA inclusa) (7) | | % di acconto (8) | % IVA da applicare (9) |
|----------------------------------|---|---|-------------------|--|-------------------|---|---|---------------------|------------------|------------------------|
| | | | | in euro | in lire | | in euro | in lire | | |
| Apparecchi per terapia intensiva | 37.000,00 | HAMILTON-O5, ventilatore polmonare (Produttore: HAMILTON MEDICAL AG. CH) codice HM139001 eNGAGE ULTERIORI DETTAGLI SONO RAPPRESENTATI NEL NS. PREVENTIVO N. 032/HM/17 ALLEGATO ALLA PRESENTE | 165983/R | 2120091002 | euro 18.580,00 | 45 | euro 908.590,00 | 35% (già applicata) | 22% | |

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad Euro 4.632,50 =
(in lettere euro quattromilacinquecentotrentadue/50)

Timbro e firma leggibile
del legale Rappresentante della ditta offerente
BURKE & BURKE S.p.A.
Giuseppe Bonandrim
Amministratore Delegato / Presidente C.d.A.

Data, 23 gennaio 2017
N.B.: DA STAMPARE SU FORMATO A3

Denominazione Sociale: GE Medical Systems Italia S.p.A.
 Codice Fiscale: 93027710016
 Partita IVA: 03663500969

ALLEGATO F2)

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari occorrenti⁷⁷

occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria

LOTTO 3

N. gara: 6621976

CIG: 6928028590

OFFERTA ECONOMICA n. 17 G.37.RESP.E/me

| Descrizione lotto (1) | Prezzo unitario prezzo a base d'asta (IVA esclusa) (4) | Nome commerciale prodotto offerto (5) | N° operatore (6) | Codice C.A.L.A. (8) | Prezzo unitario prodotto offerto (IVA esclusa) (9) | | Quantitativo annuale (espresso in numero di pezzi unitari) (7) | Importo complessivo (in euro) (IVA esclusa) (10) | | % IVA da applicare (11) |
|----------------------------------|---|--|---------------------|----------------------------|---|------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | in cifre | in lettere | | in cifre | in lettere | |
| Apparecchi per terapia intensiva | 35.000,000 | Caracappe R603 completo di modulo EscCOVX. (Le opzioni richieste sono state quotate nell'Allegato parte integrante) | 1197988 1270371 | 21232010502 21232020280 | € 21.200,000 | ventunomiladuecento/00 | 49 | € 1.038.800,000 | un milione trentottomilaottocento/00 | 22% |

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (compreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad Euro 4.155,20
 (in lettere quattromilacentoquarantacinque/20)

Tintiro e firma leggibile
 del legatè Rappresentante della Ditta offerente

GE Medical Systems Italia S.p.A.
 Sede Sociale
 P.le S. Maria Maddalena, 1
 10121 TORINO (TO)
Redauro

Data, 02/02/2017

N.B.: DA STAMPARE SU FORMATO A3

ALLEGATO F2)

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria

LOTTO 3

N. gara: 6621976
CIG: 6928028590

| OFFERTA ECONOMICA | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---|---------------|
| Descrizione (1) | Prezzo unitario (2) | Quantità (3) | Importo complessivo (4) | Quantità (5) | Importo complessivo (6) | Quantità (7) | Importo complessivo (8) | Quantità (9) | Importo complessivo (10) | | |
| Apparecchi per terapia intensiva | 36.000,000 | 1 | 36.000,000 | ventilatore meccanico | 22.500,000 | 1 | 22.500,000 | umilione cartoventilatore | 1.121.100,000 | 1 | 1.121.100,000 |
| <p>1) - Descrizione dell'offerta</p> <p>2) - Prezzo unitario</p> <p>3) - Quantità</p> <p>4) - Importo complessivo</p> <p>5) - Quantità</p> <p>6) - Importo complessivo</p> <p>7) - Quantità</p> <p>8) - Importo complessivo</p> <p>9) - Quantità</p> <p>10) - Importo complessivo</p> | | | | | | | | | | | |

1) - Descrizione dell'offerta

2) - Prezzo unitario

3) - Quantità

4) - Importo complessivo

5) - Quantità

6) - Importo complessivo

7) - Quantità

8) - Importo complessivo

9) - Quantità

10) - Importo complessivo

DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA
Purificare Specifici
Pulizie Neodril

Thimo e firm. Legale
del legale rappresentante della Ditta offerente

MS: DA STAMPARE SU FORMATO A3

BURKE & BURKE S.p.A.
Via Einstein 32 - 20090 ASSAGO (MI)
C.F. 02737030151 - P. IVA 01059590107

ALLEGATO F2)

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari occorrenti per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria

LOTTO 4
N. gara: 6621976
CIG: 6928045398

| OFFERTA ECONOMICA (NS PREV N. 033/HM/17) | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------------------|--|-----------|---|--|------------|---------------------|---------------------|
| Descrizione lotto (1) | Prezzo unitario, posto a base (IVA esclusa) (2) | Awards amministrativa e sistema offerte (3) | N° repertorio (4) | Codice C.A.L. (5) | Prezzo unitario prodotto offerto (IVA esclusa) (6) | | Quantitativo (quantità espresse in numero di pezzi unitari) (7) | Importo complessivo (prezzo unitario, lotto IVA esclusa) (8) | | % di crescita (9) | % di riduzione (10) |
| | | | | | Sublotto | Quantità | | Sublotto | Importo | | |
| Ventilatori polmonari per pneumologia | 15.000,00 | HAMILTON-C3, ventilatore polmonare Produttore: HAMILTON MEDICAL AG, CH codice HM160015 SOLAZZO LE TERAPIE DEI TAGLI SONO RAPPRESENTATI NEL NS. PRESENTIVO N. 033/HM/17 ALLEGATO ALLA PRESENTE | 574187 | Z202091554 | euro trecentocinquantocento/00 | 13.800,00 | 9 | euro centoventiquattro miladuecento/00 | 124.200,00 | 35% (già applicata) | 22% |


La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad Euro 621,00 (in lettere seicentventuno/00)

Timbro e firma leggibile
del legale Rappresentante della Ditta offerente

BURKE & BURKE S.p.A.
Giuseppe Bonandrini
Amministratore Delegato / Presidente C.d.A.

Data: 23 gennaio 2017

N.B.: DA STAMPARE SU FORNATO A3

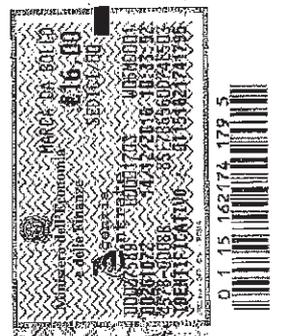

LEGENDA:
(1) - Descrizione lotto
(2) - Prezzo unitario posto a base (IVA esclusa)
(3) - Note amministrative del prodotto o modello presentati al sottogruppo ufficiale di Procurement.
(4) - Progressivo di sicurezza applicato al Documento Unico di Affidamento (DUA) in riferimento al prodotto offerto.
(5) - Codice C.A.L. (Codice di Attività) secondo il sistema di classificazione delle attività economiche (C.A.T.) del D.Lgs. n. 20 del 28 febbraio 2007.
(6) - Prezzo unitario offerto (IVA esclusa) e prezzo unitario IVA inclusa (IVA inclusa). 20% senza diritto di recupero e senza esenzione dalla base d'imposta.
(7) - Quantità massima fornibile a garanzia di continuità nel servizio di fornitura.
(8) - Importo complessivo (prezzo unitario, lotto IVA esclusa) e importo complessivo IVA inclusa (IVA inclusa).
(9) - La percentuale di crescita rispetto al prezzo unitario IVA inclusa del periodo di riferimento precedente.
(10) - La percentuale di riduzione rispetto al prezzo unitario IVA inclusa del periodo di riferimento precedente.

ALLEGATO F2)

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari occorrenti

occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria

LOTTO 4

N. gara: 8621976


CIG: 6928045398

OFFERTA ECONOMICA

| Descrizione lotto (1) | Prezzo unitario prezzo a base dasta (IVA esclusa) (2) | Nome commerciale prodotto offerto (3) | Codice ATC (4) | Quantitativo unitario (prezzo al numero di pezzi unitari) (5) | Prezzo unitario prezzo a forfait (IVA esclusa) (6) | Quantitativo unitario (prezzo al numero di pezzi unitari) (7) | Importo complessivo trattata, lotto (IVA esclusa) (8) | Tassa di scatto (9) | IVA di applicare (10) |
|---------------------------------------|--|--|----------------------|--|---|--|---|------------------------|--------------------------|
| Ventilatori polmonari per pneumologia | 15.000,000 | Ventilatore IST Mod. Bellevista 1000 completo di: - reattivo integrato - modulo SW Target Vent - modulo SW Configuration ad all'filassi (HFOT) - carrello porta ventilatore - braccio di supporto per circuiti Produttore: INT MEDICAL AG GEMWERBERSTRASSE 6 - 9479 - BUCHS - CHE FAX 522 860 | 1108007 | Z1203070602 | 12.850,000 | 9 | 116.250,000 | 1,50% | 22% |

La Ditta offerente dichiara che il costo riferito alla presente offerta non è inferiore a quello applicato per le prestazioni di cui è oggetto l'offerta.

La Ditta offerente dichiara che il costo riferito alla presente offerta non è inferiore a quello applicato per le prestazioni di cui è oggetto l'offerta.



Tambo e firma leggibile
del legale Rappresentante della Ditta offerente

MEDIGAS Italia S.r.l. - P.I. 1191240155 - C.F. 02468440167
MEDIGAS
MEDICAL S.p.A. S.r.l.
Il Direttore Generale
Dott. Giancarlo Fontana

DNIS: 3/10/2017

N.B.: DA STAMPARE SU FORMATO A3



ALLEGATO F2)

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari occorrenti**

occorrenti alle A.A.S.S.L.L., E.E.O.O., I.R.C.C.S. della Regione Liguria

LOTTO 4
 N. gara: 6621976
 CIG: 6928045386

Ditta Offrente: CareFusion Italy 311 Srl Unipersonale - Via Ticino 4, 50019 Sesto Fiorentino 50019 (FI) P.IVA 04647720483
 Ditta Produttrice: - CareFusion - Intermed, Rua Santa Monica, 980 Pq. Industrial San Jose, Cotia, SP Brasil

OFFERTA ECONOMICA

| Descrizione lotto | Prezzo unitario per unità di misura (IVA inclusa) | Quantità C.O.P. | Importo C.O.P. | Quantità massima per unità di misura per lotto (IVA inclusa) | Importo lotto (IVA inclusa) | % di centro rate per unità di misura (IVA inclusa) | Importo lotto (IVA inclusa) |
|--|---|--------------------|-------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Ventilatori polmonari per pneumologia | 19.000,000 | 181689 | 3.451.602,00 | 8 | 152.000,00 | 57,29% | 458.000,00 |
| VENTILATORE DAS complesso di cambio | | 2120910564 | 6.400,00 | 8 | 64.000,00 | | 644.000,00 |
| | | | | totale | | | |
| | | | | totale con IVA inclusa | | | |
| | | | | totale con IVA inclusa e con I.P.T. | | | |

AVVERTENZE

1) Il presente documento è riservato ai soli partecipanti alla gara.

2) Il presente documento è valido fino alla data di scadenza della gara.

3) Il presente documento è valido fino alla data di scadenza della gara.

4) Il presente documento è valido fino alla data di scadenza della gara.

5) Il presente documento è valido fino alla data di scadenza della gara.

6) Il presente documento è valido fino alla data di scadenza della gara.

7) Il presente documento è valido fino alla data di scadenza della gara.

8) Il presente documento è valido fino alla data di scadenza della gara.

9) Il presente documento è valido fino alla data di scadenza della gara.

10) Il presente documento è valido fino alla data di scadenza della gara.

Tributo e Fisco Legale
 del legale rappresentativo della Ditta Offrente

CareFusion Italy 311 Srl Unipersonale
 Rappresentante Legale
[Firma]

Dati: 18/02/2017

N.B.: DA STAMPARE SU FORMATO A4

ALLEGATO F2)

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari occorrenti*

occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria

LOTTO 4

N. gara: 6621976
CIG: 6928045398

| OFFERTA ECONOMICA | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Descrizione (A) | Codice articolo (B) | Quantità (C) | Prezzo unitario (D) | Prezzo totale (E) | Importo complessivo (F) | Importo complessivo (G) | Importo complessivo (H) | Importo complessivo (I) | Importo complessivo (J) |
| Ventilatori polmonari per pneumologia | SAVINA 300 | 15700,000 | 11.500,000 | 179.650,000 | 179.650,000 | 179.650,000 | 179.650,000 | 179.650,000 | 179.650,000 |
| <p>SAVINA 300</p> | | | | | | | | | |

1) L'offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata con il sigillo del candidato.
2) L'offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata con il sigillo del candidato.
3) L'offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata con il sigillo del candidato.
4) L'offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata con il sigillo del candidato.
5) L'offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata con il sigillo del candidato.
6) L'offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata con il sigillo del candidato.
7) L'offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata con il sigillo del candidato.
8) L'offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata con il sigillo del candidato.
9) L'offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata con il sigillo del candidato.
10) L'offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata con il sigillo del candidato.

DATA: 01/09/2017

N.B. 1. DA STAMPARE SU FORMATO A4

TRUCCO & FUSI S.p.A.
DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA
Procuratore Speciale
Prestige Neotti
Weed

TURCO & FUSI S.p.A.
di Legale Rappresentanza della Ditta editrice


La Ditta Offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata con il sigillo del candidato.
per il presente lotto il prezzo unitario è pari a 11.500,000
di lire (undicimillesimi)

BURKE & BURKE S.p.A.
Via Einstein 32 - 20090 ASSAGO (MI)
C.F. 02737930151 - P. IVA 01059390107

ALLEGATO F2)

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari occorrenti*
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria

LOTTO 5
N. gara: 6621976
CIG: 6923054B03

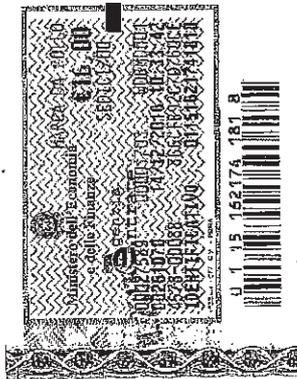

| OFFERTA ECONOMICA (NS PREV. N.034/HM/17) | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------|---|--|------------------------|--------------------------|
| Descrizione lotto (1) | Prezzo unitario per la base d'asta (IVA esclusa) (2) | Nome commerciale prodotto-offerta (3) | Codice C.I.G. (4) | Prezzo unitario prezzo offerto (IVA esclusa) (5) | | Quantitativo richiesto (prezzo in numero di pezzi applicati) (6) | Importo complessivo biennale lotto (IVA esclusa) (7) | % di sconto (8) | % IVA applicabile (9) |
| | | | | lotto | lotto | | | | |
| Ventilatori polmonari per anestesia/terapia | 18.800,00 | HAMILTON-T1, ventilatore polmonare (Produttore: HAMILTON MEDICAL AG, CH) codice HR161006 ALCANTARA ULTERIORI DETTAGLI SONO RAPPRESENTATI NELL'NS PREVENTIVO N. 034/HM/17 ALLEGATO ALLA PRESENTE | Z12339104 | euro sedici mila e ottocento | 18.800,00 | 10 | euro centosessanta- mila e 800 | 35% (già applicata) | 22% |

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad Euro 840,00
(in lettere euro ottocentoquaranta/00)

Timbro e firma leggibile
dal legale Rappresentante della Ditta offerente

BURKE & BURKE S.p.A.
Giuseppe Bonandrini
Amministratore delegato / Presidente C.d.A.

Data 25 gennaio 2017

N.B.: 1) DA STAMPARE SU FORMATO A5

1) - Descrizione del lotto
2) - Prezzo unitario per pezzo o base d'asta (IVA esclusa)
3) - Nome commerciale del prodotto e servizio presso il quale si offre il servizio
4) - Codice C.I.G. (C) - Identificativo del contratto pubblico (C) - Identificativo del lotto (L) - Identificativo del gruppo di lotto (G) - Identificativo del gruppo di servizi (S) - Identificativo del gruppo di servizi (S) - Identificativo del gruppo di servizi (S)
5) - Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)
6) - Quantitativo richiesto (prezzo in numero di pezzi applicati)
7) - Importo complessivo biennale lotto (IVA esclusa)
8) - Percentuale di sconto applicata sul prezzo unitario offerto (IVA esclusa)
9) - Percentuale di IVA applicabile per il prodotto offerto

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari occorrenti¹⁾ occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria

LOTTO 6
 N. gara: 6621976
 CIG: 6928060FF5

OFFERTA ECONOMICA

| Descrizione lotto (1) | Prezzo unitario per unità (2) | Quantità (3) | Valore complessivo lotto (4) | Codice CIG (5) | Prezzo unitario prodotto offerto (IVA inclusa) (6) | | Quantitativo offerto (espresso in numero di pezzi/unitari) (7) | Valore (8) | | % di risparmio (9) | % IVA di ritenuta (10) |
|--|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|---|---------|---|---------------|--------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | | % di cui | Valore | | % di cui | Valore | | |
| C-FAP per doginze | 800,000 | 19 | 1520,000 | Z12030102 R060201 | 1409832 1409833 | 275,000 | 19 | 5.225.000 | 95,07% | 22% | |
| 176600010 - SISTEMA CPAP BMC Mod. RESmart GII CPAP completo di 176700000 - Sistema di Umificazione BMC Mod. RESmart GII H60 Produttore: BMC MEDICAL CO., LTD 8/F Main Building, No.19 Guocheng Street West - Shijingshan, Beijing - China | | | | | | | | | | | |

1) - Per informazioni sul lotto, si veda l'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016.
 2) - Il prezzo unitario offerto deve essere espresso in Euro (€) con due cifre decimali.
 3) - Il quantitativo offerto deve essere espresso in numero di pezzi/unitari.
 4) - Il valore complessivo del lotto offerto deve essere espresso in Euro (€) con due cifre decimali.
 5) - Il codice CIG deve essere quello assegnato al lotto in oggetto.
 6) - Il prezzo unitario offerto deve essere espresso in Euro (€) con due cifre decimali.
 7) - Il quantitativo offerto deve essere espresso in numero di pezzi/unitari.
 8) - Il valore del lotto offerto deve essere espresso in Euro (€) con due cifre decimali.
 9) - Il risparmio deve essere espresso in percentuale (%) con due cifre decimali.
 10) - L'IVA di ritenuta deve essere espressa in percentuale (%) con due cifre decimali.

La Ditta offre una garanzia di 2 anni sulla vita del sistema (sommario) in favore del cliente.
 Per il servizio clienti, si veda il sito: www.bmc.com
 (9) Valore Euro: 5.225.000

Cdigi, 3/10/2017

N.B. : DA STAMPARE SU FORMATO A3

Tirino e firma leggibile
 del legale rappresentante della Ditta offerente

MEDIGAS Italia S.r.l. - P.I. 11891249752 - C.F. 02466440167



BURKE & BURKE S.p.A.
 Via Einstein 32 - 20090 ASSAGO (MI)
 C.F. 02737030151 - P. IVA 01059590107

ALLEGATO F2)

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari occorrenti"


occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria

LOTTO 8

N. gara: 6621976
 CIG: 6928070838

| OFFERTA ECONOMICA (N. PREV. 035/AG/17) | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------|-----------|---|--|------------------------|-------------------------|-----|
| Descrizione lotto (1) | Prezzo unitario netto e base dasta (2) | Nome commerciale prodotto offerto (3) | N° sequenziale (4) | Codice CATA (5) | | Quantitativo formale (espresso in millesimi di pezzi unitari) (7) | Importo complessivo (biennale lotto) (8) | | % IVA da applicare (10) | |
| | | | | in natura | in valore | | in natura | in valore | | |
| Ventilatori per ventilazione non invasiva per terapia intensiva neonatale | 22.500,00 | Fabian HFOi, ventilatore Neonatal-respiratorio (Produttore: Acoustic Medical Systems, Svizzera) codice AC720A1 NOTE ULTERIORI DETTAGLI SONO RAPPRESENTATI NEL N. PREVENTIVO N. 035/AG/17 ALLEGATO ALLA PRESENTE | 1289881 | 2203910801 | 1 | 22.500,00 | euro ventiduemila- cinquecento/00 | euro novantamila/00 | 35% (già applicata) | 22% |

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo), per il presente lotto, è pari ad Euro 450,00 (in lettere euro quattrocentocinquanta/00)

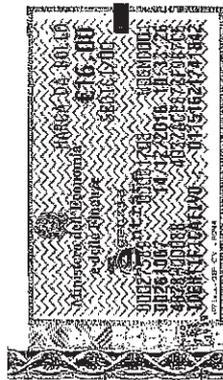

Data: 29 gennaio 2017

N.B. - DA STAMPARE SU FORMATO A3

ALLEGATO F2)

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari occorrenti¹⁾

occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria

LOTTO 9

N. gara: 6621976
CIG: 6928074B84

| OFFERTA ECONOMICA | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Descrizione (colloquio) | Quantità | Prezzo unitario (IVA inclusa) | Prezzo totale (IVA inclusa) | Importo complessivo (IVA inclusa) | Importo complessivo (IVA esclusa) | Importo complessivo (IVA inclusa) con IVA | Importo complessivo (IVA esclusa) con IVA | Importo complessivo (IVA inclusa) con IVA | Importo complessivo (IVA esclusa) con IVA |
| Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel | 1 | 35.000,000 | 35.000,000 | 35.000,000 | 35.000,000 | 35.000,000 | 35.000,000 | 35.000,000 | 35.000,000 |
| <p>1) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel</p> <p>2) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel</p> <p>3) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel</p> <p>4) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel</p> <p>5) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel</p> <p>6) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel</p> <p>7) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel</p> <p>8) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel</p> <p>9) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel</p> <p>10) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel</p> | | | | | | | | | |

1) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel

2) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel

3) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel

4) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel

5) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel

6) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel

7) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel

8) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel

9) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel

10) - Ventilatore per ventilazione non invasiva per terapia intensiva pediatrica con possibilità di utilizzo in modalità Bilevel

DEA: 0700247

N.B.: DA STAMPARE SU FORMATO A3

DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA
Prodotto e distribuito
Prestazioni Sicure
Wester

Trasferimento di diritti di proprietà intellettuale
del Legale Rappresentante della OSA di Roma

U.0701 - Modulo di offerta in cui deve essere indicato il prezzo unitario e il prezzo complessivo IVA inclusa e IVA esclusa per il lotto in oggetto, con IVA inclusa e IVA esclusa.

ALLEGATO F2)

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari occorrenti¹⁾

occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria

LOTTO 10

N. Gara: 8621976
CIG: 6928079FA3

| OFFERTA ECONOMICA | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Descrizione | Quantità | Prezzo unitario (IVA inclusa) | Prezzo totale (IVA inclusa) | Prezzo unitario (IVA esclusa) | Prezzo totale (IVA esclusa) | Importo dell'offerta (IVA inclusa) | Importo dell'offerta (IVA esclusa) | Importo dell'offerta (IVA inclusa) con IVA | Importo dell'offerta (IVA esclusa) con IVA |
| <p>SUCCINIC OILO</p> <p>1) Ventilatore per ventilazione invasiva per terapia intensiva pediatrica</p> <p>2) Ventilatore per ventilazione invasiva per terapia intensiva pediatrica</p> | 15000000 | 50000000 | 7500000000 | 50000000 | 7500000000 | 7500000000 | 7500000000 | 7500000000 | 7500000000 |
| <p>1) - Criterio di scelta</p> <p>2) - Importo dell'offerta</p> <p>3) - Importo dell'offerta (IVA esclusa)</p> <p>4) - Importo dell'offerta (IVA inclusa)</p> <p>5) - Importo dell'offerta (IVA inclusa) con IVA</p> <p>6) - Importo dell'offerta (IVA esclusa) con IVA</p> <p>7) - Importo dell'offerta (IVA inclusa) con IVA e I.P.T.</p> <p>8) - Importo dell'offerta (IVA esclusa) con IVA e I.P.T.</p> <p>9) - Importo dell'offerta (IVA inclusa) con IVA e I.P.T. e I.C.T.</p> <p>10) - Importo dell'offerta (IVA esclusa) con IVA e I.P.T. e I.C.T.</p> | | | | | | | | | |

1) - Criterio di scelta
2) - Importo dell'offerta
3) - Importo dell'offerta (IVA esclusa)
4) - Importo dell'offerta (IVA inclusa)
5) - Importo dell'offerta (IVA inclusa) con IVA
6) - Importo dell'offerta (IVA esclusa) con IVA
7) - Importo dell'offerta (IVA inclusa) con IVA e I.P.T.
8) - Importo dell'offerta (IVA esclusa) con IVA e I.P.T.
9) - Importo dell'offerta (IVA inclusa) con IVA e I.P.T. e I.C.T.
10) - Importo dell'offerta (IVA esclusa) con IVA e I.P.T. e I.C.T.

DRAEGER MEDICAL ITALIA SpA
Procuratore Spoločale
Partizija Veatit

Titolo e firma legale
del legale rappresentante della Ditta aderente

N.5: DANSTAMPARE SU FORWARD/AS

Data: 02/02/2017

Denominazione Sociale: GE Medical Systems Italia S.p.A.
 Codice Fiscale: 93027710016
 Partita IVA: 03663500969

ALLEGATO F2)

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari occorrenti¹⁾ occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria

LOTTO 10

N. gara: 6621976
 CIG: 6928079FA3

OFFERTA ECONOMICA n. 17 G.38.RESP.E/ME

| Descrizione lotto (1) | Prezzo unitario prezzo a base chiusa (IVA esclusa) (2) | Nome commerciale prodotto offerto (3) | N° repertorio (4) | Codice C.N.D. (5) | Prezzo unitario prodotto offerto (IVA esclusa) (6) | | Quantitativo biennale (espresso in numero di pezzi unitari) (7) | Importo complessivo biennale lotto (IVA esclusa) (8) | | % di sconto (9) | % IVA da applicare (10) |
|---|---|--|----------------------|-------------------------|---|-----------------------|--|--|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | in oltre | in oltre | | in oltre | in oltre | | |
| Ventilatore per ventilazione invasiva per terapia intensiva pediatrica | 35.000,000 | Carascapa RB80 | Z7307010502 | 1107988 | € 18.300,000 | diototomilatrecento00 | 4 | € 73.200,000 | settantatremiladuecento00 | 47,714% | 22% |

1) - Descrizione bene
 2) - Importo complessivo lotto
 3) - Importo complessivo lotto
 4) - Per la fornitura di questo lotto, il prezzo unitario di riferimento è quello indicato in questa offerta economica.
 5) - Per la fornitura di questo lotto, il prezzo unitario di riferimento è quello indicato in questa offerta economica.
 6) - Per la fornitura di questo lotto, il prezzo unitario di riferimento è quello indicato in questa offerta economica.
 7) - Per la fornitura di questo lotto, il prezzo unitario di riferimento è quello indicato in questa offerta economica.
 8) - Per la fornitura di questo lotto, il prezzo unitario di riferimento è quello indicato in questa offerta economica.
 9) - Per la fornitura di questo lotto, il prezzo unitario di riferimento è quello indicato in questa offerta economica.
 10) - Per la fornitura di questo lotto, il prezzo unitario di riferimento è quello indicato in questa offerta economica.

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'imponibile complessivo), per il presente lotto, è pari ad Euro 292,80

(in lettere duecentobroventadue/100)

Timbro e firma leggibile
 del legale Rappresentante della Ditta offerente

GE Medical Systems Italia S.p.A.
 Sara Chicca
 Pediatrora