

Dirigente responsabile: dott. Riccardo ZANELLA

Prot. gen. n. 248 del 14/02/2012

## Deliberazione n. 09 del 14 febbraio 2012

**Oggetto:** Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di sistemi per la misurazione rapida della glicemia e dispositivi correlati da utilizzare in ambito ospedaliero occorrenti a AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre. Numero gara 605544. Aggiudicazione definitiva.

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge della Regione Liguria 03/04/2007 n. 14 che ha previsto l'istituzione di una Centrale Regionale di Acquisto, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 805 del 04/07/2008 con la quale la Centrale è stata costituita in forma di Consorzio tra gli Enti sanitari liguri, approvandone contestualmente lo statuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2602 e ss. C.C.;

Richiamata la deliberazione n. 63 del 2/11/2010 con cui si è provveduto all'indizione della gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura dei dispositivi di cui all'oggetto con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) ed alla contestuale approvazione del Capitolato speciale e delle norme di partecipazione;

Preso atto che in data 16/12/2010 si è riunito il seggio di gara, secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e per la verifica dei documenti richiesti;

Considerato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12,00 del 15/12/2010 sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

Ditta	Indirizzo	Estremi di arrivo documentazione di gara
Becton Dickinson Italia S.p.A.	V. Delle Azalee, 19 - 20090 Buccinasco MI	Prot. n. 1226 del 10/12/2010
Johnson & Johnson Medical S.p.A.	V. Del Mare, 56 - 00040 Pratica di Mare RM	Prot. n. 1233 del 13/12/2010
Roche Diagnostics S.p.A.	V.le G.B. Stucchi, 110 - 20052 Monza MB	Prot. n. 1234 del 13/12/2010
Svas Biosana S.r.l.	V. Trentola, 7 - 80049 Somma Vesuviana NA	Prot. n. 1243 del 13/12/2010
Benefis S.r.l.	V. Gualco, 14 - 16165 Genova	Prot. n. 1250 del 14/12/2010
A.Menarini Diagnostics S.r.l.	V. Sette Santi, 3 - 50131 Firenze	Prot. n. 1253 del 15/12/2010 Ore 9.00

e che l'offerta della Società Haemoclub International S.r.l., pervenuta oltre detto termine non è stata ammessa al prosieguo della procedura di gara;

Considerato che tutte le Ditte hanno presentato regolare documentazione per cui sono state ammesse, per i lotti a fianco di ciascuna indicati, alle successive fasi di gara, come da verbale della prima seduta pubblica del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa tenutasi in data 16/12/2010 (prot. n. 1256/2010), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ditta	Lotti per i quali la Ditta presenta offerta
Becton Dickinson Italia S.p.A.	3
Johnson & Johnson Medical S.p.A.	3
Roche Diagnostics S.p.A.	1, 2, 3, 4
Svas Biosana S.r.l.	1
Benefis S.r.l.	3
A.Menarini Diagnostics S.r.l.	1, 2

Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 24/1/2011 integrata con deliberazione n. 39 del 7/5/2011 con la quale si è provveduto, di concerto con l'Agenzia Sanitaria Regionale, a nominare la Commissione giudicatrice della gara;

Preso atto:

- del verbale della prima seduta della Commissione giudicatrice di valutazione della documentazione tecnica presentata dalle Ditte offerenti tenutasi in data 22/3/2011 (prot. n. 897/2011) in cui è stata effettuata la verifica della conformità della documentazione tecnica inviata alle prescrizioni del Disciplinare di gara;
- del verbale della seconda seduta della Commissione giudicatrice di valutazione della documentazione tecnica presentata dalle Ditte offerenti tenutasi in data 13/6/2011 (prot. n. 901/2011) in cui sono state effettuate le valutazioni di idoneità tecnica sui prodotti presentati e attribuiti i relativi punteggi qualitativi secondo i parametri previsti dal Disciplinare di gara;
- del verbale della terza seduta della Commissione giudicatrice tenutasi in data 16/01/2012 (prot. n. 59/2012) con il quale sono stati acquisiti agli atti i risultati delle prove laboratoristiche sui sistemi offerti, prove svolte nei mesi di ottobre-dicembre 2011 presso il Laboratorio di Analisi dell'Ospedale di Sestri Ponente e, per i restanti parametri qualitativi previsti, gli esiti della valutazione tecnica complessiva con l'attribuzione dei relativi punteggi;
- della conseguente graduatoria relativa ai punteggi qualitativi e alle esclusioni per i prodotti che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio richiesto:

Lotto n. 1	A Valore range ematocrito	B Assenza interferenze	C1 Precisione	C2 Accuratezza	C3 Correlazione lineare	D Sicurezza e igienicità nei operatori	E Conversione dei valori	Totale
A. Menarini	5	10	8	3	11	5	5	<b>47/60</b>

## Centrale Regionale di Acquisto

SVAS	0	10	10	0	11	5	5	<b>41/60</b>
Roche	5	5	8	0	11	5	5	<b>39/60</b>

Lotto n. 2	A Gestione interferenze	B1 Precisione	B2 Accuratezza	B3 Correlazione lineare	C Sicurezza e igienicità per operatori	D Conversione dei valori	Totale
A. Menarini	15	10	3	11	5	5	<b>49/60</b>
Roche	5	10	8	11	0	5	<b>39/60</b>

Lotto n. 3	A Variazione profondità penetrazione	B Praticità d'uso	C Presenza assenza lattice	D Sicurezza per operatori	Totale
Roche Diagnostics	20	5	5	10	<b>40</b>
Becton Dickinson	10	4	5	5	<b>24</b>
Benefis	20	4	5	5	<b>34</b>
Johnson & Johnson	0	5	5	10	<b>20 Non idoneo</b>

Lotto n. 4	A Praticità d'uso	B Presenza assenza lattice	C Sicurezza per operatori	D Sicurezza Per pazienti	Totale
Roche Diagnostics	5	5	15	15	<b>40</b>

- del verbale della seduta pubblica del Seggio di gara in data 25/1/2012 (prot. n. 124/2012) concernente l'apertura delle offerte economiche che ha evidenziato la seguente graduatoria provvisoria:

Lotto n. 1	Punteggio tecnico	Prezzo offerto	Punteggio relativo al prezzo	Punteggio totale
A.Menarini	<b>47/60</b>	0.135	<b>40,00</b>	<b>87.00</b>
SVAS	<b>41/60</b>	0.139	<b>38.85</b>	<b>79.85</b>
Roche	<b>39/60</b>	0.145	<b>37.24</b>	<b>76.24</b>

<b>Lotto n. 2</b>	<i>Punteggio tecnico</i>	<i>Prezzo offerto</i>	<i>Punteggio relativo al prezzo</i>	<i>Punteggio totale</i>	
A.Menarini	<b>49/60</b>	0.135	<b>40.00</b>	<b>89.00</b>	Offerta Anomala
Roche	<b>39/60</b>	0.150	<b>36.00</b>	<b>75.00</b>	
<b>Lotto n. 3</b>					
Roche Diagnostics	<b>40/40</b>	0.045	<b>60.00</b>	<b>100.00</b>	Offerta Anomala
Becton Dickinson	<b>24/40</b>	0.079	<b>34.18</b>	<b>58.18</b>	
Benefis	<b>34/40</b>	0.062	<b>43.55</b>	<b>77.55</b>	
<b>Lotto n. 4</b>					
Roche Diagnostics	<b>40/40</b>	0.045	<b>60.00</b>	<b>100.00</b>	Offerta Anomala

da cui emerge l'aggiudicazione provvisoria alle sotto indicate Ditte per i sottoelencati prodotti:

Lotto	Descrizione	Ditta aggiudicataria in via provvisoria	Prodotto offerto	Prezzo unitario offerto (euro IVA esclusa)
1	Sistema per la misurazione della glicemia capillare su soggetto adulto in ambito ospedaliero	A.Menarini Diagnostics srl	Stat Strip Glu Sensor + Stat Strip Xpress Meter	0,135
2	Sistema per la misurazione della glicemia capillare in età neonatale in ambito ospedaliero	A.Menarini Diagnostics srl	Stat Strip Glu Sensor + Stat Strip Xpress Meter	0,135
3	Dispositivo monouso per l'esecuzione del prelievo capillare per la misurazione della glicemia su soggetto adulto in ambito ospedaliero	Roche Diagnostics SpA	Accu-check Safe - T Pro Plus	0,045
4	Dispositivo monouso per l'esecuzione del prelievo capillare dal tallone nei neonati e prematuri	Roche Diagnostics SpA	Accu-check Safe - T Pro Plus	0,045

Dato atto che tutti i verbali citati vengono integralmente allegati in originale, alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte sostanziale;

Rilevato che gli Uffici della Centrale hanno provveduto ad acquisire nei tempi e secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di gara da tutti i concorrenti risultati primi e secondi classificati in ciascun lotto la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria ex art. 48 D. Lgs. n. 163/2006;



Considerato che la documentazione probatoria fornita dalle Società di cui al punto precedente risulta conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* della gara ed è pertanto idonea a confermare il possesso dei requisiti dichiarati;

Rilevato che gli Uffici della Centrale hanno provveduto ad acquisire, nei casi previsti dalla legge, le motivazioni di giustificazione ex artt. 86-88 D. Lgs n. 163/2006 e che la Centrale ha ritenuto le medesime idonee a confermare la validità delle offerte;

Rilevato che non esistono per la fornitura in oggetto convenzioni nazionali CONSIP, né prezzi massimi di riferimento ministeriale (ai sensi art. 1 comma 796 lettera v legge n. 296/2006) e ritenuto pertanto di poter sciogliere la riserva di non aggiudicazione del Disciplinare di gara in quanto non ricorrono nel caso di specie i presupposti richiesti dalla normativa vigente;

Ritenuto di procedere alla aggiudicazione definitiva della fornitura de qua, in conformità ai verbali allegati alla presente deliberazione;

Su proposta del Dirigente responsabile;

#### DELIBERA:

- ✓ Di approvare i verbali di gara allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto come in premessa specificato, relativi all'aggiudicazione della fornitura di sistemi per la misurazione rapida della glicemia e dispositivi correlati da utilizzare in ambito ospedaliero occorrenti a AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).
- ✓ Di procedere alla aggiudicazione definitiva della gara in oggetto secondo lo schema seguente:

Lotto	Descrizione	Ditta aggiudicataria in via provvisoria	Prodotto offerto	Prezzo unitario offerto (euro IVA esclusa)
1	Sistema per la misurazione della glicemia capillare su soggetto adulto in ambito ospedaliero	A.Menarini Diagnostics srl	Stat Strip Glu Sensor + Stat Strip Xpress Meter	0,135
2	Sistema per la misurazione della glicemia capillare in età neonatale in ambito ospedaliero	A.Menarini Diagnostics srl	Stat Strip Glu Sensor + Stat Strip Xpress Meter	0,135
3	Dispositivo monouso per l'esecuzione del prelievo capillare per la misurazione della glicemia su soggetto adulto in ambito ospedaliero	Roche Diagnostics SpA	Accu-check Safe - T Pro Plus	0,045
4	Dispositivo monouso per l'esecuzione del prelievo capillare dal tallone nei neonati e prematuri	Roche Diagnostics SpA	Accu-check Safe - T Pro Plus	0,045

- ✓ Di dare atto:
  - che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace successivamente all'espletamento dei controlli previsti dalla normativa antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, alla prestazione

della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006, alla presentazione del DURC;

- che il termine dilatorio per la stipulazione della convenzione, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (art. 79 comma 5-ter) è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data di trasmissione dell'informativa di aggiudicazione definitiva effettuata agli aggiudicatari e ai non aggiudicatari della gara;
- che la garanzia fideiussoria da prestare da parte dell'aggiudicatario è determinata nei seguenti importi:

Lotto	Ditta aggiudicataria	Prezzo Unitario offerto (euro, IVA esclusa)	Importo totale presunto della fornitura (euro, IVA esclusa)	Importo garanzia fideiussoria (euro)	Importo garanzia fideiussoria ridotto del 50% con certificazione di qualità CE (euro)
1	A.Menarini Diagnostics srl	0,135	€ 798.052,50	79.805,25	39.902,63
2	A.Menarini Diagnostics srl	0,135	€ 10.327,50	1.032,75	516,38
3	Roche Diagnostics SpA	0,045	€ 206.010,00	30.386,48	15.193,24
4	Roche Diagnostics SpA	0,045	€ 6.345,00	1.459,35	729,68

- ✓ Di dare atto che le convenzioni da sottoscrivere con le Ditte aggiudicatarie e gli ordinativi di fornitura da sottoscrivere a cura di ciascuna ASL, E.O. e I.R.C.C.S. saranno redatti in base allo schema tipo approvato con la deliberazione di indizione;
- ✓ Di provvedere alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;
- ✓ Di disporre la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge e alle condizioni individuate nella deliberazione n. 18 del 17/02/2011;
  - in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
  - per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
  - sui seguenti quotidiani e siti informatici:
    - La Discussione* nell'edizione nazionale
    - L'Osservatore Romano* nell'edizione nazionale
    - Corriere Mercantile* nell'edizione regionale
    - Il Giornale ed. Liguria* nell'edizione regionale
    - Servizio appalti Regione Liguria*
    - Sito Ministero Infrastrutture e dei Trasporti*
    - Sito web aziendale [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) - sezione "Gare".*
- ✓ Di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento quantificati in € 2.000,00 (IVA al 21% inclusa) sono compresi nello stanziamento della voce B7 del Bilancio Economico di Previsione anno 2012.

- ✓ Di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 7 (sette) pagine, oltre agli allegati.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giorgio SACCO)



Allegati: verbali di gara del 16/12/2010, 22/3/2011, 13/6/2011, 16/1/2012, 24/1/2012.

A  
RZ

**Procedura aperta per la fornitura di  
sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati (in ambito  
ospedaliero) occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per  
un periodo di anni tre - Lotti n. 4.**

**PRIMA SEDUTA PUBBLICA  
Verbale di verifica della documentazione amministrativa**

Il giorno sedici del mese di Dicembre dell'anno duemiladieci, alle ore 10,00 presso la Sala riunioni dell'Ospedale Villa Scassi (Palazzina Uffici Amministrativi), si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara della Centrale Regionale di Acquisto per la verifica della sussistenza della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla "Gara a procedura aperta per la fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati (in ambito ospedaliero) occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre - Lotti n. 4".

Sono presenti in rappresentanza della Centrale Regionale di Acquisto i Signori:

➤ RICCARDO	Dott. Zanella	Dirigente Responsabile	in qualità di Presidente
➤ PORCILE	Dott. Marco	Collaboratore Amm.vo Esperto	in qualità di Componente
➤ GAGLIOLO	Ivo	Coadiutore Amm.vo	in qualità di Segretario

In rappresentanza delle Ditte offerenti sono presenti i Signori:

-	Becton Dickinson Italia S.p.A.
-	Johnson & Johnson Medical S.p.A.
Maffei Alessandro e Bonora Elena	Roche Diagnostics S.p.A.
-	Svas Biosana S.r.l.
-	Benefis S.r.l.
Ghiorzo Federica	A.Menarini Diagnostics S.r.l.
-	Haemoclub International S.r.l.

muniti delle necessarie deleghe/procure (presentate in originale o in copia autenticata) allegare in copia quali parti integranti e sostanziali del presente verbale.

Il seggio di gara dà preliminarmente atto che:

- con deliberazioni n. 63 del 02/11/2010 si è provveduto ad indire la gara in argomento ed all'approvazione del Capitolato speciale e delle norme di partecipazione;
- il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 12,00 del giorno 15/12/2010;
- Il Disciplinare di gara fissava al giorno 16 Dicembre 2010 alle ore 10,00 l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa.



Il seggio di gara accerta che entro il termine delle ore 12,00 del 15/12/2010 sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

Ditta	Indirizzo	Estremi di arrivo documentazione di gara
Becton Dickinson Italia S.p.A.	V. Delle Azalee, 19 - 20090 Buccinasco MI	Prot. n. 1226 del 10/12/2010
Johnson & Johnson Medical S.p.A.	V. Del Mare, 56 - 00040 Pratica di Mare RM	Prot. n. 1233 del 13/12/2010
Roche Diagnostics S.p.A.	V.le G.B. Stucchi, 110 - 20052 Monza MB	Prot. n. 1234 del 13/12/2010
Svas Biosana S.r.l.	V. Trentola, 7 -80049 Somma Vesuviana NA	Prot. n. 1243 del 13/12/2010
Benefis S.r.l.	V. Gualco, 14 - 16165 Genova	Prot. n. 1250 del 14/12/2010
A.Menarini Diagnostics S.r.l.	V. Sette Santi, 3 - 50131 Firenze	Prot. n. 1253 del 15/12/2010 Ore 9.00

e che oltre detto termine è pervenuta l'offerta di:

Ditta	Indirizzo	Estremi di arrivo documentazione di gara
Haemoclub International S.r.l.	V. Monte Giberto, 29 - 00138 Roma	Prot. n. 1255 del 15/12/2010 Ore 13.00

Il seggio di gara prende atto che l'offerta della ditta Haemoclub International S.r.l. non può essere ammessa al prosieguo della procedura di gara in quanto pervenuta oltre il termine tassativo previsto dal Disciplinare di gara.

Il seggio di gara, dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità dei plichi pervenuti, procede ad aprire quelli pervenuti entro le ore 12.00 del 15 dicembre 2010 che, come prescritto dalle norme di partecipazione, risultano contenere le quattro buste sigillate contenenti la documentazione amministrativa (**Busta 1**), l'offerta economica (**Busta 2**), la documentazione tecnica (**Busta 3**) e la campionatura (**Busta 4**).

Viene altresì accertato che per ciascuna Ditta sono state predisposte apposite schede, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, riportanti un elenco della documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare di gara (busta n. 1).

Si procederà al raffronto di tali schede con la documentazione presentata dalle Ditte.

Sulle schede predisposte la Centrale appunterà negli appositi spazi la conformità della documentazione inviata a quella richiesta dal Disciplinare di gara.

Il seggio di gara procede pertanto all'apertura delle sole buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare la sussistenza della documentazione presentata dalle Ditte partecipanti, in accordo alle prescrizioni del Disciplinare di gara.

Dalla verifica della sussistenza della documentazione amministrativa è emerso quanto segue:

Ditta	Documentazione amministrativa	Lotti per i quali la Ditta presenta offerta	Ammissione fase di valutazione di idoneità tecnica
Becton Dickinson Italia S.p.A.	Idonea	3	Ammessa
Johnson & Johnson Medical S.p.A.	Idonea	3	Ammessa
Roche Diagnostics S.p.A.	Idonea	1, 2, 3, 4	Ammessa
Svas Biosana S.r.l.	Idonea	1	Ammessa
Benefis S.r.l.	Idonea	3	Ammessa
A.Menarini Diagnostics S.r.l.	Idonea	1, 2	Ammessa

le suddette Ditte concorrenti hanno presentato la documentazione richiesta.



## Centrale Regionale di Acquisto

La verifica della sussistenza della documentazione amministrativa ha stabilito che la stessa è stata **regolarmente** confermata per tutti i sopraindicati offerenti che risultano pertanto tutti ammessi al prosieguo della gara.

Ai sensi dell'art. 48 - comma 1 - del D.Lgs 163/2006 si procede quindi al sorteggio fra le Ditte risultate ammesse al prosieguo della gara.

Il seggio di gara invita i rappresentanti delle Ditte ad individuare tra loro la persona che dovrà effettuare il sorteggio e la scelta cade sul Sig. Maffei Alessandro che sorteggia la Ditta Benefis S.r.l.

Il seggio di gara si impegna a comunicare ufficialmente alla Ditta estratta che, entro il termine previsto dal Disciplinare di gara (10 gg.: scadenza del termine ore 24 del 27 Dicembre p.v.), dovrà produrre, pena esclusione, la documentazione comprovante la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dalla Ditta, attraverso la presentazione dell'estratto dei bilanci dal quale si evinca il fatturato degli esercizi 2007-2008-2009.

Il seggio di gara rileva la Ditta Benefis S.r.l. ha già prodotto all'interno della documentazione amministrativa la documentazione probatoria relativa alle principali forniture eseguite negli ultimi 3 anni (2007-2008-2009), secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara.


Le buste contenenti la documentazione tecnica saranno successivamente esaminate dalla Commissione giudicatrice che provvederà alla verifica, in seduta non pubblica, della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ai fini dell'idoneità delle Ditte al prosieguo delle fasi di gara.

Le buste contenenti le offerte economiche vengono raccolte in un unico plico opportunamente chiuso e vistato sui lembi di chiusura dalla Centrale e dai rappresentanti delle Ditte. Detto plico sarà riposto per la conservazione in armadio con serratura collocato in luogo chiuso.

La seduta è tolta alle ore 10,50.

Letto, confermato e sottoscritto.


Presidente:  
ZANELLA                      Dott. Riccardo



Componente:  
PORCILE                      Dott. Marco



Segretario:  
GAGLIOLO                      Ivo





**Procedura aperta per la fornitura di  
sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati (in ambito  
ospedaliero) occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per  
un periodo di anni tre - Lotti n. 4.**

**Verifica documentazione amministrativa**

DITTA: Becton Dickinson

- a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (All. F1).

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive.

OK

- b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto del Lotto.

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

OK

- c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

NON RICHIESTA  
CERTIFICAZIONE

OK

Lotto	Importo della garanzia espresso in Euro 2% (punto b)	Importo della garanzia espresso in Euro 1% (punto c)
<del>1</del>	€ 17.734,50	€ 8.867,25
<del>2</del>	€ 229,50	€ 114,75
3	€ 7.324,80	€ 3.662,40
4	€ 846,00	€ 423,00

Lotto 3

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

## Centrale Regionale di Acquisto

- d) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).

OK

- e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto	Codice CIG	Importo contributo
<del>1</del>	05614570F9	€ 40,00
<del>2</del>	0561461445	€ 00,00
3	0561465791	€ 20,00
<del>4</del>	0561465791	€ 00,00

OK

- ⇒ nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- ⇒ nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- ⇒ solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

- f) Dichiarazione (Allegato E1), debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale.

OK

- g) Dichiarazione (Allegato E2) di aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico di fornitura (Allegato sez. A), del Capitolato Speciale (Allegato sez. B), della Convenzione di fornitura tra la Centrale di Acquisto e l'aggiudicatario (Allegato sez. C) e dei relativi allegati - scaricabili dal sito internet [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) - accettando incondizionatamente gli stessi in ogni loro parte.

OK

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per accettazione:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;

## Centrale Regionale di Acquisto

- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.


h) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta.

OK lotti 3

i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.

OK

**La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) sarà motivo di esclusione dalla gara. Per quanto riguarda il punto e), oltre alla mancanza di tale attestazione, anche l'inesattezza dell'importo versato e/o del CIG indicato è motivo di esclusione dalla gara.**



**DITTA:** Johnson & Johnson Medical

- a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (All. F1).

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive.

OK

- b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto del Lotto.

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

OK

- c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

OK

Lotto	Importo della garanzia espresso in Euro 2% (punto b)	Importo della garanzia espresso in Euro 1% (punto c)
<del>1</del>	€ 17.734,50	€ 8.867,25
<del>2</del>	€ 229,50	€ 114,75
3	€ 7.324,80	€ 3.662,40
4	€ 846,00	€ 423,00

- d) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).

OK

Handwritten signatures and initials, including a large 'JA' and a signature that appears to be 'JG'.

## Centrale Regionale di Acquisto

- e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto	Codice CIG	Importo contributo
<del>1</del>	05614570F9	€ 40,00
<del>2</del>	0561461445	€ 00,00
3	0561465791	€ 20,00
<del>4</del>	0561465791	€ 00,00

OK

- ⇒ nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- ⇒ nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- ⇒ solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

- f) Dichiarazione (Allegato E1), debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale.

OK

- g) Dichiarazione (Allegato E2) di aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico di fornitura (Allegato sez. A), del Capitolato Speciale (Allegato sez. B), della Convenzione di fornitura tra la Centrale di Acquisto e l'aggiudicatario (Allegato sez. C) e dei relativi allegati - scaricabili dal sito internet [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) - accettando incondizionatamente gli stessi in ogni loro parte.

OK

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per accettazione:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.



- h) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta.

OK



Centrale Regionale di Acquisto

---

~~~~~

i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.

~~~~~

OK

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) sarà motivo di esclusione dalla gara. Per quanto riguarda il punto e), oltre alla mancanza di tale attestazione, anche l'inesattezza dell'importo versato e/o del CIG indicato è motivo di esclusione dalla gara.




**DITTA:** Roche Diagnostics S.p.A.

- a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (All. F1).

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive.

OK

- b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto del Lotto.

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

OK

- c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

OK

Lotto	Importo della garanzia espresso in Euro 2% (punto b)	Importo della garanzia espresso in Euro 1% (punto c)
1	€ 17.734,50	€ 8.867,25
2	€ 229,50	€ 114,75
3	€ 7.324,80	€ 3.662,40
4	€ 846,00	€ 423,00

- d) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).

OK

## Centrale Regionale di Acquisto

- e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto	Codice CIG	Importo contributo
1	05614570F9	€ 40,00
2	0561461445	€ 00,00
3	0561465791	€ 20,00
4	0561465791	€ 00,00

OK

- ⇒ nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- ⇒ nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- ⇒ solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

- f) Dichiarazione (Allegato E1), debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale.

OK

- g) Dichiarazione (Allegato E2) di aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico di fornitura (Allegato sez. A), del Capitolato Speciale (Allegato sez. B), della Convenzione di fornitura tra la Centrale di Acquisto e l'aggiudicatario (Allegato sez. C) e dei relativi allegati - scaricabili dal sito internet [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) - accettando incondizionatamente gli stessi in ogni loro parte.

OK

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per accettazione:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.

OK

- h) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta.

OK



OK

Centrale Regionale di Acquisto

~~~~~  
i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.

OK

~~~~~  
**La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) sarà motivo di esclusione dalla gara. Per quanto riguarda il punto e), oltre alla mancanza di tale attestazione, anche l'inesattezza dell'importo versato e/o del CIG indicato è motivo di esclusione dalla gara.**

DITTA: Svas Biosana

- a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (All. F1).

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive.

OK



- b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto del Lotto.

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

OK



- c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

OK

Lotto	Importo della garanzia espresso in Euro 2% (punto b)	Importo della garanzia espresso in Euro 1% (punto c)
1	€ 17.734,50	€ 8.867,25
<del>2</del>	€ 229,50	€ 114,75
<del>3</del>	€ 7.324,80	€ 3.662,40
<del>4</del>	€ 846,00	€ 423,00



- d) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).

OK



## Centrale Regionale di Acquisto

- e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto	Codice CIG	Importo contributo
1	05614570F9	€ 40,00
2	0561461445	€ 00,00
3	0561465791	€ 20,00
4	0561465791	€ 00,00

OK

- ⇒ nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- ⇒ nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- ⇒ solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

- f) Dichiarazione (Allegato E1), debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale.


OK

- g) Dichiarazione (Allegato E2) di aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico di fornitura (Allegato sez. A), del Capitolato Speciale (Allegato sez. B), della Convenzione di fornitura tra la Centrale di Acquisto e l'aggiudicatario (Allegato sez. C) e dei relativi allegati - scaricabili dal sito internet [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) - accettando incondizionatamente gli stessi in ogni loro parte.

OK

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per accettazione:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.



- h) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta.

OK



Centrale Regionale di Acquisto

---

~~~~~

i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.

OK

---

~~~~~

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) sarà motivo di esclusione dalla gara. Per quanto riguarda il punto e), oltre alla mancanza di tale attestazione, anche l'inesattezza dell'importo versato e/o del CIG indicato è motivo di esclusione dalla gara.



DITTA: Benefis S.r.l.

- a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (All. F1).

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive.

OK Lotto 3

- b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto del Lotto.

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

OK

- c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

Lotto	Importo della garanzia espresso in Euro 2% (punto b)	Importo della garanzia espresso in Euro 1% (punto c)
1	€ 17.734,50	€ 8.867,25
2	€ 229,50	€ 114,75
3	€ 7.324,80	€ 3.662,40
4	€ 846,00	€ 423,00

OK

- d) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).

OK

MP 3/2

## Centrale Regionale di Acquisto

- e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto	Codice CIG	Importo contributo
<del>1</del>	05614570F9	€ 40,00
<del>2</del>	0561461445	€ 00,00
<del>3</del>	0561465791	€ 20,00
<del>4</del>	0561465791	€ 00,00

OK

- ⇒ nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- ⇒ nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- ⇒ solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

- f) Dichiarazione (Allegato E1), debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale.

OK

- g) Dichiarazione (Allegato E2) di aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico di fornitura (Allegato sez. A), del Capitolato Speciale (Allegato sez. B), della Convenzione di fornitura tra la Centrale di Acquisto e l'aggiudicatario (Allegato sez. C) e dei relativi allegati - scaricabili dal sito internet [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) - accettando incondizionatamente gli stessi in ogni loro parte.

OK

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per accettazione:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.

OK

- h) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta.

OK

OK

Centrale Regionale di Acquisto

i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.

OK

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) sarà motivo di esclusione dalla gara. Per quanto riguarda il punto e), oltre alla mancanza di tale attestazione, anche l'inesattezza dell'importo versato e/o del CIG indicato è motivo di esclusione dalla gara.

**DITTA:** A.Menarini Diagnostics S.r.l.

- a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (All. F1).

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive.

lotto 1,2

OK

- b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto del Lotto.

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

OK

- c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

Lotto	Importo della garanzia espresso in Euro 2% (punto b)	Importo della garanzia espresso in Euro 1% (punto c)
1	€ 17.734,50	€ 8.867,25
2	€ 229,50	€ 114,75
3	€ 7.324,80	€ 3.662,40
4	€ 846,00	€ 423,00

OK

- d) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).

OK

## Centrale Regionale di Acquisto

- e) Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto	Codice CIG	Importo contributo
1	05614570F9	€ 40,00
2	0561461445	€ 00,00
3	0561465791	€ 20,00
4	0561465791	€ 00,00

OK

- ⇒ nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- ⇒ nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- ⇒ solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

- f) Dichiarazione (Allegato E1), debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale.

OK

- g) Dichiarazione (Allegato E2) di aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico di fornitura (Allegato sez. A), del Capitolato Speciale (Allegato sez. B), della Convenzione di fornitura tra la Centrale di Acquisto e l'aggiudicatario (Allegato sez. C) e dei relativi allegati - scaricabili dal sito internet [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) - accettando incondizionatamente gli stessi in ogni loro parte.

OK

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per accettazione:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.

- h) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta.

OK




## Centrale Regionale di Acquisto

~~~~~

i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.

~~~~~




La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) sarà motivo di esclusione dalla gara. Per quanto riguarda il punto e), oltre alla mancanza di tale attestazione, anche l'inesattezza dell'importo versato e/o del CIG indicato è motivo di esclusione dalla gara.





Centrale Regionale di Acquisto

Dirigente responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA  
Funzionario referente: Dott. Marco PORCILE



**Procedura aperta per la fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati (in ambito ospedaliero) occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre - Lotti n. 4.**

**Seduta della Commissione Giudicatrice del 22 marzo 2011**

**Verbale di verifica della documentazione tecnica presentata dalle Ditte**

Il giorno 22/03/2011, alle ore 14,30 presso la sala riunioni dell'Ospedale Villa Scassi (palazzina uffici amministrativi) si è riunita la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto, nominata con Deliberazione n. 10 del 24/01/2011 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per l'avvio della verifica della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti, ai fini dell'assegnazione dei punteggi relativi al parametro qualità.

Sono presenti i Signori:

➤ <b>CORSI</b>	Dott. Andrea	U.O.C. Diabetologia - Ospedale "La Colletta" - Asl3 Genovese	Presidente
➤ <b>BOTTARO</b>	Dott. Luigi	Dipartimento Patologia Clinica - Ospedale P.A. Micone - Asl3 Genovese	Componente
➤ <b>MONACHESI</b>	Dott. Mario	U.O.S. Endocrinologia, Medicina Interna - Ospedale San Paolo - Asl2 Savonese	Componente

E' presente altresì il Dott. Riccardo Zanella, dirigente della Centrale, che svolge le funzioni di segretario della Commissione, assistito dal Dott. Marco Porcile, collaboratore amministrativo esperto e dal Sig. Ivo Gagliolo, coadiutore amministrativo della Centrale.

La seduta non è pubblica.

La Commissione aggiudicatrice prende preliminarmente atto del verbale della prima seduta di gara del 16/12/2010, in cui è stata verificata l'idoneità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte offerenti e che a seguito di tale verifica sono state ammesse al prosieguo della procedura le seguenti Ditte:

Ditta	Documentazione amministrativa	Lotti per i quali la Ditta ha presentato offerta	Ammissione alla fase di valutazione di idoneità tecnica
Becton Dickinson Italia S.p.A.	Idonea	3	Ammessa
Johnson & Johnson Medical S.p.A.	Idonea	3	Ammessa
Roche Diagnostics S.p.A.	Idonea	1, 2, 3, 4	Ammessa
Svas Biosana S.r.l.	Idonea	1	Ammessa
Benefis S.r.l.	Idonea	3	Ammessa
A.Menarini Diagnostics S.r.l.	Idonea	1, 2	Ammessa

La Commissione prende altresì atto che la ditta Benefis S.r.l. sorteggiata ai sensi dell'art. 48, c. 1 del D.Lgs 163/2006, informata con nota prot. n. 1257 del 16/12/2010 dell'esito del sorteggio, ha prodotto con nota acquista agli atti con prot. n. 1284 del 22/12/2010 la documentazione richiesta, pena esclusione dalla gara e cioè:

## Centrale Regionale di Acquisto

- estratto dei bilanci dal quale si evinca il fatturato degli esercizi 2007-2008-2009;
- documentazione probatoria relativa alle principali forniture eseguite negli ultimi tre anni 2007-2008-2009 (già presentata dalla Ditta in allegato alla documentazione amministrativa inserita nella busta n.1).

La Commissione prende atto che il Disciplinare di gara e i relativi allegati prevedono che la procedura verrà esperita con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponderando perciò l'elemento prezzo con i parametri di qualità definiti in sede di capitolato tecnico e che ai parametri di qualità sono assegnati:

- ✓ max 60 punti per i lotti n. 1 e n. 2;
- ✓ max 40 punti per i lotti n. 3 e n. 4.

Items di valutazioni e punteggi erano stati integralmente definiti in sede di bando di gara, ai sensi dell'art. 83 c. 4 D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art.1 comma 1, lett. u D.Lgs n. 152/2008.

In considerazione del positivo assolvimento degli adempimenti amministrativi, prima di passare all'esame della documentazione tecnica, la Commissione prende atto che nel Capitolato tecnico di gara (Sez. A - Allegato 1) è inoltre previsto:

1. che sia individuato un Laboratorio di Analisi di Struttura del S.S.N. preferibilmente operante con procedure certificate per l'effettuazione dei test laboratoristici;
2. che "della Commissione giudicatrice faranno parte uno o più laboratoristi incaricati dello svolgimento dei test" necessari alla valutazione di precisione e accuratezza cui sottoporre i prodotti offerti dalla Ditta.

A tal fine, la Commissione individua:

- 1) il Laboratorio analisi dell'Ospedale P.A. Micone di Sestri Ponente (Asl 3 "Genovese");
- 2) quali possibili ulteriori componenti, i seguenti due nominativi, entrambi in servizio presso il Laboratorio di Analisi del Dipartimento di Patologia Clinica della Asl3 "Genovese":
  - Dott. Paolo Pedrazzi,
  - Sig.ra Carmen Giacomelli (C.P.S.E.).

Tali nominativi saranno proposti alla Agenzia sanitaria regionale e alla Centrale di Acquisto per i necessari adempimenti formali.

La Commissione avvia quindi il lavoro di verifica e stabilisce di effettuare la valutazione della documentazione tecnica procedendo per singoli lotti, verificando le offerte tecniche pervenute secondo lo schema seguente:

Lotti per cui la Ditta presenta offerta	Ditta					
	Roche Diagnostics S.p.A	Becton Dickinson Italia S.p.A.	Johnson & Johnson Medical S.p.A.	Svas Biosana S.r.l.	Benefis S.r.l.	A.Menarini Diagnostics S.r.l.
n. 1	x			x		x
n. 2	x					x
n. 3	x	x	x		x	
n. 4	x					

La Commissione prende atto che gli Uffici della Centrale, sulla base del Capitolato tecnico, hanno predisposto apposite schede ove appuntare i dati essenziali risultanti dall'esame della documentazione e i relativi punteggi.

La Commissione, procede ad accertare che in tutti i plichi sia presente la documentazione tecnica richiesta nel Disciplinare di gara e cioè:

---

Centrale Regionale di Acquisto

- scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della ditta;
- dichiarazione della presenza delle caratteristiche tecniche richieste ai prodotti offerti (attraverso la compilazione dell'Allegato F4), sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato;
- catalogo illustrato, senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, depliant, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così come individuate nelle sezioni "A" e "B", in base alle quali sarà attribuito il punteggio di qualità;
- eventuale copia di pubblicazioni scientifiche ritenuti utili a facilitare la valutazione dei parametri di qualità dei prodotti offerti,
- dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;
- dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore.


La Commissione si riserva ogni ulteriore valutazione una volta integrata la composizione della Commissione stessa con i componenti tecnici proposti.

Alle ore 17,05 la Commissione sospende l'esame della documentazione, rassegna gli atti esaminati al dirigente responsabile affinché sia riposta per la conservazione, insieme alle campionature in luogo chiuso e decide di aggiornare i lavori a data da destinarsi.

La seduta è tolta alle ore 17,10.

Il segretario della Commissione giudicatrice

Dott. Riccardo ZANELLA



---

**Procedura aperta per la fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati (in ambito ospedaliero) occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre - Lotti n. 4.**

**Seduta della Commissione Giudicatrice del 13 giugno 2011**

**Verbale di verifica della documentazione tecnica presentata dalle Ditte offerenti**

Il giorno 13/06/2011, alle ore 13,30 presso la sala riunioni dell'Ospedale Villa Scassi (palazzina uffici amministrativi) si è riunita la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, nominata con Deliberazione n. 10 del 24/01/2011 e successivamente integrata con Deliberazione n. 39 del 17/05/2001, per la verifica della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti, ai fini dell'assegnazione dei punteggi relativi al parametro qualità.

Sono presenti i Signori:

➤ <b>DE MICHELI</b>	Dott. Alberto	U.O. Diabetologia A.O.U. San Martino - Genova	Presidente
➤ <b>BOTTARO</b>	Dott. Luigi C.	Dipartimento Patologia Clinica - Ospedale P.A. Micone - Asl3 Genovese	Componente
➤ <b>MONACHESI</b>	Dott. Mario	U.O.S. Endocrinologia, Medicina Interna - Ospedale San Paolo - Asl2 Savonese	Componente
➤ <b>PEDRAZZI</b>	Dott. Paolo	Laboratorio Patologia clinica - Ospedale P.A. Micone - Asl3 Genovese	Componente
➤ <b>GIACOPELLI</b>	Sig.ra Carmen	Laboratorio Patologia clinica - Ospedale P.A. Micone - Asl3 Genovese	Componente

E' presente altresì il Dott. Riccardo Zanella, dirigente della Centrale, che svolge le funzioni di segretario della Commissione, assistito dal Dott. Marco Porcile, collaboratore amministrativo esperto e dal Sig. Ivo Gagliolo, coadiutore amministrativo della Centrale.

La seduta non è pubblica.

La Commissione aggiudicatrice prende preliminarmente atto della Deliberazione n. 39 del 17/05/2001 con cui, a seguito delle dimissioni del Dott. Corsi, il Dott. De Micheli è stato nominato componente della Commissione, in qualità di Presidente.

La stessa deliberazione, inoltre, ha integrato la composizione della Commissione con la nomina di due ulteriori componenti, il Dott. Paolo Pedrazzi e la Sig.ra Carmen Giacopelli, del cui apporto la Commissione si avvarrà anche per l'effettuazione delle prove di laboratorio previste dal Capitolato di gara.

La Commissione prende in considerazione la documentazione tecnica presentata dagli offerenti, la cui completezza era stata esaminata in data 22/03/2011.

*ST*



A tale riguardo la Commissione fa proprie e conferma le valutazioni già espresse in quella data.

La Commissione avvia pertanto l'esame della documentazione tecnica presentata per ogni lotto da ciascun concorrente, al fine di attribuire il punteggio qualitativo; si effettuerà prima la verifica sulle offerte del lotto 1, successivamente quella sulle offerte del lotto 2 e così di seguito.

Prima di procedere all'esame delle caratteristiche soggette a valutazione di qualità, sarà verificata la presenza delle "caratteristiche tecniche indispensabili pena esclusione".

In mancanza di tali caratteristiche non si procederà alla valutazione degli item di punteggio.

Su ogni scheda all'uopo predisposta per ciascuna ditta (in allegato al presente verbale) verrà appuntato, contestualmente all'esame della documentazione:

- il dato qualitativo del prodotto offerto in corrispondenza di ogni item previsto per ciascun parametro;
- il punteggio attribuito a ciascun item.

Verrà determinato, alla fine della valutazione tecnica della documentazione di ogni lotto, il punteggio ottenuto da ciascun offerente mediante la sommatoria dei punti attribuiti per singolo item qualitativo.

Dall'esame della documentazione pervenuta, risulta che tutte le offerte presentate per i lotti n. 1, 2, 3 e 4 presentano i requisiti minimi obbligatori, previsti pena esclusione.

Le valutazioni effettuate lotto per lotto sono quelle inserite nelle schede allegate.

A compendio ed integrazione delle valutazioni, la Commissione rileva che, con riferimento al lotto n. 1, per la valutazione dell'item "Gestione delle interferenze dovute a variazione dei valori di ematocrito", in caso di discordanza tra dati dichiarati sul Mod. F4 e sulla documentazione tecnica allegata (schede tecniche, foglietto illustrativo, Test Reports), si è tenuto conto e si è valutato il dato esposto nei documenti tecnici ufficiali del produttore, ritenuti maggiormente attendibili per la strutturazione e la completezza dell'informazione.

Con riferimento ai lotti n. 1 e n. 2 ed alla valutazione dell'item "Gestione delle interferenze dovute a maltosio, galattosio, bilirubina", la Commissione rileva che i glucometri presentati dalla Ditta Roche Diagnostics, pur rispondendo a tutti i requisiti richiesti, potrebbero essere soggetti ad interferenza dovuta alla presenza di maltosio e galattosio, configurando la possibilità che in soggetti con particolari situazioni cliniche (sottoposti ad esempio a dialisi peritoneale) i valori di glicemia rilevati potrebbero risultare alterati, con conseguenti difficoltà di garantire al paziente i più appropriati trattamenti, soprattutto in determinate situazioni di emergenza.

La Commissione si riserva pertanto di prevedere eventuali specifici iter procedurali per la prevenzione e la gestione dei connessi rischi clinici da comunicare alle singole aziende sanitarie.

Le valutazioni effettuate lotto per lotto ed i relativi punteggi sono riportati nelle schede allegate al presente verbale.

Restano da effettuare le valutazioni legate al parametro "Precisione e accuratezza delle determinazioni attraverso test eseguiti dal Laboratorio di Analisi", per le quali la Commissione utilizzerà le strumentazioni presenti nel Laboratorio di Analisi dell'Ospedale P.A. Micone di Sestri Ponente - Genova (Asl3 "Genovese").

Al fine di procedere con l'effettuazione dei suddetti test di laboratorio, la Commissione dà mandato al personale della Centrale affinché richieda alle Ditte che hanno presentato offerta per i lotti n.1 e n. 2 l'invio delle confezioni di sieri di controllo in quantità e tipologie sufficienti a svolgere i test descritti nell'Allegato 1 del Capitolato tecnico.

Tale materiale dovrà essere inviato al Laboratorio analisi dell'Ospedale P.A. Micone di Sestri Ponente (Asl 3 "Genovese") entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta.

Centrale Regionale di Acquisto

Alle ore 15,20 la Commissione termina l'esame della documentazione e decide di aggiornare i lavori a data da destinarsi per l'avvio delle valutazioni relative alle prove di laboratorio.


La seduta è tolta alle ore 15,20.

Per la Centrale Regionale di Acquisto

Dott. Riccardo Zanella

Dott. Marco Porcile

Sig. Ivo Gagliolo



.....  
.....  
.....



**Ditta: A. Menarini Diagnostics S.r.l**

**Lotto 1:** Sistema per la misurazione della glicemia capillare su **sogetto adulto** in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive):

Nome prodotto offerto: STAT STRIP GLU SENSOR + STATSTRIP EXPRESS METER

Requisiti minimi (obbligatori, pena esclusione):

Presentazione di una dichiarazione documentata di presenza/assenza di eventuali interferenze nella determinazione della glicemia (come da allegato F4).	<input checked="" type="checkbox"/> NO	idoneo
Volume del campione necessario alla determinazione inferiore o uguale a <b>10</b> microlitri	<input checked="" type="checkbox"/> NO	idoneo
Tempo di lettura del test inferiore o uguale a 15 secondi.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	idoneo
Dotazione di un sistema di allarme visivo nel caso di campione insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> NO	idoneo
Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra <b>20 e 500</b> mg/dl.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	idoneo
Presenza di un segnale visivo nel caso di <i>out of range</i> di lettura.	<input checked="" type="checkbox"/> NO	idoneo
Presenza di un sistema di calibrazione automatica o attraverso "chip code".	<input checked="" type="checkbox"/> NO	idoneo
Presenza di un segnale visivo di eventuale incompatibilità della striscia reattiva inserita o di errata procedura di calibrazione, nel caso di calibrazione attraverso "sistemi di calibrazione esterna".	<input checked="" type="checkbox"/> NO	idoneo

Elementi soggetti a valutazione e relativa attribuzione di punteggio:

	Elementi soggetti a valutazione	Parametro da valutare	Punteggio	Punteggio attribuito
a	Gestione delle interferenze dovute a variazione dei valori di ematocrito: ampiezza del range di ematocrito compreso almeno da 30 a 55 %.	Valore range ematocrito	Max 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>Range di ematocrito più ampio (rispetto al range 30-55%) = 5 punti</li> <li>Range uguale o minore = 0 punti</li> </ul>	Range 20% - 65% (SCHEDE TECNICHE) 5 punti
b	Gestione delle interferenze dovute a maltosio, galattosio, bilirubina	Assenza di interferenza dai parametri indicati.	Da 0 a 10 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>assenza interferenza da maltosio,</li> </ul>	

	(in base a quanto dichiarato all'allegato F4)		galattosio e bilirubina = 10 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assenza interferenza solo da maltosio e galattosio = 5 punti</li> <li>▪ assenza interferenza solo da bilirubina = 5 punti</li> <li>▪ nessuna assenza = 0 punti</li> </ul>	10 punti
c	Precisione e accuratezza delle determinazioni attraverso test eseguiti dal Laboratorio di Analisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Precisione</li> <li>▪ Accuratezza</li> <li>▪ Correlazione lineare fra determinazione glucometro su prelievo capillare e determinazione laboratorio su campione di sangue venoso (vedi Allegato 1 - specifiche su effettuazione test di laboratorio)</li> </ul>	Da 0 a 35 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Precisione (max 12 punti)</li> <li>▪ Accuratezza (max 12 punti)</li> <li>▪ Correlazione lineare (max 11 punti)</li> </ul>	
d	Sicurezza e igienicità per gli operatori	Presenza espulsione automatica della striscia reattiva, al fine di impedire il contatto accidentale con il sangue del paziente	Da 0 a 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ si = 5 punti, no = 0 punti</li> </ul>	5 punti
e	Correlazione tra sangue capillare venoso/arterioso o conversione automatica del valore, secondo gli standard internazionali	Presenza valori di conversione (automatici o mediante tabella di correlazione)	Da 0 a 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ presenza conversione automatica = 5 punti</li> <li>▪ presenza tabella di correlazione = 2 punti</li> <li>▪ assenza tabella e assenza conversione automatica = 0 punti</li> </ul>	5 punti
			<b>Totale punti max 60</b>	

Soglia minima punteggio qualità: almeno 36 punti sui 60 totali.

**Ditta: Svas Biosana S.p.A.**

**Lotto 1:** Sistema per la misurazione della glicemia capillare su **soggetto adulto** in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive):

Nome prodotto offerto: GLUCOLAB AUTO-LOADING

Requisiti minimi (obbligatori, pena esclusione):

Presentazione di una dichiarazione documentata di presenza/assenza di eventuali interferenze nella determinazione della glicemia (come da allegato F4).	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Volume del campione necessario alla determinazione inferiore o uguale a <b>10</b> microlitri	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Tempo di lettura del test inferiore o uguale a 15 secondi.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Dotazione di un sistema di allarme visivo nel caso di campione insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra <b>20 e 500</b> mg/dl.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Presenza di un segnale visivo nel caso di <i>out of range</i> di lettura.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Presenza di un sistema di calibrazione automatica o attraverso "chip code".	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Presenza di un segnale visivo di eventuale incompatibilità della striscia reattiva inserita o di errata procedura di calibrazione, nel caso di calibrazione attraverso "sistemi di calibrazione esterna".	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo

Elementi soggetti a valutazione e relativa attribuzione di punteggio:

	Elementi soggetti a valutazione	Parametro da valutare	Punteggio	Punteggio attribuito
a	Gestione delle interferenze dovute a variazione dei valori di ematocrito: ampiezza del range di ematocrito compreso almeno da 30 a 55 %.	Valore range ematocrito	Max 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>Range di ematocrito più ampio (rispetto al range 30-55%) = 5 punti</li> <li>Range uguale o minore = 0 punti</li> </ul>	30-55%. (TEST REPORT FOR GLUCOLAB) 0 punti
b	Gestione delle interferenze dovute a maltosio, galattosio, bilirubina (in base a quanto dichiarato all'allegato F4)	Assenza di interferenza dai parametri indicati.	Da 0 a 10 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>assenza interferenza da maltosio, galattosio e bilirubina = 10 punti</li> <li>assenza</li> </ul>	10 punti*

## Centrale Regionale di Acquisto

	*L'ENZIMA UTILIZZATO PER LE DETERMINAZIONI (GLUCOSIO OSSIDASI) ESCLUDE IL RISCHIO DI INTERFERENZE DA MALTOZIO E GALATTOSIO		interferenza solo da maltosio e galattosio = 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assenza interferenza solo da bilirubina = 5 punti</li> <li>▪ nessuna assenza = 0 punti</li> </ul>	
c	Precisione e accuratezza delle determinazioni attraverso test eseguiti dal Laboratorio di Analisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Precisione</li> <li>▪ Accuratezza</li> <li>▪ Correlazione lineare fra determinazione glucometro su prelievo capillare e determinazione laboratorio su campione di sangue venoso (vedi Allegato 1 - specifiche su effettuazione test di laboratorio)</li> </ul>	Da 0 a 35 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Precisione (max 12 punti)</li> <li>▪ Accuratezza (max 12 punti)</li> <li>▪ Correlazione lineare (max 11 punti)</li> </ul>	
d	Sicurezza e igienicità per gli operatori	Presenza espulsione automatica della striscia reattiva, al fine di impedire il contatto accidentale con il sangue del paziente	Da 0 a 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ si = 5 punti; no = 0 punti</li> </ul>	5 punti
e	Correlazione tra sangue capillare venoso/arterioso o conversione automatica del valore, secondo gli standard internazionali	Presenza valori di conversione (automatici o mediante tabella di correlazione)	Da 0 a 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ presenza conversione automatica = 5 punti</li> <li>▪ presenza tabella di correlazione = 2 punti</li> <li>▪ assenza tabella e assenza conversione automatica = 0 punti</li> </ul>	5 punti
			<b>Totale punti max 60</b>	

Soglia minima punteggio qualità: almeno 36 punti sui 60 totali.

**Ditta: Roche Diagnostics S.p.A.**

**Lotto 1:** Sistema per la misurazione della glicemia capillare su **soggetto adulto** in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive)

Nome prodotto offerto: ... ACCU-CHEK COMPACT PLUS .....

Requisiti minimi (obbligatori, pena esclusione):

Presentazione di una dichiarazione documentata di presenza/assenza di eventuali interferenze nella determinazione della glicemia (come da allegato F4).	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Volume del campione necessario alla determinazione inferiore o uguale a <b>10</b> microlitri	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Tempo di lettura del test inferiore o uguale a 15 secondi.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Dotazione di un sistema di allarme visivo nel caso di campione insufficiente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra <b>20 e 500</b> mg/dl.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Presenza di un segnale visivo nel caso di <i>out of range</i> di lettura.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Presenza di un sistema di calibrazione automatica o attraverso "chip code".	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Presenza di un segnale visivo di eventuale incompatibilità della striscia reattiva inserita o di errata procedura di calibrazione, nel caso di calibrazione attraverso "sistemi di calibrazione esterna".	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo VEDI NOTA SU MOD. FL

Elementi soggetti a valutazione e relativa attribuzione di punteggio:

	Elementi soggetti a valutazione	Parametro da valutare	Punteggio	Punteggio attribuito
a	Gestione delle interferenze dovute a variazione dei valori di ematocrito: ampiezza del range di ematocrito compreso almeno da 30 a 55 %.	Valore range ematocrito	Max 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>Range di ematocrito più ampio (rispetto al range 30-55%) = 5 punti</li> <li>Range uguale o minore = 0 punti</li> </ul>	25-55%  5 punti
b	Gestione delle interferenze dovute a maltosio, galattosio, bilirubina (in base a quanto dichiarato all'allegato F4)	Assenza di interferenza dai parametri indicati.	Da 0 a 10 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>assenza interferenza da maltosio, galattosio e bilirubina = 10 punti</li> <li>assenza</li> </ul>	

			<p>interferenza solo da maltosio e galattosio = 5 punti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assenza interferenza solo da bilirubina = 5 punti</li> <li>▪ nessuna assenza = 0 punti</li> </ul>	5 punti
c	Precisione e accuratezza delle determinazioni attraverso test eseguiti dal Laboratorio di Analisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Precisione</li> <li>▪ Accuratezza</li> <li>▪ Correlazione lineare fra determinazione glucometro su prelievo capillare e determinazione laboratorio su campione di sangue venoso (vedi Allegato 1 - specifiche su effettuazione test di laboratorio)</li> </ul>	<p>Da 0 a 35 punti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Precisione (max 12 punti)</li> <li>▪ Accuratezza (max 12 punti)</li> <li>▪ Correlazione lineare (max 11 punti)</li> </ul>	
d	Sicurezza e igienicità per gli operatori	Presenza espulsione automatica della striscia reattiva, al fine di impedire il contatto accidentale con il sangue del paziente	<p>Da 0 a 5 punti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ si = 5 punti; no = 0 punti</li> </ul>	5 punti
e	Correlazione tra sangue capillare venoso/arterioso o conversione automatica del valore, secondo gli standard internazionali	Presenza valori di conversione (automatici o mediante tabella di correlazione)	<p>Da 0 a 5 punti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ presenza conversione automatica = 5 punti</li> <li>▪ presenza tabella di correlazione = 2 punti</li> <li>▪ assenza tabella e assenza conversione automatica = 0 punti</li> </ul>	5 punti
			<b>Totale punti max 60</b>	

Soglia minima punteggio qualità: almeno 36 punti sui 60 totali.



Ditta: A. Menarini Diagnostics S.r.l

**Lotto 2:** Sistema per la misurazione della glicemia capillare su soggetto **in età neonatale** in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive):

Nome prodotto offerto: ..... STAT STRIP GLU SENSOR

Requisiti minimi (obbligatori, pena esclusione):

Presentazione di una dichiarazione documentata di presenza/assenza di eventuali interferenze nella determinazione della glicemia (compilare allegato F4).	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Volume del campione necessario alla determinazione inferiore o uguale a <b>5 microlitri</b> .	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Tempo di lettura del test inferiore o uguale a 15 secondi	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Dotazione di un sistema di allarme visivo ed eventualmente anche sonoro nel caso di campione insufficiente.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra <b>10 e 500 mg/dl</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Possibilità di misurazione in presenza di ematocrito compreso almeno da 25 a 65 %	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Presenza di un segnale visivo nel caso di <i>out of range</i> di lettura.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Presenza di un sistema di calibrazione automatica o attraverso "chip code".	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Presenza di un segnale visivo di eventuale incompatibilità della striscia reattiva inserita o di errata procedura di calibrazione, nel caso di calibrazione attraverso "sistemi di calibrazione esterna".	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Tabella di correlazione costruita su una curva di calibrazione per la lettura del sangue neonatale a seconda dei valori dell'ematocrito.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo VEDI NOTA TGD F4

Elementi soggetti a valutazione e relativa attribuzione di punteggio:

	Elementi soggetti a valutazione	Parametro da valutare	Punteggio	Punteggio attribuito
a	Gestione delle interferenze dovute a maltosio, galattosio, bilirubina (in base a quanto dichiarato all'allegato F4)	Assenza di interferenza dai parametri indicati.	Da 0 a 15 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assenza interferenza da maltosio, galattosio e bilirubina = 15 punti</li> <li>▪ assenza interferenza solo da bilirubina = 5 punti</li> <li>▪ nessuna assenza = 0 punti</li> </ul>	15 punti
b	Precisione e	▪ Precisione	Da 0 a 35 punti	

## Centrale Regionale di Acquisto

	accuratezza delle determinazioni attraverso test eseguiti dal Laboratorio di Analisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Accuratezza</li> <li>▪ Correlazione lineare fra determinazione glucometro su prelievo capillare e determinazione laboratorio su campione di sangue venoso (vedi Allegato 1 - specifiche su effettuazione test di laboratorio)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Precisione (max 12 punti)</li> <li>▪ Accuratezza (max 12 punti)</li> <li>▪ Correlazione lineare (max 11 punti)</li> </ul>	
c	Sicurezza e igienicità per gli operatori	Presenza espulsione automatica della striscia reattiva, al fine di impedire il contatto accidentale con il sangue del paziente	Da 0 a 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ si = 5 punti;</li> <li>▪ no = 0 punti</li> </ul>	5 punti
d	Correlazione tra sangue capillare venoso/arterioso o conversione automatica del valore, secondo gli standard internazionali	Presenza valori di conversione (automatici o mediante tabella di correlazione)	Da 0 a 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ presenza conversione automatica = 5 punti</li> <li>▪ presenza tabella di correlazione = 2 punti</li> <li>▪ assenza tabella e assenza conversione automatica = 0 punti</li> </ul>	5 punti
<b>Totale punti max 60</b>				

Soglia minima punteggio qualità: almeno 36 punti sui 60 totali.

Ditta: Roche Diagnostics S.p.A.

**Lotto 2:** Sistema per la misurazione della glicemia capillare su soggetto **in età neonatale** in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive):

Nome prodotto offerto: ..... ACCUCHEK AVIVA .....

Requisiti minimi (obbligatori, pena esclusione):

Presentazione di una dichiarazione documentata di presenza/assenza di eventuali interferenze nella determinazione della glicemia (compilare allegato F4).	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Volume del campione necessario alla determinazione inferiore o uguale a <b>5 microlitri</b> .	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Tempo di lettura del test inferiore o uguale a 15 secondi	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Dotazione di un sistema di allarme visivo ed eventualmente anche sonoro nel caso di campione insufficiente.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra <b>10 e 500 mg/dl</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Possibilità di misurazione in presenza di ematocrito compreso almeno da 25 a 65 %	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Presenza di un segnale visivo nel caso di <i>out of range</i> di lettura.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Presenza di un sistema di calibrazione automatica o attraverso "chip code".	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Presenza di un segnale visivo di eventuale incompatibilità della striscia reattiva inserita o di errata procedura di calibrazione, nel caso di calibrazione attraverso "sistemi di calibrazione esterna".	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo
Tabella di correlazione costruita su una curva di calibrazione per la lettura del sangue neonatale a seconda dei valori dell'ematocrito.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	idoneo VEDI NOTA MOD F4

Elementi soggetti a valutazione e relativa attribuzione di punteggio:

	Elementi soggetti a valutazione	Parametro da valutare	Punteggio	Punteggio attribuito
a	Gestione delle interferenze dovute a maltosio, galattosio, bilirubina (in base a quanto dichiarato all'allegato F4)	Assenza di interferenza dai parametri indicati.	Da 0 a 15 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assenza interferenza da maltosio, galattosio e bilirubina = 15 punti</li> <li>▪ assenza interferenza solo da bilirubina = 5 punti</li> <li>▪ nessuna assenza = 0 punti</li> </ul>	5 punti

b	Precisione e accuratezza delle determinazioni attraverso test eseguiti dal Laboratorio di Analisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Precisione</li> <li>▪ Accuratezza</li> <li>▪ Correlazione lineare fra determinazione glucometro su prelievo capillare e determinazione laboratorio su campione di sangue venoso</li> </ul> (vedi Allegato 1 - specifiche su effettuazione test di laboratorio)	Da 0 a 35 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Precisione (max 12 punti)</li> <li>▪ Accuratezza (max 12 punti)</li> <li>▪ Correlazione lineare (max 11 punti)</li> </ul>	
c	Sicurezza e igienicità per gli operatori	Presenza espulsione automatica della striscia reattiva, al fine di impedire il contatto accidentale con il sangue del paziente	Da 0 a 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ si = 5 punti;</li> <li>▪ no = 0 punti</li> </ul>	0 punti
d	Correlazione tra sangue capillare venoso/arterioso o conversione automatica del valore, secondo gli standard internazionali	Presenza valori di conversione (automatici o mediante tabella di correlazione)	Da 0 a 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ presenza conversione automatica = 5 punti</li> <li>▪ presenza tabella di correlazione = 2 punti</li> <li>▪ assenza tabella e assenza conversione automatica = 0 punti</li> </ul>	5 punti
<b>Totale punti max 60</b>				

Soglia minima punteggio qualità: almeno 36 punti sui 60 totali.

**Ditta: Roche Diagnostics S.p.A.**

**Lotto 3:** Dispositivo monouso per l'esecuzione del prelievo capillare per la misurazione della glicemia **su soggetto adulto** in ambito ospedaliero:

Nome prodotto offerto: ..... ACCU-CHEK SAFE-T PRO PLUS .....

Caratteristiche indispensabili (pena esclusione):

Sistema monouso costituito da lancetta sterile pungidito già incorporata nel dispositivo di puntura (monopezzo non riutilizzabile)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Sistema dotato di lancetta retrattile dopo l'uso	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Elementi soggetti a valutazione:

	Elementi soggetti a valutazione	Parametro da valutare	Punteggio	Punteggio attribuito
a	Possibilità di variazione della profondità di penetrazione dell'ago	Profondità ago regolabile all'interno dello stesso dispositivo o, in alternativa, offerta di una gamma di 3 diverse misure (a titolo esemplificativo: da 1,3 mm a 2,0 mm)	Max 20 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>20 punti se profondità regolabile all'interno dello stesso dispositivo;</li> <li>10 punti se offerta gamma in 3 versioni;</li> <li>0 punti se offerta un'unica versione non regolabile</li> </ul>	20 punti
b	Praticità d'uso	Ergonomicità	Max 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>ottima = 5 punti</li> <li>discreta = 4 punti</li> <li>sufficiente = 2 punti</li> <li>scarsa = 0 punti</li> </ul>	buona impugnatura 5 punti
c	Latex free Assenza di lattice naturale o suoi derivati nel prodotto finito e nel confezionamento	Presenza / assenza lattice	Max 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>assenza sia nel prodotto finito, sia nel confezionamento = 5 punti</li> <li>assenza solo nel prodotto finito = 2 punti</li> <li>presenza = 0 punti</li> </ul>	5 punti
d	Sicurezza operatore	Presenza pulsante di attivazione in sicurezza - ago coperto da linguetta /cappuccio di protezione	Max 10 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>presenza entrambi i parametri = 10 punti</li> <li>presenza di uno solo dei due parametri = 5 punti</li> <li>assenti entrambi = 0 punti</li> </ul>	10 punti
			Totale punti max 40	40 punti

Soglia minima punteggio qualità: almeno 21 sui 40 totali.

**Ditta: Becton Dickinson Italia S.p.A.**

**Lotto 3:** Dispositivo monouso per l'esecuzione del prelievo capillare per la misurazione della glicemia **su soggetto adulto** in ambito ospedaliero:

Nome prodotto offerto: BD MICROTAINER CONTACT

Caratteristiche indispensabili (pena esclusione):

Sistema monouso costituito da lancetta sterile pungidito già incorporata nel dispositivo di puntura (monopezzo non riutilizzabile)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Sistema dotato di lancetta retrattile dopo l'uso	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Elementi soggetti a valutazione:

	Elementi soggetti a valutazione	Parametro da valutare	Punteggio	Punteggio attribuito
a	Possibilità di variazione della profondità di penetrazione dell'ago	Profondità ago regolabile all'interno dello stesso dispositivo o, in alternativa, offerta di una gamma di 3 diverse misure (a titolo esemplificativo: da 1,3 mm a 2,0 mm)	Max 20 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>20 punti se profondità regolabile all'interno dello stesso dispositivo;</li> <li>10 punti se offerta gamma in 3 versioni;</li> <li>0 punti se offerta un'unica versione non regolabile</li> </ul>	10 punti
b	Praticità d'uso	Ergonomicità	Max 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>ottima = 5 punti</li> <li>discreta = 4 punti</li> <li>sufficiente = 2 punti</li> <li>scarsa = 0 punti</li> </ul>	4 punti
c	Latex free Assenza di lattice naturale o suoi derivati nel prodotto finito e nel confezionamento	Presenza / assenza lattice	Max 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>assenza sia nel prodotto finito, sia nel confezionamento = 5 punti</li> <li>assenza solo nel prodotto finito = 2 punti</li> <li>presenza = 0 punti</li> </ul>	5 punti
d	Sicurezza operatore	Presenza pulsante di attivazione in sicurezza - ago coperto da linguetta /cappuccio di protezione	Max 10 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>presenza entrambi i parametri = 10 punti</li> <li>presenza di uno solo dei due parametri = 5 punti</li> <li>assenti entrambi = 0 punti</li> </ul>	NO PULSANTE SE CAPPUCIO PROTEZIONE ATTIVAZIONE A CONTATTO 5 punti
			Totale punti max 40	24 punti

Soglia minima punteggio qualità: almeno 21 sui 40 totali.



**Ditta: Benefis S.r.l.**

**Lotto 3:** Dispositivo monouso per l'esecuzione del prelievo capillare per la misurazione della glicemia **su soggetto adulto** in ambito ospedaliero:

Nome prodotto offerto: STERILANCE AD

Caratteristiche indispensabili (pena esclusione):

Sistema monouso costituito da lancetta sterile pungidito già incorporata nel dispositivo di puntura (monopezzo non riutilizzabile)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Sistema dotato di lancetta retrattile dopo l'uso	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Elementi soggetti a valutazione:

	Elementi soggetti a valutazione	Parametro da valutare	Punteggio	Punteggio attribuito
a	Possibilità di variazione della profondità di penetrazione dell'ago	Profondità ago regolabile all'interno dello stesso dispositivo o, in alternativa, offerta di una gamma di 3 diverse misure (a titolo esemplificativo: da 1,3 mm a 2,0 mm)	Max 20 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 20 punti se profondità regolabile all'interno dello stesso dispositivo;</li> <li>▪ 10 punti se offerta gamma in 3 versioni;</li> <li>▪ 0 punti se offerta un'unica versione non regolabile</li> </ul>	20 punti
b	Praticità d'uso	Ergonomicità	Max 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ottima = 5 punti</li> <li>▪ discreta = 4 punti</li> <li>▪ sufficiente = 2 punti</li> <li>▪ scarsa = 0 punti</li> </ul>	4 punti
c	Latex free Assenza di lattice naturale o suoi derivati nel prodotto finito e nel confezionamento	Presenza / assenza lattice	Max 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assenza sia nel prodotto finito, sia nel confezionamento = 5 punti</li> <li>▪ assenza solo nel prodotto finito = 2 punti</li> <li>▪ presenza = 0 punti</li> </ul>	5 punti
d	Sicurezza operatore	Presenza pulsante di attivazione in sicurezza - ago coperto da linguetta /cappuccio di protezione	Max 10 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>• presenza entrambi i parametri = 10 punti</li> <li>• presenza di uno solo dei due parametri = 5 punti</li> <li>• assenti entrambi = 0 punti</li> </ul>	NO PULSANTE SI CAPPUCIO PROTEZIONE 5 punti ATTIVAZIONE A CONTATTO
Totale punti max 40				34 punti

Soglia minima punteggio qualità: almeno 21 sui 40 totali.

**Ditta: Johnson & Johnson Medical S.p.A.**

**Lotto 3:** Dispositivo monouso per l'esecuzione del prelievo capillare per la misurazione della glicemia **su soggetto adulto** in ambito ospedaliero:

Nome prodotto offerto: ..... ONE TOUCH SURE SOFT .....

Caratteristiche indispensabili (pena esclusione):

Sistema monouso costituito da lancetta sterile pungidito già incorporata nel dispositivo di puntura (monopezzo non riutilizzabile)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
Sistema dotato di lancetta retrattile dopo l'uso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO

Elementi soggetti a valutazione:

	Elementi soggetti a valutazione	Parametro da valutare	Punteggio	Punteggio attribuito
a	Possibilità di variazione della profondità di penetrazione dell'ago	Profondità ago regolabile all'interno dello stesso dispositivo o, in alternativa, offerta di una gamma di 3 diverse misure (a titolo esemplificativo: da 1,3 mm a 2,0 mm)	Max 20 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>20 punti se profondità regolabile all'interno dello stesso dispositivo;</li> <li>10 punti se offerta gamma in 3 versioni;</li> <li>0 punti se offerta un'unica versione non regolabile</li> </ul>	0 punti
b	Praticità d'uso	Ergonomicità	Max 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>ottima = 5 punti</li> <li>discreta = 4 punti</li> <li>sufficiente = 2 punti</li> <li>scarsa = 0 punti</li> </ul>	5 punti
c	Latex free Assenza di lattice naturale o suoi derivati nel prodotto finito e nel confezionamento	Presenza / assenza lattice	Max 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>assenza sia nel prodotto finito, sia nel confezionamento = 5 punti</li> <li>assenza solo nel prodotto finito = 2 punti</li> <li>presenza = 0 punti</li> </ul>	5 punti
d	Sicurezza operatore	Presenza pulsante di attivazione in sicurezza - ago coperto da linguetta /cappuccio di protezione	Max 10 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>presenza entrambi i parametri = 10 punti</li> <li>presenza di uno solo dei due parametri = 5 punti</li> <li>assenti entrambi = 0 punti</li> </ul>	10 punti
			Totale punti max 40	20 punti

Soglia minima punteggio qualità: almeno 21 sui 40 totali.

INFERIORE ALLA  
SOGGIA MINIMA  
RICHIESTA

**Ditta: Roche Diagnostics S.p.A.**

**Lotto 4:** Dispositivo monouso con lama a scatto per l'esecuzione del prelievo capillare dal tallone nei **neonati e prematuri**:

Nome prodotto offerto: ..... *ACCU-CHEK-SAFE-T-PRO-PLUS*

Caratteristiche indispensabili:

Sistema monouso costituito da lama sterile già incorporata nel dispositivo (mono pezzo non riutilizzabile)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Lunghezza e profondità di incisione; presenza di due lunghezze di incisione: 2,5 mm e 1,75 mm (verranno accettati minimi scostamenti) corrispondenti a due profondità di incisione: 1,0 mm e 0,85 mm (verranno accettati minimi scostamenti)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Profondità; presenza di due profondità di incisione: 1,0 mm e 0,85 mm (verranno accettati minimi scostamenti).	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Elementi soggetti a valutazione:

	Elementi soggetti a valutazione	Parametro da valutare	Punteggio	Punteggio attribuito
a	Praticità d'uso	Ergonomicità	Max 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ottima = 5 punti</li> <li>▪ discreta = 4 punti</li> <li>▪ sufficiente = 2 punti</li> <li>scarsa = 0 punti</li> </ul>	5 punti
b	Latex free	Presenza / assenza lattice	Max 5 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assenza = 5 punti</li> <li>▪ assenza solo nel prodotto finito = 2</li> <li>▪ presenza = 0 punti</li> </ul>	5 punti
c	Sicurezza operatore	Presenza pulsante di attivazione in sicurezza - lama coperta da linguetta di protezione	Max 15 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ presenza sia del pulsante, sia della lama = 15 punti</li> <li>▪ presenza di uno solo dei due parametri = 7,5 punti</li> <li>▪ assenza di entrambi = 0 punti</li> </ul>	15 punti
d	Sicurezza paziente	Presenza confezioni singole sterili	Max 15 punti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ presenza = 15 punti</li> <li>▪ assenza = 0 punti</li> </ul>	15 punti
Totale punti max 40				40 punti

Soglia minima punteggio qualità: almeno 21 sui 40 totali.

**Procedura aperta per la fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati (in ambito ospedaliero) occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre - Lotti n. 4.**

**Seduta della Commissione Giudicatrice del 16 gennaio 2012**

**Verbale di acquisizione esiti test laboratoristici precisione, accuratezza e correlazione lineare**

Il giorno 16/01/2012, alle ore 9,40 presso la sala riunioni dell'Ospedale Villa Scassi (palazzina uffici amministrativi) si è riunita la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, nominata con Deliberazione n. 10 del 24/01/2011 e successivamente integrata con Deliberazione n. 39 del 17/05/2011, per la verifica della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti, ai fini dell'assegnazione dei punteggi relativi al parametro qualità.

Sono presenti i Signori:

➤ <b>DE MICHELI</b>	Dott. Alberto	U.O. Diabetologia A.O.U. San Martino - Genova <i>(Attualmente consulente ARS Liguria)</i>	Presidente
➤ <b>BOTTARO</b>	Dott. Luigi C.	Direttore Dipartimento Patologia Clinica - Asl3 Genovese	Componente
➤ <b>MONACHESI</b>	Dott. Mario	U.O.S. Endocrinologia, Medicina Interna - Ospedale San Paolo - Asl2 Savonese	Componente
➤ <b>PEDRAZZI</b>	Dott. Paolo	Laboratorio Patologia clinica - Ospedale P.A. Micone - Asl3 Genovese	Componente
➤ <b>GIACOPELLI</b>	Sig.ra Carmen	Laboratorio Patologia clinica - Ospedale P.A. Micone - Asl3 Genovese	Componente

E' presente altresì il Dott. Riccardo Zanella, dirigente della Centrale, che svolge le funzioni di segretario della Commissione, assistito dal Sig. Ivo Gagliolo, coadiutore amministrativo della Centrale.


La seduta non è pubblica.

La Commissione aggiudicatrice prende atto e approva il verbale relativo alla seduta del 13 giugno 2011, nella quale sono state effettuate le valutazioni degli items relativi alle caratteristiche tecniche dei dispositivi presentati.

Rimanevano da effettuare i test laboratoristici per la determinazione dei punteggi relativi a precisione, accuratezza e correlazione lineare.

Il dr. Bottaro e il dr. Pedrazzi riferiscono sulle modalità di svolgimento dei test laboratoristici previsti dal capitolato tecnico. Si allega relazione tecnica di sintesi sullo svolgimento dei test e





sugli esiti delle prove. Il materiale documentario analitico è disponibile agli atti del Laboratorio di Patologia Clinica dell'ASL 3 Genovese.

I test si sono svolti in conformità alle previsioni del capitolato tecnico (allegato a1 del Disciplinare di gara) dall'11.10.2011 alla fine del mese di dicembre 2011. Sono state effettuate nella prima fase le valutazioni sulla precisione e di seguito quelle su accuratezza e correlazione.

Per precisione e accuratezza i valori sono espressi in percentuale.

### Ditta: A. Menarini Diagnostics S.r.l

**Lotto 1:** Sistema per la misurazione della glicemia capillare su **sogetto adulto** in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive):

Nome prodotto offerto: Stat Strip Glus3ensor + Stat strip Xpress meter

Precisione e accuratezza delle determinazioni attraverso test eseguiti dal Laboratorio di Analisi	Precisione max 12 p.	5,73	Punti 8
	Accuratezza max 12 p.	10,758	Punti 3
	Correlazione lineare fra determinazione glucometro su prelievo capillare e determinazione laboratorio su campione di sangue venoso Max 11 p.	0,9515	Punti 11

### Ditta: Svas Biosana S.p.A.

**Lotto 1:** Sistema per la misurazione della glicemia capillare su **sogetto adulto** in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive):

Nome prodotto offerto: Glucolab Autocoding

c	Precisione e accuratezza delle determinazioni attraverso test eseguiti dal Laboratorio di Analisi	Precisione max 12 p.	3,66	Punti 10
		Accuratezza max 12 p.	19,53	Punti 0

		Correlazione lineare fra determinazione glucometro su prelievo capillare e determinazione laboratorio su campione di sangue venoso Max 11 p.	0,9345	Punti 11
--	--	---	--------	----------

Ditta: Roche Diagnostics S.p.A.

**Lotto 1:** Sistema per la misurazione della glicemia capillare su **soggetto adulto** in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive)

Nome prodotto offerto: Accu-Check Compact Plus

c	Precisione e accuratezza delle determinazioni attraverso test eseguiti dal Laboratorio di Analisi	Precisione max 12 p.	5,46	Punti 8
		Accuratezza max 12 p.	27,29	Punti 0
		Correlazione lineare fra determinazione glucometro su prelievo capillare e determinazione laboratorio su campione di sangue venoso Max 11 p.	0,9695	Punti 11



**Ditta: A. Menarini Diagnostics S.r.l**

**Lotto 2:** Sistema per la misurazione della glicemia capillare su soggetto **in età neonatale** in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive):

Nome prodotto offerto: Stat Strip Glu-Sensor + Stat Strip X Press meter

	Precisione e accuratezza delle determinazioni attraverso test eseguiti dal Laboratorio di Analisi	Precisione max 12 p.	3,35	Punti 10
		Accuratezza max 12 p.	11,55	Punti 3
		Correlazione lineare fra determinazione glucometro su prelievo capillare e determinazione laboratorio su campione di sangue venoso Max 11 p.	0,9552	Punti 11

**Ditta: Roche Diagnostics S.p.A.**

**Lotto 2:** Sistema per la misurazione della glicemia capillare su soggetto **in età neonatale** in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive):

Nome prodotto offerto: Accu Check Aviva

c	Precisione e accuratezza delle determinazioni attraverso test eseguiti dal Laboratorio di Analisi	Precisione max 12 p.	2,27	Punti 10
		Accuratezza max 12 p.	6,255	Punti 8
		Correlazione lineare fra determinazione glucometro su prelievo capillare e determinazione laboratorio su campione di sangue venoso Max 11 p.	0,9087	Punti 11

La Commissione riepiloga a questo punto i punteggi attribuiti per ciascun parametro di valutazione, per tutti i prodotti che nei lotti hanno superato la soglia minima di idoneità prevista (punti 31 nei

## Centrale Regionale di Acquisto

lotti 1 e 2), punti 21 (nei lotti 3 e 4) e determina il totale del punteggio tecnico da comunicare in sede di apertura delle offerte economiche alle ditte offerenti.

## Lotto 1

	A Valore range ematocrito	B Assenza interferenze	C1 Precisione	C2 Accuratezza	C3 Correlazione lineare	D Sicurezza e igienicità per operatori	E Conversione dei valori	Totale
A. Menarini	5	10	8	3	11	5	5	<b>47/60</b>
SVAS	0	10	10	0	11	5	5	<b>41/60</b>
Roche	5	5	8	0	11	5	5	<b>39/60</b>

## Lotto 2

	A Gestione interferenze	B1 Precisione	B2 Accuratezza	B3 Correlazione lineare	C Sicurezza e igienicità per operatori	D Conversione dei valori	Totale
A. Menarini	15	10	3	11	5	5	<b>49/60</b>
Roche	5	10	8	11	0	5	<b>39/60</b>

## Lotto 3

	A Variazione profondità penetrazione	B Praticità d'uso	C Presenza assenza lattice	D Sicurezza per operatori	Totale
Roche Diagnostics	20	5	5	10	<b>40</b>
Becton Dickinson	10	4	5	5	<b>24</b>
Benefis	20	4	5	5	<b>34</b>
Johnson & Johnson	0	5	5	10	<b>20 Non idoneo</b>

## Lotto 4

	A Praticità d'uso	B Presenza assenza lattice	C Sicurezza per operatori	D Sicurezza Per pazienti	Totale
Roche Diagnostics	5	5	15	15	<b>40</b>






Consorzio Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Corso Scassi, 1 16149 Genova - C.F. e P.I. 01829030996

Tel +39 010 4102336 - Fax +39 010 4102417 - Sito web www.acquistiliguria.it

Il Presidente ringrazia tutti i componenti per il lavoro svolto e in particolare i laboratoristi che hanno effettuato i test e rassegna il presente verbale agli atti della Centrale per la fissazione della seduta pubblica per l'aggiudicazione provvisoria.  
La seduta è tolta alle ore 12,00.

I Componenti della Commissionem giudicatrice

Dott. DE MICHELI	Alberto		Presidente
Dott. BOTTARO	Luigi Carlo		Presidente
Sig.ra GIACOPELLI	Carmen		Componente
Dott. MONACHESI	Mario		Componente
Dott. PEDRAZZI	Paolo		Componente

Per la Centrale Regionale di Acquisto

Dott. Riccardo ZANELLA ..... 

Sig. Ivo Gagliolo ..... 

Allegata: Relazione tecnica svolgimento ed esiti test laboratoristici composta di n. 13 pagine

### PRECISIONE

Al fine di effettuare le prove di PRECISIONE strumentale per la gara sui reflettometri. Gli strumenti sono stati cimentati utilizzando i sieri di controllo forniti dalle ditte in accompagnamento ad ogni singolo strumento come richiesto da capitolato. Sono stati testati i reflettometri:

- **ROCHE**
  - lotto 1: Compact
    - strumento 1
    - strumento 2
  - lotto 2: Aviva
    - strumento 1
    - strumento 2
  
- **MENARINI NOVA BIOMEDICAL**
  - Lotto 1
    - Strumento 1
    - Strumento 2
  - Lotto 2
    - Strumento 1
    - Strumento 2
  
- **SVAS INFOPIA**
  - Lotto 1
    - Strumento 1
    - Strumento 2

Facendo fede a quanto deliberato in capitolato tecnico laddove si dice: *Verranno effettuati tests di Precisione mediante l'effettuazione di almeno 20 ripetizione su campioni a titolo noto. I tests riguardano almeno tre diversi livelli di glicemia (tipic. 60, 250, 400) mg/dl. Si farà riferimento al CV come parametro di valutazione.*

Su ciascuno strumento dell'elenco sono state effettuate 10 determinazioni per controllo, utilizzando i controlli forniti dalle tre ditte rispettivamente, sono stati utilizzati 3 controlli (uno per ditta su ogni apparecchio), per un totale di 240 determinazioni. I tests hanno avuto avvio l'11 ottobre 2011; in mancanza di tutti i controlli richiesti, trattandosi di controlli di Precisione e per garantire una omogeneità di trattamento, ogni strumento è stato cimentato con i tre differenti controlli forniti ciascuno da una ditta differente. Per il livello normale (medio-basso) è stato utilizzato il controllo SVAS, per il livello alto è stato utilizzato il controllo 3 di Menarini (250-350), per il livello Medio Alto è stato utilizzato il Controllo di Roche Control-2.

Al termine delle determinazioni sono state valutate la media, la deviazione standard e il coefficiente di variazione per ogni strumento. In funzione del risultato ottenuto è stato attribuito un punteggio in base al CV migliore (ovvero più basso).

Nei prospetti forniti di seguito si illustra il risultato ottenuto:

# GARA GLUCOMETRI

CONTROLLO SVAS BIC

str=strumento

formula di calcolo

(15-offerta) / (15-offerta n

	ROCHE				MENARINI				SVAS	
	LOTTO 1		LOTTO 2		LOTTO 1		LOTTO 2		LOTTO 1	
	str 1	str 2	str 1	str 2	str 1	str 2	str 1	str 2	str 1	str 2
1	126	127	85	84	115	109	108	102	98	102
2	162	135	86	83	105	111	107	106	96	101
3	129	133	88	83	103	113	109	98	99	103
4	133	137	87	84	116	115	107	108	100	96
5	129	139	84	84	120	116	115	112	98	101
6	130	140	85	84	120	102	112	109	99	93
7	139	138	84	88	99	111	105	105	95	98
8	137	145	90	88	96	121	108	104	98	96
9	135	130	86	87	106	105	105	108	97	94
10	143	122	85	82	100	110	102	110	99	95
<b>MEDIA</b>	<b>136,3</b>	<b>134,6</b>	<b>86</b>	<b>84,7</b>	<b>108</b>	<b>111,3</b>	<b>107,8</b>	<b>106,2</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>
<b>DS</b>	<b>10,4</b>	<b>6,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>9,0</b>	<b>5,4</b>	<b>3,7</b>	<b>4,1</b>	<b>1,5</b>	<b>3,6</b>
<b>CV</b>	<b>7,65%</b>	<b>5,04%</b>	<b>2,19%</b>	<b>2,55%</b>	<b>8,33%</b>	<b>4,89%</b>	<b>3,41%</b>	<b>3,89%</b>	<b>1,56%</b>	<b>3,68%</b>
<b>media</b>										
<b>CV</b>	<b>6,34%</b>		<b>2,37%</b>		<b>6,61%</b>		<b>3,65%</b>		<b>2,62%</b>	

## CONTROLLO MENARINI (V.A. 250 -350 mg/dL)

str=strumento

	ROCHE		LOTTO 2		MENARINI				SVASS	
	LOTTO 1		LOTTO 2		LOTTO 1		LOTTO 2		LOTTO 1	
	str 1	str 2	str 1	str 2	str 1	str 2	str 1	str 2	str 1	str 2
1	287	288	246	243	283	283	266	267	332	371
2	304	280	242	243	282	256	268	278	337	345
3	279	282	245	249	261	262	258	275	346	319
4	308	285	250	251	291	271	272	274	330	328
5	272	277	241	233	288	259	260	257	319	328
6	293	264	252	252	304	272	273	284	328	332
7	326	298	243	242	274	290	276	273	328	334
8	328	291	247	240	296	270	274	269	355	348
9	297	323	250	249	295	284	273	265	326	363
10	321	322	245	250	299	277	274	279	323	357
<b>MEDIA</b>	<b>301,5</b>	<b>291</b>	<b>246,1</b>	<b>245,2</b>	<b>287,3</b>	<b>272,4</b>	<b>269,4</b>	<b>272,1</b>	<b>332,4</b>	<b>342,5</b>
<b>DS</b>	<b>19,5</b>	<b>18,9</b>	<b>3,7</b>	<b>6,0</b>	<b>12,8</b>	<b>11,3</b>	<b>6,2</b>	<b>7,8</b>	<b>10,9</b>	<b>17,1</b>
<b>CV</b>	<b>6,46%</b>	<b>6,49%</b>	<b>1,49%</b>	<b>2,46%</b>	<b>4,46%</b>	<b>4,14%</b>	<b>2,32%</b>	<b>2,88%</b>	<b>3,28%</b>	<b>5,00%</b>
<b>media</b>										
<b>CV</b>	<b>6,47%</b>		<b>1,97%</b>		<b>4,30%</b>		<b>2,60%</b>		<b>4,14%</b>	

M

JCE

A  
yg

2

A.S.L. n. 3 – Genovese DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA CLINICA  
 Gara Sistemi di uso ospedaliero per la misurazione della glicemia. Prove di laboratorio su  
 riflettometri e strisce

CONTROLLO ACCU-CHECK CONTROL 2 (ROCHE)

str=strumento

	ROCHE		MENARINI				SVAS			
	LOTTO 1		LOTTO 2		LOTTO 1		LOTTO 2		LOTTO 1	
	str 1	str 2	str 1	str 2	str 1	str 2	str 1	str 2	str 1	str 2
1	149	152	209	211	184	174	161	150	225	226
2	147	148	216	219	178	160	166	167	225	231
3	149	148	207	213	186	170	150	159	221	224
4	148	140	209	212	177	176	164	160	212	223
5	135	148	211	215	181	167	156	165	211	225
6	151	152	214	215	186	185	170	154	208	214
7	152	147	207	215	196	164	161	160	195	210
8	138	145	216	205	184	172	174	164	214	211
9	148	157	218	215	152	172	162	160	198	219
10	146	142	229	210	152	161	171	163	214	207
MEDIA	146,3	147,9	213,6	213	177,6	170,1	163,5	160,2	212,3	219
DS	5,5	5,0	6,7	3,8	14,5	7,5	7,2	5,1	10,2	8,1
CV	3,76%	3,36%	3,14%	1,78%	8,15%	4,43%	4,41%	3,19%	4,78%	3,68%
media cv	3,56%		2,46%		6,29%		3,80%		4,23%	

controllo	ROCHE		MENARINI		SVAS	
	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 1	
			str 1	str 2	str 1	str 2
SVAS	6,30%	2,37%	6,61%	3,65%	2,62%	
MENARINI	6,50%	1,97%	4,30%	2,60%	4,14%	
ACCU-CHECK	3,60%	2,46%	6,29%	3,80%	4,23%	
TOT.PRECISIONE	5,46%	2,27%	5,73%	3,35%	3,66%	

LOTTO 1

controllo	ROCHE	MENARINI	SVAS
	SVAS	6,30%	6,61%
MENARINI	6,50%	4,30%	4,14%
ACCU-CHECK	3,60%	6,29%	4,23%
Media Prec.	5,46%	5,73%	3,66%

LOTTO 2

controllo	ROCHE	MENARINI
	SVAS	2,37%
MENARINI	1,97%	2,60%
ACCU-CHECK	2,46%	3,80%
TOT.PRECISIONE	2,27%	3,35%

*mm*

*JCE*

*[Signature]*  
 3



ACCURATEZZA

Per valutare l'accuratezza sono stati utilizzati i controlli di una ditta terza (BIORAD), specificatamente prodotti con sangue intero per testare strumenti di laboratorio, fra cui anche i reflettometri.

Sono stati testati i controlli Low (n.lotto 92421) e Hight (n.lotto 92423) effettuando come da Capitolato, almeno 20 ripetizioni per strumento dello stesso campione.




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page:

- Small signature on the far left.
- Signature "JCE" below the first signature.
- Large, circular signature in the center.
- Signature "M" below the circular signature.
- Small signature "d" to the right of "M".
- Signature "4" and "yg" on the far right.



A.S.L. n. 3 – Genovese DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA CLINICA  
Gara Sistemi di uso ospedaliero per la misurazione della glicemia. Prove di laboratorio su  
reflettometri e strisce

PROVE ACCURATEZZA GRAFICI

LOTTO 1

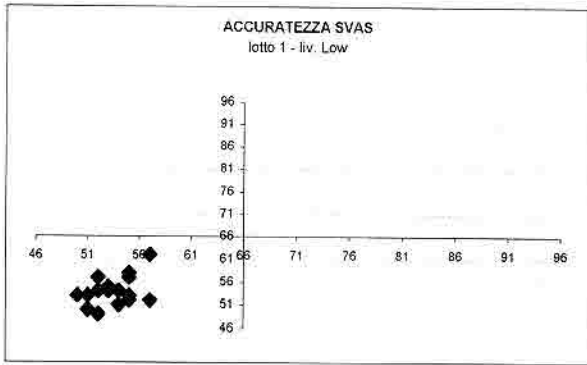

LOTTO 2

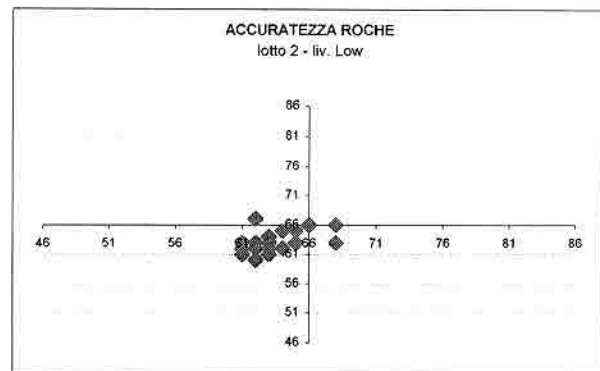

*hm*




*ACE*

*[Large signature]*



*[Signature]*  
5 yf

PROVE ACCURATEZZA GRAFICI

LOTTO 1

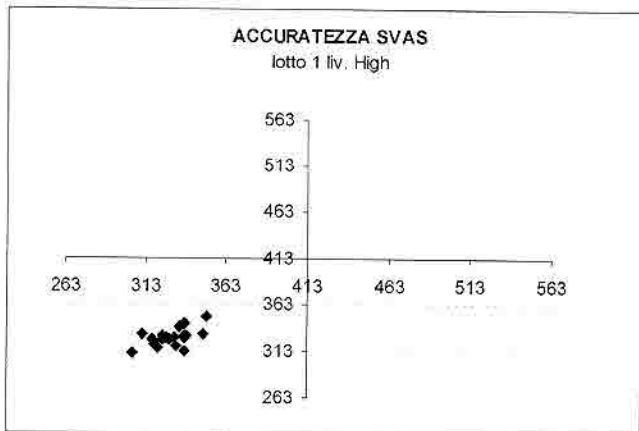

LOTTO 2

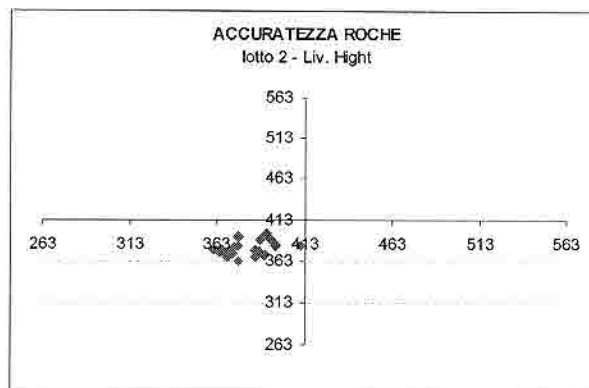

M

JCE

A  
6/21

A.S.L. n. 3 – Genovese DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA CLINICA  
 Gara Sistemi di uso ospedaliero per la misurazione della glicemia. Prove di laboratorio su  
 riflettometri e strisce

livello basso: 66 mg/dl Lot.n. 92421

lotto 1

	SVAS		MENARINI		ROCHE Compact	
	51	53	65	62	84	84
	53	54	70	62	87	82
	50	53	65	66	83	80
	55	58	68	68	89	85
	51	53	58	59	82	90
	53	55	61	55	86	95
	55	53	63	63	79	79
	57	52	66	65	90	92
	55	53	63	61	96	106
	54	54	58	66	84	83
	55	57	61	64	84	80
	57	62	61	63	89	84
	52	49	62	63	92	130
	55	53	62	62	84	79
	53	55	61	66	89	83
	55	52	67	65	90	85
	54	51	60	64	91	90
	51	50	65	69	90	90
	52	57	63	65	85	80
	52	54	65	61	98	95
<b>media</b>	<b>53,5</b>	<b>53,9</b>	<b>63,2</b>	<b>63,45</b>	<b>87,6</b>	<b>88,6</b>
<b>diff %</b>	<b>18,9%</b>	<b>18,3%</b>	<b>4,2%</b>	<b>3,9%</b>	<b>32,7%</b>	<b>34,2%</b>

livello alto: 413 mg/dl Lot.n. 92423

lotto 1

	SVAS		MENARINI		ROCHE Compact	
	326	328	358	345	465	473
	331	328	352	363	488	483
	351	350	353	331	505	494
	334	340	341	347	485	495
	338	330	354	331	506	522
	337	329	337	346	494	484
	328	327	332	285	486	488
	319	321	336	369	497	555
	319	324	339	295	456	495
	337	314	268	340	500	499
	311	332	312	352	460	512
	324	330	356	363	509	526
	337	344	337	359	470	492
	318	326	334	331	478	473
	332	319	349	373	472	502
	337	331	341	301	482	501
	349	332	353	334	474	518
	324	327	342	331	497	552
	305	312	366	365	550	551
	321	317	353	352	551	570
<b>media</b>	<b>328,9</b>	<b>328,05</b>	<b>340,65</b>	<b>340,65</b>	<b>491,25</b>	<b>509,25</b>
<b>diff %</b>	<b>20,36%</b>	<b>20,57%</b>	<b>17,52%</b>	<b>17,52%</b>	<b>18,95%</b>	<b>23,31%</b>
<b>Media diff %</b>	<b>19,53%</b>		<b>10,758%</b>		<b>27,29%</b>	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

A.S.L. n. 3 – Genovese DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA CLINICA  
 Gara Sistemi di uso ospedaliero per la misurazione della glicemia. Prove di laboratorio su  
 riflettometri e strisce

livello basso: 66 mg/dl

Lot. N. 92421

lotto 2

	MENARINI		ROCHE Aviva	
	63	64	63	61
	54	59	62	62
	59	63	61	62
	66	62	64	65
	64	60	63	62
	66	64	63	64
	60	65	65	63
	61	61	68	63
	61	64	61	63
	64	61	62	60
	63	61	62	62
	63	67	61	61
	63	62	64	62
	61	57	63	63
	59	63	62	63
	65	55	63	63
	59	63	62	67
	56	63	66	66
	61	64	65	65
	60	67	68	66
<b>media</b>	<b>61,4</b>	<b>62,25</b>	<b>63,4</b>	<b>63,15</b>
<b>scost. %</b>	<b>7,0%</b>	<b>5,7%</b>	<b>3,9%</b>	<b>4,3%</b>

livello alto: 413 mg/dl

Lot.n. 92423

lotto 2

	MENARINI		ROCHE Aviva	
	351	339	372	371
	351	328	387	373
	365	316	375	380
	327	329	375	362
	345	350	397	380
	359	298	411	380
	368	338	375	391
	354	297	394	388
	365	330	391	396
	328	371	361	378
	341	263	388	388
	374	379	365	374
	359	337	369	367
	349	323	369	371
	344	370	385	367
	344	349	373	379
	365	332	385	375
	383	352	369	369
	348	292	366	376
	372	370	390	369
<b>media</b>	<b>354,6</b>	<b>333,15</b>	<b>379,85</b>	<b>376,7</b>
<b>Scost. %</b>	<b>14,14%</b>	<b>19,33%</b>	<b>8,03%</b>	<b>8,79%</b>
<b>Media scost %</b>	<b>11.55%</b>		<b>6.255%</b>	

CORRELAZIONE LINEARE

Facendo fede a quanto deliberato in capitolato tecnico laddove si dice: *Verranno effettuati tests di Correlazione lineare fra prelievo capillare e campione di sangue venoso raccolto su provetta (la cui tipologia di anticoagulante è stata indicata dalle ditte interpellate: EDTA o litio eparina) prelevati su un numero variabile (almeno 20) di pazienti. I 4 risultati più discostati dal valore ottenuto con il prelievo venoso non verranno considerati ai fini della valutazione.*

L'andamento complessivo dei dati raccolti è stato valutato mediante il sistema della correlazione lineare (CL) e il calcolo dell'indice di Pearson.

Di seguito si mostrano grafici, coefficiente di correlazione ed equazioni lineari dei risultati ottenuti per lotto, ditta e strumento

Nella tabella seguente si illustrano i dosaggi riscontrati (su campione di sangue Edta (SVAS Biosana) o Li.-eparina(Menarini, Roche)) e per riflettometro. (str=strumento)

EDTA	LI ep.	SVAS		Menarini				ROCHE			
		lotto 1		lotto 1		lotto 2		lotto 1		lotto 2	
		STR 1	STR 2	STR 1	STR 2	STR 1	STR 2	STR 1	STR 2	STR 1	STR 2
78	69	95	<b>102</b>	73	82	74	81	88	86	<b>76</b>	69
97	86	110	106	91	91	95	91	101	100	<b>94</b>	<b>92</b>
85	72	97	102	68	80	<b>106</b>	74	<b>94</b>	<b>94</b>	77	73
105	94	111	122	101	100	105	107	<b>115</b>	<b>116</b>	90	<b>89</b>
81	68	99	96	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	76	87	<b>91</b>	70	65
78	73	93	<b>100</b>	81	78	78	84	<b>85</b>	85	74	71
95	88	<b>120</b>	110	97	98	99	<b>106</b>	108	110	85	91
83	75	90	88	74	82	80	84	84	87	71	73
94	82	102	111	<b>99</b>	89	94	95	96	102	79	85
94	86	107	109	89	94	100	<b>101</b>	100	99	84	82
96	83	102	103	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>101</b>	90	88	84	81
96	88	115	<b>114</b>	97	94	76	96	102	106	83	83
113	101	111	107	107	111	114	111	106	107	95	<b>95</b>
100	89	<b>123</b>	<b>125</b>	99	96	103	97	106	104	85	84
84	74	<b>106</b>	101	78	82	83	83	93	<b>97</b>	73	74
99	86	115	113	90	94	98	97	<b>108</b>	106	80	81
110	100	123	120	111	<b>141</b>	<b>116</b>	<b>117</b>	114	117	<b>90</b>	95
190	175	190	174	192	178	177	190	188	191	<b>160</b>	<b>161</b>
85	74	95	95	82	77	77	80	85	88	74	73
95	85	<b>120</b>	112	86	83	89	84	97	101	82	80

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*



A.S.L. n. 3 – Genovese DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA CLINICA  
 Gara Sistemi di uso ospedaliero per la misurazione della glicemia. Prove di laboratorio su  
 riflettometri e strisce







Tabella corretta eliminando i dati più discostanti

EDTA	LI ep.	SVAS		Menarini				ROCHE			
		lotto 1		lotto 1		lotto 2		lotto 1		lotto 2	
		STR 1	STR 2	STR 1	STR 2	STR 1	STR 2	STR 1	STR 2	STR 1	STR 2
78	69	95		73		74	81	88	86		69
97	86	110	106	91	91	95	91	101	100		
85	72	97	102	68	80		74			77	73
105	94	111	122	101	100	105	107			90	
81	68	99	96				76	87		70	65
78	73	93		81	78	78	84	85	85	74	71
95	88		110	97	98	99			110	85	91
83	75	90	88	74	82	80	84	84	87	71	73
94	82	102	111		89	94	95	96	102	79	85
94	86	107	109	89	94	100		100	99	84	82
96	83	102	103					90	88	84	81
96	88	115		97	94	76	96	102	106	83	83
113	101	111	107	107	111	114	111	106	107	95	
100	89			99	96	103	97	106	104	85	84
84	74		101	78	82	83	83	93		73	74
99	86	115	113	90	94	98	97		106	80	81
110	100	123	120	111				114	117		95
190	175	190	174		178	177	190	188	191		
85	74	95	95	82	77	77	80	85	88	74	73
95	85		112	86	83	89	84	97	101	82	80

A.S.L. n. 3 – Genovese DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA CLINICA  
 Gara Sistemi di uso ospedaliero per la misurazione della glicemia. Prove di laboratorio su  
 reflattometri e strisce

Rappresentazione grafica delle distribuzioni dei dosaggi con calcolo indice Pearson ed equazione  
 della retta, dopo eliminazione per ciascuno strumento dei 4 risultati più aberranti.

LOTTO 1



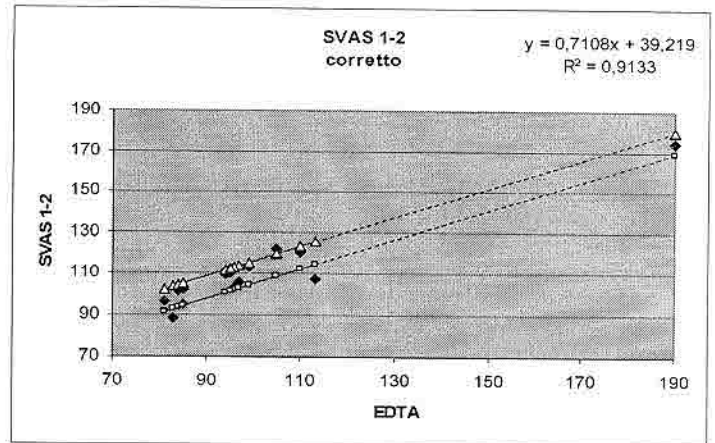
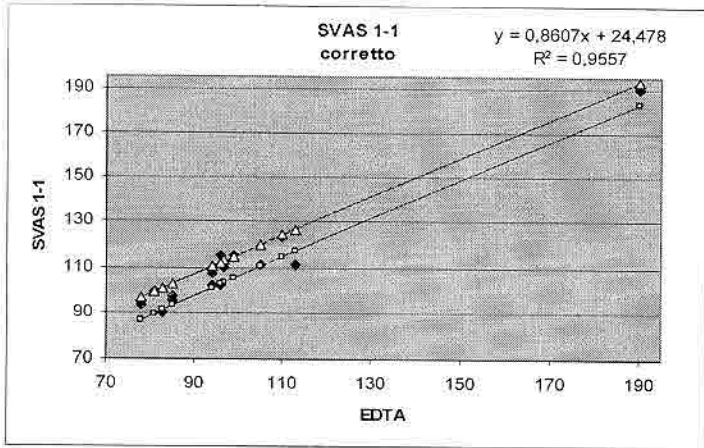


Handwritten signatures and initials in the bottom left corner, including a stylized 'M', a large circular signature, and another signature.

Handwritten signature and the number '11' in the bottom right corner.

A.S.L. n. 3 – Genovese DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA CLINICA  
Gara Sistemi di uso ospedaliero per la misurazione della glicemia. Prove di laboratorio su  
reflettometri e strisce

LOTTO 2

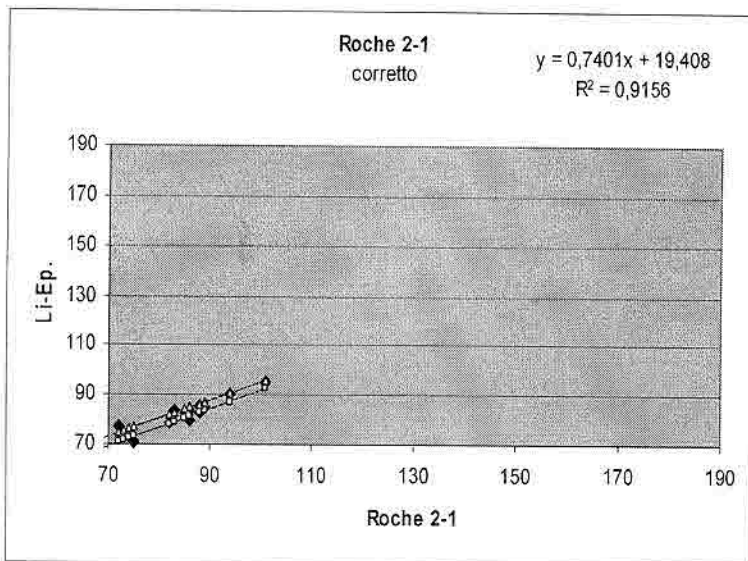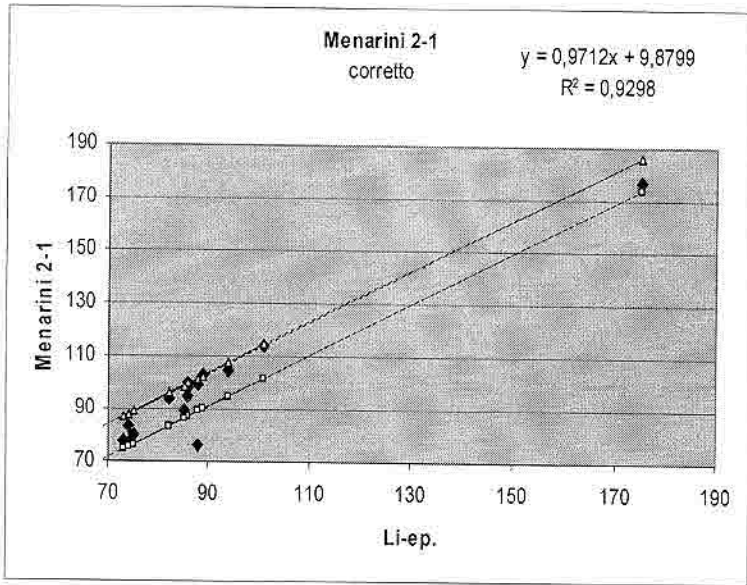

M  
J  
[Signature]

[Signature]  
12  
[Signature]

Nelle tabelle seguenti si illustrano i punteggi attribuiti

i. Pearson media	ROCHE				MENARINI				SVAS	
	LOTTO 1		LOTTO 2		LOTTO 1		LOTTO 2		LOTTO 1	
	str 1	str 2	str 1	str 2	str 1	str 2	str 1	str 2	str 1	str 2
	0,974	0,966	0,916	0,902	0,918	0,985	0,930	0,981	0,956	0,913
	<b>0,9695</b>		<b>0,9087</b>		<b>0,9515</b>		<b>0,9552</b>		<b>0,9345</b>	

### LOTTO 1

	ROCHE		MENARINI		SVAS	
	str 1	str 2	str 1	str 2	str 1	str 2
	coeff	0,974	0,966	0,918	0,985	0,956
media	<b>0.9695</b>		<b>0.9515</b>		<b>0.9345</b>	

### LOTTO 2

i. Pearson media	ROCHE		MENARINI	
	str 1	str 2	str 1	str 2
		0,916	0,902	0,930
	<b>0.9087</b>		<b>0.9552</b>	

Infine nelle tabelle che seguono si illustra il punteggio complessivo attribuito, per lotto a ciascuna ditta:


### PUNTEGGIO FINALE

	lotto 1		
	svas	menarini	roche
<b>precisione</b>		10	8
<b>accuratezza</b>		0	3
<b>correlazione</b>		11	11
<b>TOTALE</b>		<b>21</b>	<b>22</b>

	lotto 2	
	menarini	roche
<b>precisione</b>	10	10
<b>accuratezza</b>	3	8
<b>correlazione</b>	11	11
<b>TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>29</b>



Genova 16.1.2012

13



Centrale Regionale di Acquisto

Dirigente responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA



**Procedura aperta per la fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati (in ambito ospedaliero) occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre - Lotti n. 4.**

### SEDUTA PUBBLICA DEL 24.1.2012

#### Verbale di apertura delle offerte economiche e di aggiudicazione provvisoria

Il giorno ventiquattro del mese di Gennaio dell'anno duemiladodici, alle ore 14,30 presso la sala Riunioni della Centrale Regionale di Acquisto presso la Palazzina Uffici Amministrativi dell'Ospedale Villa Scassi, si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara della Centrale Regionale di Acquisto per la lettura delle idoneità tecniche, l'apertura delle offerte economiche e l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 della "Gara a procedura aperta per la fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati (in ambito ospedaliero) occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre - Lotti n. 4".

Sono presenti i Sigg.:

➤ DE MICHELI	Dott. Alberto	Presidente Commissione giudicatrice	Presidente del Seggio
➤ ZANELLA	Dott. Riccardo	Dirigente Centrale regionale di Acquisto	Componente
➤ GAGLILOLO	Ivo	Rappresentante Centrale Acquisti	Segretario

In rappresentanza delle Ditte partecipanti sono presenti i Signori:

D'Angelo Giovanna	Svas Biosana s.r.l.	
Bonora Elena, Maffei Alessandro	Roche Diagnostics s.p.a.	Munito di delega
Figus Federico	A.Menarini Diagnostics s.r.l.	
Rigo Romeo Andrea	Johnson & Johnson Medical s.p.a.	Munito di delega
Cheli Maurizio	Becton Dickinson	Munito di delega
	Benefis	

Saranno ammessi interventi dei rappresentati delle Ditta partecipanti, muniti di procura, solo al termine delle operazioni di lettura di tutte le offerte economiche presentate.

Consorzio Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Corso Scassi, 1 - 16149 Genova - C.F. e P.I. 01829030996

Tel +39 010 4102336 - Fax +39 010 4102417 - Sito web [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it)

*Handwritten initials: Z, M, G*

## Centrale Regionale di Acquisto

Vengono letti ai presenti gli esiti (punteggio totale) delle valutazioni tecniche concernenti i prodotti offerti in gara. Le valutazioni tecniche sono agli atti nei verbali del 13/6/2011 (prot. n. 901-2011) e del 16/1/2012 (prot. n. 59-2012) e perciò

Lotto n. 1

	A Valore range ematocrito	B Assenza interferenze	C1 Precisione	C2 Accuratezza	C3 Correlazione lineare	D Sicurezza e igienicità per operatori	E Conversione dei valori	Totale
A. Menarini	5	10	8	3	11	5	5	<b>47/60</b>
SVAS	0	10	10	0	11	5	5	<b>41/60</b>
Roche	5	5	8	0	11	5	5	<b>39/60</b>

Lotto 2

	A Gestione interferenze	B1 Precisione	B2 Accuratezza	B3 Correlazione lineare	C Sicurezza e igienicità per operatori	D Conversione dei valori	Totale
A. Menarini	15	10	3	11	5	5	<b>49/60</b>
Roche	5	10	8	11	0	5	<b>39/60</b>

Lotto 3

	A Variazione profondità penetrazione	B Praticità d'uso	C Presenza assenza lattice	D Sicurezza per operatori	Totale
Roche Diagnostics	20	5	5	10	<b>40/40</b>
Becton Dickinson	10	4	5	5	<b>24/40</b>
Benefis	20	4	5	5	<b>34/40</b>
Johnson & Johnson	0	5	5	10	<b>20 Non idoneo</b>



## Centrale Regionale di Acquisto

Lotto 4

	A Praticità d'uso	B Presenza assenza lattice	C Sicurezza per operatori	D Sicurezza Per pazienti	Totale
Roche Diagnostics	5	5	15	15	<b>40/40</b>

Il Presidente invita le ditte presenti a designare tra di loro un rappresentante per la verifica dell'integrità del plico contenente le offerte economiche e le singole buste.

Viene designata Bonora Elena la quale procede alla verifica dei plichi senza nulla rilevare al riguardo.

Si passa quindi all'apertura delle offerte economiche delle Ditte ammesse al prosieguo della gara, i cui prodotti sono stati giudicati idonei dalla Commissione giudicatrice. Non viene perciò aperta l'offerta presentata da Johnson & Johnson (riferita soltanto al lotto n. 3)

Il Presidente, prima di procedere all'apertura delle offerte economiche ricorda che la base d'asta per i lotti 1 e 2 era 0,15 cc di Euro; per il terzo lotto era 0,08 cc di Euro; per il quarto lotto era di 0,30 cc di Euro. Offerte economiche superiori a detta base saranno ritenute inammissibili ed escluse.

Il Presidente del Seggio di gara da' lettura delle offerte economiche presentate da ciascuna ditta procedendo per singolo lotto. Viene calcolato al termine della lettura dei prezzi il relativo punteggio con la formule previste nel disciplinare di gara

per i lotti n. 1 e n. 2:

□ **PREZZO: massimo punti 40**, secondo la seguente formula:  

$$p = (40 \times P_m) / P$$

(p = punteggio;  
P = prezzo dell'offerta presa in considerazione;  
Pm = prezzo dell'offerta più bassa)

per i lotti n. 3 e n. 4:

□ **PREZZO: massimo punti 60**, secondo la seguente formula:  

$$p = (60 \times P_m) / P$$

(p = punteggio;  
P = prezzo dell'offerta presa in considerazione;  
Pm = prezzo dell'offerta più bassa)

I prezzi offerti e i punteggi relativi al prezzo sono riportati nella tabella che segue

Lotto n. 1

	Punteggio tecnico	Prezzo offerto	Punteggio relativo al prezzo	Punteggio totale
A.Menarini	<b>47/60</b>	0.135	<b>40,00</b>	<b>87.00</b>
SVAS	<b>41/60</b>	0.139	<b>38.85</b>	<b>79.85</b>
Roche	<b>39/60</b>	0.145	<b>37.24</b>	<b>76.24</b>

*offerta economica allegata*

Lotto 2

	Punteggio tecnico	Prezzo offerto	Punteggio relativo al prezzo	Punteggio totale	
A.Menarini	<b>49/60</b>	0.135	<b>40.00</b>	<b>89.00</b>	Offerta Anomala
Roche	<b>39/60</b>	0.150	<b>36.00</b>	<b>75.00</b>	

*offerta anomala allegata*Lotto 3

	Punteggio tecnico	Prezzo offerto	Punteggio relativo al prezzo	Punteggio totale	
Roche Diagnostics	<b>40</b>	0.045	<b>60.00</b>	<b>100.00</b>	Offerta Anomala
Becton Dickinson	<b>24</b>	0.079	<b>34.18</b>	<b>58.18</b>	
Benefis	<b>34</b>	0.062	<b>43.55</b>	<b>77.55</b>	

*offerta anomala allegata*Lotto 4

	Punteggio tecnico	Prezzo offerto	Punteggio relativo al prezzo	Punteggio totale	
Roche Diagnostics	<b>40</b>	0.045	<b>60.00</b>	<b>100.00</b>	Offerta Anomala

*offerta anomala allegata*

Risultano pertanto i seguenti aggiudicatari in via provvisoria

LOTTO	Aggiudicatario in via provvisoria
1	A.Menarini
2	A.Menarini
3	Roche Diagnostics
4	Roche Diagnostics


Vengono comunicate altresì le offerte comprese nella soglia di anomalia secondo quanto previsto dall'articolo 121 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

*A m g g*

## Centrale Regionale di Acquisto

La seduta ha termine alle ore 15.10.

## I Componenti della Commissione giudicatrice

Dott. DE MICHELI Alberto		Presidente
Dott. Riccardo ZANELLA		Componente
Sig. Ivo GAGLIOLO		Componente e segretario

**ALLEGATO F2 - OFFERTA ECONOMICA**

**Procedura aperta per la fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati (in ambito ospedaliero) occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre**

**Lotto 1: Sistema per la misurazione della glicemia capillare su soggetto adulto in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive)**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	NUMERO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI	CODICE CND	PREZZO A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (EURO)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER 3 ANNI (N. STRISCE)	PREZZO OFFERTO A STRISCE IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (GxH) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
LOTTO 1	striscia reattiva:	40493	Non applicabile	W0101060101	0,150	5.911.500	0,135	€ 798.052,50	Settecentonovantottomila cinquantadue/50
	glucometro:	41278	Non applicabile	W0201060102					

offerta n° 5014/CG del 09/12/2010

Nota 1: il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta e dovrà essere indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali

Nota 2: il prezzo offerto include anche la fornitura di n. 1.160 glucometri in comodato d'uso gratuito

Nota 3: La fornitura comprende l'invio a titolo gratuito dei controlli di qualità cod. 40494, 41548 e 40496 e delle batterie cod. 32323 necessarie ai glucometri.

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.  
PAOLO ISIPORI  
(Procuratore Speciale)



**ALLEGATO F2 - OFFERTA ECONOMICA**

**Procedura aperta per la fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati (in ambito ospedaliero) occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre**

**Lotto 2: Sistema per la misurazione della glicemia capillare su soggetto in età neonatale in ambito ospedaliero (glucometro + strisce reattive)**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	NUMERO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI	CODICE CND	PREZZO A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (EURO)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER 3 ANNI (N. STRISCE)	PREZZO A OFFERTA A STRISCE IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (GxH) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA	
LOTTO 2										
	striscia reattiva:	40493	Non applicabile	W0101060101	0,150	76.500	0,135	€ 10.327,50	Diecimilatrecentoventisette/50	
	glucometro:	41278	Non applicabile	W0201060102	n. 49 offerti in comodato d'uso gratuito					

offerta n° 5014/CG del 09/12/2010

Nota 1: il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta e dovrà essere indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali

Nota 2: il prezzo offerto include anche la fornitura di n. 49 glucometri in comodato d'uso gratuito

Nota 3: La fornitura comprende l'invio a titolo gratuito dei controlli di qualità cod. 40494, 41548 e 40496 e delle batterie cod. 32323 necessarie ai glucometri.

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.  
 PAOLO SIDOKI  
 (Procuratore Speciale)



**ALLEGATO F2 - OFFERTA ECONOMICA**

**Procedura aperta per la fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati (in ambito ospedaliero) occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre**

**Lotto 3: Dispositivo monouso per l'esecuzione del prelievo capillare per la misurazione della glicemia su soggetto adulto in ambito ospedaliero**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	NUMERO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI	CODICE CND	PREZZO A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (EURO)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER 3 ANNI (N. DISPOSITIVI)	PREZZO OFFERTO IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (GxH) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
LOTTO 3	ACCU-CHEK SAFE T-PRO PLUS	03603539150	59342/R	V0104	0,080	4.578.000	0,045	206.010,00	duecentoseimiladieci/ 00

offerta n° 24184/10/PJ2

del 01/ 12/ 2010

Nota 1: il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta e dovrà essere indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

**ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.**

**IL PROCURATORE**  
**Massimo Balestri**

**IL PROCURATORE**  
*Pier Giuseppe Maria Costanzo*





**ALLEGATO F2 - OFFERTA ECONOMICA**

**Procedura aperta per la fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati (in ambito ospedaliero) occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre**

**Lotto 4: Dispositivo monouso con lama a scatto per l'esecuzione del prelievo capillare dal tallone nei neonati e prematuri**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
LOTTO 4	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	NUMERO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI	CODICE CND	PREZZO A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (EURO)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER 3 ANNI (N. DISPOSITIVI)	PREZZO OFFERTO IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (GxH) IN EURO	IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE IVA ESCLUSA
	ACCU-CHEK SAFE T-PRO PLUS	03603539150	59342IR	V0104	0,300	141.000	0,045	6.345,00	seimilatrecentoquarantacinque/00

offerta n° 24184/ 10/ P.J2

del 01/ 12/ 2010

Nota 1: il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta e dovrà essere indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali

**TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE**

**ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.**

**IL PROCURATORE**  
 Massimo Balestri

**IL PROCURATORE**  
 Pier Giuseppe Maria Costanzo

