



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di Radioprotezione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti 8, gara n. 8314394 – Aggiudicazione Lotti 1-2-3-4-6-7
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente	Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante	Luigi Moreno COSTA
Responsabile Procedimento	Luigi Moreno COSTA
Dirigente Responsabile	Luigi Moreno COSTA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub / dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 recante "Disciplina delle attività contrattuali regionali" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante la "razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione", il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;
- il decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.", convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108;
- l'articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
- il decreto legislativo . 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante "Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 23 dicembre 2021 recante “Programmazione della Stazione Unica Appaltante Regionale e delle sue articolazioni funzionali per l’anno 2022”;

PREMESSO CHE:

- con decreto del Dirigente n. 6245 del 15/10/2021, rettificato con successivi decreti del Dirigente n. 6826-2021 del 08/11/2021 e n. 7366 del 01/12/2021, veniva indetta la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di Sistemi di radioprotezione occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per ulteriori anni uno), lotti n. 8, numero gara 8314394;
- dal verbale di apertura della documentazione amministrativa in data 11/01/2022 (Prot-2022-0026504 del 14/01/2022 – All. 1), già pubblicato sulla piattaforma Sintel e sul Sito Web www.acquistiliguria.it, risultano aver presentato offerta i seguenti operatori economici:

CONCORRENTE	Partita IVA	N. protocollo informatico Sintel
Bericah S.p.A.	00899910244	1639750617429
Cea S.p.A.	08548300154	1639760080343
Chemil S.r.l.	02518990284	1640178357249
Clini-lab s.r.l.	01857820284	1640157811068
Microteck Italy S.r.l.	00352000293	1639421562421
Sago Medica S.rl.	01122350380	1640095245180
Servizi Ospedalieri S.p.A.	00615530672	1640093057937

VISTI ALTRESÌ:

- il decreto del Dirigente n. 2048 del 01/04/2022 con il quale veniva disposta l’esclusione alle successive fasi della procedura di gara in oggetto del concorrente Servizi Ospedalieri S.r.l. e l’ammissione alle successive fasi di gara degli ulteriori concorrenti e precisamente:

n.	CONCORRENTE	Lotti
1	Bericah S.p.A.	6
2	Cea S.p.A.	1-2-3-4-5-6
3	Chemil S.r.l.	6
4	Clini-lab s.r.l.	1-4-6
5	Microteck Italy S.r.l.	7
6	Sago Medica S.rl.	1-2-3-8

- il decreto n. 4113 del 01/07/2022, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, veniva disposta la riammissione alle successive fasi di gara del concorrente Servizi Ospedalieri S.r.l. per i lotti 1-2-3 e 8;
- il decreto n. 6536 del 06/06/2022, con il quale si nominava la Commissione giudicatrice nelle persone della Dott.ssa Franca Foppiano (Presidente), del Dott. Giulio Bovio e dell’Ing. Alessandro Gallo (componenti);

PRESO ATTO dei verbali delle sedute pubbliche di apertura delle buste tecniche, rispettivamente avvenute in data 16/06/2022 (Prot-2022-0418949 del 17/06/2022 – All. 2) e 22/12/2022 (Prot-2022-0634457 del 29/07/2022 – All. 3), del verbale della seduta riservata relativo alla valutazione tecnica del lotto 8 da parte della Commissione Giudicatrice (Prot-2023-0054853 del 16/01/2023 – All.4) già pubblicati sulla piattaforma Sintel e sul Sito Web www.acquistiliguria.it e dei verbali delle sedute riservate di valutazione dei lotti da 1 a 7 (Prot-2023-0054789 del 16/01/2023; Prot-2023-0054799 del 16/01/2023; Prot-2023-0054802 del 16/01/2023; Prot-2023-0054805 del 16/01/2023; Prot-2023-0054810 del 16/01/2023; Prot-2023-0054823 del 16/01/2023; Prot-2023-0054834 del 16/01/2023; Prot-2023-0054843 del 16/01/2023; Prot-2023-0318326 del 30/03/2023; Prot-2023-0318342 del 30/03/2023; Prot-2023-0318367 del 30/03/2023; Prot-2023-0318847 del 30/03/2023 – All.ti da n. 5 a n. 16) e del verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche dei lotti da 1 a 7 avvenuta in data 30/03/2023 (Prot-2023-0328890 del 05/04/2023 – All. 17);

ACQUISITA al protocollo S.U.A.R., con progressivo Prot-2022-0405582, in data 08/06/2022, la comunicazione della Ditta Microtek Italy S.r.l. relativa alla fusione per incorporazione, avvenuta in data 05/04/2022, ma con efficacia differita a decorrere dal 1° luglio 2022, di Microtek Italy S.r.l., con socio unico, codice fiscale e P. IVA n. 00352000293 in Ecolab S.r.l. con socio unico, codice fiscale n. 01309350062, P.IVA 08938260158 (atto notarile n. 26823 di Repertorio);

RILEVATO che la Società Ecolab S.r.l. risulta regolarmente registrata presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (numero di registro n. 01309350062), come da visura camerale acquisita agli atti del procedimento;

DATO ATTO che la Società Ecolab S.r.l. ha prodotto la necessaria documentazione amministrativa in cui viene dichiarato il possesso di tutti i requisiti necessari per partecipare alla procedura in oggetto e che i competenti Uffici di S.U.A.R. hanno eseguito i controlli sul possesso dei requisiti morali ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, necessario, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, prendere atto della fusione per incorporazione di Microtek Italy S.r.l. in Ecolab S.r.l.;

VISTO il decreto n.1649 del 13/03/2023 con il quale si disponeva l'aggiudicazione del lotto 8 a favore di SAGO MEDICA S.r.l.;

DATO ATTO, a fronte delle risultanze riportate nei suddetti verbali, della seguente proposta di graduatoria di merito, risultante dalla sommatoria dei punteggi assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica:

Lotto CIG	Ditta concorrente	Punteggio offerta tecnica (max 70 pt)	Prezzi offerti (importo triennale IVA esclusa)	Punteggio offerta economica (max 30 pt.)	Punteggio Totale
LOTTO 1 Dispositivi di protezione degli	Cea S.p.A.	51,46	209.422,78	11,12	62,58
	Clini-lab S.r.l.	47,18	204.271,00	15,04	62,22

operatori: GREMBIULI INTERI CIG 8938101248	Sago Medica S.r.l.	70,00	205.652,62	13,99	83,99
	Servizi ospedalieri S.r.l	55,72	134.875,00	30,00	85,72
LOTTO 2 Dispositivi di protezione degli operatori: GREMBIULI SPEZZATI CIG 8938115DD2	Cea S.p.A.	53,41	262.265,20	9,77	63,18
	Sago Medica S.r.l.	70,00	235.771,00	25,01	95,01
	Servizi ospedalieri S.r.l	50,85	198.890,00	30,00	80,85
LOTTO 3 Dispositivi di protezione degli operatori: COLLARI CIG 893812346F	Cea S.p.A.	70,00	38.983,518	8,73	78,73
	Sago Medica S.r.l.	66,36	32.332,05	25,90	92,26
	Servizi ospedalieri S.r.l	60,20	24.396,55	30,00	90,20
LOTTO 4 Occhiali a protezione radiazioni ionizzanti CIG 8938140277	Cea S.p.A.	70,00	117.821,00	25,33	95,33
	Clini-lab S.r.l.	57,77	131.255,00	13,95	71,72
	Sago Medica S.r.l.	66,73	98.489,80	30,00	96,73
LOTTO 5 Dispositivi di protezione dei pazienti CIG 8938152C5B	DESERTO				
LOTTO 6 Guanti attenuatori di radiazioni ionizzanti monouso CIG 8938172CDC	Bericah S.p.A.	67,68	227.604,00	30,00	97,68
	Cea S.p.A.	70,00	260.685,00	17,33	87,33
	Chemil S.r.l.	70,00	268.500,00	0	70,00
	Clini-lab S.r.l.	68,44	268.500,00	0	68,44
LOTTO 7 Teli anti X diffusa sterili per la protezione dell'operatore CIG 8938189AE4	Ecolab S.r.l. r.l. (già Microteck Italy S.r.l.)	70,00	64.260,00	30,00	100,00

DATO ATTO che tutti i verbali citati, vengono integralmente allegati in copia al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, unitamente al dettaglio delle offerte economiche dei rispettivi aggiudicatari dei Lotti;

PRESO INFINE ATTO dell'esito positivo della verifica dell'anomalia delle offerte di Sago Medica in relazione ai Lotti 2, 3 e 4 e Bericah S.p.A. in relazione al Lotto 6;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. **DI PRENDERE ATTO** della fusione per incorporazione di Microtek Italy S.r.l. (PIVA 00352000293) in Ecolab S.r.l. (PIVA 08938260158) - con sede legale a Milano in Piazza F. Meda, 3 - di cui all'atto di fusione Repertorio N. 26823 e Raccolta N. 13881, del 05/04/2022 Notai C. Bignami e P. Donati in Milano, trasmesso a mezzo piattaforma Sintel ID 157.646.998;
2. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** i verbali di gara allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. **DI PROCEDERE** alla aggiudicazione della procedura di gara in oggetto secondo lo schema seguente:

Lotto CIG	Graduatoria	Ditta concorrente	Prezzi offerti (importo triennale IVA esclusa)
LOTTO 1 Dispositivi di protezione degli operatori: GREMBIULI INTERI CIG 8938101248	1	Servizi ospedalieri S.r.l	134.875,00
	2	Sago Medica S.r.l.	205.652,62
	3	Cea S.p.A.	209.422,78
	4	Clini-lab S.r.l.	204.271,00
LOTTO 2 Dispositivi di protezione degli operatori: GREMBIULI SPEZZATI CIG 8938115DD2	1	Sago Medica S.r.l.	235.771,00
	2	Servizi ospedalieri S.r.l	198.890,00
	3	Cea S.p.A.	262.265,20
LOTTO 3 Dispositivi di protezione degli operatori: COLLARI CIG 893812346F	1	Sago Medica S.r.l.	32.332,05
	2	Servizi ospedalieri S.r.l.	24.396,55
	3	Cea S.p.A.	38.983,518
LOTTO 4 Occhiali a protezione radiazioni ionizzanti CIG 8938140277	1	Sago Medica S.r.l.	98.489,80
	2	Cea S.p.A.	117.821,00
	3	Clini-lab S.r.l.	131.255,00
LOTTO 5	DESERTO		

Dispositivi di protezione dei pazienti CIG 8938152C5B			
LOTTO 6 Guanti attenuatori di radiazioni ionizzanti monouso CIG 8938172CDC	1	Bericah S.p.A.	227.604,00
	2	Cea S.p.A.	260.685,00
	3	Chemil S.r.l.	268.500,00
	4	Clini-lab S.r.l.	268.500,00
LOTTO 7 Teli anti X diffusa sterili per la protezione dell'operatore CIG 8938189AE4	1	Ecolab S.r.l. .r.l. (già Microteck Italy S.r.l.)	64.260,00

4. DI DARE ATTO CHE:

- l'aggiudicazione diventerà efficace successivamente all'espletamento dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la convenzione diventerà efficace all'esito positivo dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la garanzia definitiva da prestare da parte degli aggiudicatari è determinata nei seguenti importi:

Ditta	Lotto/Lotti	Importo totale triennale in Euro	Importo garanzia definitiva in Euro (10%)
Servizi ospedalieri S.r.l	1	134.875,00	13.487,50
Sago Medica S.r.l.	2 - 3 - 4	366.592,85	36.659,28
Bericah S.p.A.	6	227.604,00	22.760,40
Ecolab S.r.l. .r.l. (già Microteck Italy S.r.l.)	7	64.260,00	6.426,00

5. **DI DARE ATTO** che la convenzione da sottoscrivere con le Ditte aggiudicatarie sarà redatta in base allo schema tipo approvato con la deliberazione di indizione, mentre gli OdF saranno emessi dalle Amministrazioni utilizzatrici tramite il NECA;

6. **DI PROVVEDERE** alla notifica del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;

7. **DI DISPORRE** la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, sulle seguenti testate e siti informatici:

a) in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea,

b) per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui seguenti quotidiani e siti informatici:

- Il Messaggero nell'edizione nazionale
- Il Mattino nell'edizione nazionale
- Repubblica ed. Genova
- Il Giornale della Liguria


c) Osservatorio appalti Regione Liguria

d) Sito web ANAC (www.anticorruzione.it)

e) Sito Web www.acquistiliguria.it

8. DI DARE ATTO che al pagamento delle spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, da quantificarsi successivamente, si provvederà con separato provvedimento e che le spese di pubblicazione saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dalla Società aggiudicataria della procedura ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 221.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 e al d.lgs. n. 104/2010.



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE



Genova,

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Allegati:

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti – Dott.ssa Paola Gerbino

gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di Radioprotezione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti 8, Importo presunto di gara: € 1.311.066,24 (Iva esclusa), gara n. 8314394. ID Sintel 146672404

SEDUTA PUBBLICA IN STREAMING
Verbale di apertura della documentazione amministrativa

Il giorno 11/01/2022, alle ore 11:08 presso Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, si è riunito in seduta pubblica via streaming, il Seggio di gara per l'apertura della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti nella procedura indicata in epigrafe, numero gara 8314394.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto del Dirigente n. 30 del 10/01/2022, risulta composto dai Signori:

Dott. Luigi Moreno Costa	Dirigente Amm.vo della S.U.A.R. R.U.P. e Presidente
Dott.ssa Paola Gerbino	Funzionario amm.vo della S.U.A.R. Componente
Sig.ra Loredana Lotti	Funzionario amm.vo della S.U.A.R. Componente e Segretario

A causa di impedimento, nella seduta odierna, la Dott.ssa Paola Gerbino, così come previsto nel Decreto sopra indicato, è sostituita dalla Dott.ssa Martina Canepa, Funzionario amm.vo della S.U.A.R.

Svolge le funzioni di Ufficiale Rogante della Centrale il Dott. Mauro Vestri, Funzionario amministrativo di Regione Liguria (nominato con Decreti del Direttore Generale n. 3306 del 28/05/2021 e n. 3725 del 16/06/2021), mentre partecipa alla seduta il Sig. Alessandro Valdiserri di SUAR, per l'assistenza tecnico-informatica.

Preso atto delle misure restrittive adottate a livello nazionale e locale volte al contenimento della diffusione del virus Covid-19, al fine comunque di assicurare la pubblicità della presente seduta e come già anticipato a mezzo avviso prot. n. 2022-0012568 del 10/01/022, gli operatori economici interessati potranno assistere alla diretta streaming delle operazioni di gara accedendo da remoto al link indicato nel suddetto avviso.

Il Presidente del Seggio di gara/RUP dà preliminarmente atto che, con Decreto del Dirigente n. 6245-2021 del 15/10/2021, rettificato con successivi decreti del Dirigente n. 6826 del 08/11/2021 2 n. 7366 del 01/12/2021, si è proceduto all'indizione della gara di cui in epigrafe, nonché a fissare il termine per la presentazione delle offerte alle ore 17:00 del 22/12/2021 e la data della seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa, fissata alle ore 11:00 del 11/01/2022.

Il Presidente del Seggio di gara rileva che entro il termine delle ore 17:00 del 22/12/2021, fissato dal Disciplinare di gara rettificato, risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, a livello multilotto, le offerte delle seguenti Ditte concorrenti:

CONCORRENTE	Partita IVA	N. protocollo informatico Sintel
Bericah S.p.A.	00899910244	1639750617429
Cea S.p.A.	08548300154	1639760080343
Chemil S.r.l.	02518990284	1640178357249
Clini-lab s.r.l.	01857820284	1640157811068
Microteck Italy S.r.l.	00352000293	1639421562421
Sago Medica S.rl.	01122350380	1640095245180
Servizi Ospedalieri S.p.A.	00615530672	1640093057937

Il Presidente, supportato dal Seggio di gara, operando attraverso il Sistema, procede per ciascuna Ditta concorrente, alle seguenti verifiche sulla piattaforma SINTEL secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara:

- Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate, nonché della validità della firma digitale apposta;
- Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei sotto riportati documenti richiesti nella Documentazione amministrativa dalla lex specialis:

a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)	
b) DGUE (come da modello M-2)	
c) versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)	
d) garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente	
e) impegno del fideiussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;	
f) Documento PASSOE firmato digitalmente ;	
g) Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.7)	
h) (eventuale) procura	
i) (eventuale) certificazioni riduzione cauzione	
j) (eventuale) referenze bancarie	
k) (eventuale) documentazione relativa all'avvalimento	
l) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio firmati digitalmente ;	
m) F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)	
n) Patto d'integrità	

come da report generato dalla Piattaforma Sintel allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Al termine delle operazioni il Presidente del Seggio dà atto che, per tutte le Ditte offerenti, risultano conformi:

- la ricezione delle offerte presentate,
- la validità della firma digitale rispettivamente apposta;
- la presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa dalla lex specialis di gara

Successivamente, in seduta riservata, il Seggio di Gara procederà alla verifica del contenuto dei documenti amministrativi prodotti dagli Offerenti al fine di valutarne la conformità alle prescrizioni del Disciplinare di Gara e, pertanto, l'ammissibilità degli offerenti alle successive fasi di gara. Di dette operazioni verrà redatto apposito verbale e sarà data comunicazione agli offerenti (ammessi ed esclusi) ai sensi dell'art. 76, comma 2bis. D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.


Alle ore 11:19 il Presidente, dopo aver rilevato e dichiarato che sono stati 13 i collegamenti alla seduta odierna in diretta streaming sul canale youtube e avendo il Seggio esaurito gli adempimenti previsti dalla lex specialis di gara nella presente fase, dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il presente Verbale, composto da 4 (quattro) pagine compreso l'allegato, è rassegnato agli atti di gara e verrà pubblicato sulla piattaforma Sintel nella sezione "Documentazione di gara" raggiungibile all'indirizzo www.ariaspa.it e sul profilo del committente www.acquistiliguria.it


La registrazione della seduta pubblica è comunque consultabile sul canale you tube di S.U.A.R..

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
Dott. Luigi Moreno Costa

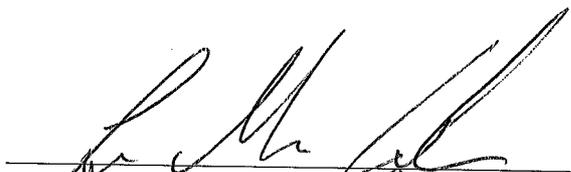


Componente/Segretario
Sig.ra Loredana Lotti



Componente
Dott.ssa Martina Canepa



Ufficiale Rogante
Dott. Mauro Vestri





REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE
SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti - Dott.ssa Paola Gerbino

gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di Radioprotezione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti 8, Importo presunto di gara: € 1.311.066,24 (Iva esclusa), gara n. 8314394. ID Sintel 146672404

SEDUTA PUBBLICA IN STREAMING
Verbale di apertura della documentazione tecnica

Il giorno 16/06/2022, alle ore 12.10 presso Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, si è riunito in seduta pubblica via streaming, il Seggio di gara per l'apertura della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti nella procedura indicata in epigrafe.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto del Dirigente n. 30 del 10/01/2022, risulta composto dai Signori:

Dott. Luigi Moreno Costa	Dirigente Amm.vo della S.U.A.R. R.U.P. e Presidente
Dott.ssa Paola Gerbino	Funzionario amm.vo della S.U.A.R. Componente
Sig.ra Loredana Lotti	Funzionario amm.vo della S.U.A.R. Componente e Segretario

A causa di impedimento, nella seduta odierna, la Sig.ra Loredana Lotti, così come previsto nel Decreto sopra indicato, è sostituita dalla Dott.ssa Martina Canepa, Funzionario amm.vo della S.U.A.R.

Svolge le funzioni di Ufficiale Rogante della Centrale il Dott. Mauro Vestri, Funzionario amministrativo di Regione Liguria (nominato con Decreti del Direttore Generale n. 3306 del 28/05/2021 e n. 3725 del 16/06/2021), mentre partecipa alla seduta il Sig. Alessandro Valdiserri di SUAR, per l'assistenza tecnico-informatica.

E' altresì presente la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto n. 3536 del 06/06/2022, nelle persone di:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott.ssa Franca Foppiano	ASL 5	Direttore S.C. Fisica sanitaria Dip. Oncologico
Componente	Dott. Giulio Bovio	Polielinico San Martino	Dirigente medico U.O. Radiologia interventistica
Componente	Ing. Alessandro Gallo	ASL 3	Responsabile SPP

Si precisa che il dott. Giulio Bovio è presente in connessione da remoto mediante applicazione Skype.

Si dà atto che, come già anticipato a mezzo avviso Prot-2022-0413673 del 14/06/2022, pubblicato sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale, gli operatori economici interessati possono presenziare alla seduta odierna o assistere alla diretta streaming delle operazioni di gara accedendo da remoto al link indicato nel suddetto avviso.

Il Presidente del Seggio di gara/RUP dà preliminarmente atto che, con Decreto del Dirigente n. 2048-2022 del 01/04/2022, si è disposta l'esclusione alle successive fasi della procedura di gara del concorrente Servizi Ospedalieri S.r.l. e l'ammissione degli ulteriori concorrenti e precisamente:

N.	OPERATORE ECONOMICO	LOTTE	STATO
1	Bericah S.p.A.	6	AMMESSA
2	Cea S.p.A.	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	AMMESSA
3	Chemil S.r.l.	6	AMMESSA
4	Clini-lab s.r.l.	1 - 4 - 6	AMMESSA
5	Microteck Italy S.r.l.	7	AMMESSA
6	Sago Medica S.r.l.	1 - 2 - 3 - 4 - 8	AMMESSA

Il Presidente/RUP precisa che avverso detto decreto il concorrente Servizi Ospedalieri S.r.l. ha presentato ricorso, nanti al TAR Liguria, e si è in attesa della pronuncia del Giudice. Pertanto, ci si riserva gli eventuali adempimenti a seguito della decisione del Giudice.

Il Presidente del Seggio comunica che nel corso della seduta pubblica si procederà anzitutto a verificare, tramite piattaforma Sintel, la presenza sul sistema dei documenti componenti l'offerta tecnica richiesti dal Disciplinare di Gara. Pertanto, non verrà visionato il contenuto dei singoli documenti prodotti che sarà esaminato dalla Commissione Giudicatrice in successive sedute riservate.

Il Disciplinare di Gara prevedeva i seguenti documenti costituenti l'offerta tecnica:

1. Offerta tecnica – Allegato M-5 Dichiarazione e questionario tecnico
2. Scheda Tecnica prodotto offerto
3. Certificazione CE
4. Dichiarazione di impegno/disponibilità aggiornamenti tecnologici - Allegato M-4
5. Offerta economica Silente
6. Dichiarazione di secretazione offerta tecnica – Allegato M-8

7. breve relazione in ordine alla proposta di formazione del personale utilizzatore sull'impiego dei DPI nell'apposito campo "cordi di informazioni/formazione".

Il Seggio di Gara, alla presenza della Commissione Giudicatrice, procede, quindi, per tutti i lotti di gara, all'apertura sulla piattaforma telematica Sintel delle buste contenenti la documentazione tecnica prodotta dalle Ditte partecipanti ammesse a questa fase.

Il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice rilevano che, per tutte le Ditte offerenti, è regolarmente presente la documentazione tecnica richiesta dal disciplinare di gara.

Il RUP della gara, dopo aver dato atto che, nel corso della presente seduta, il canale youtube di SUAR dove si è svolta la diretta ha registrato ^{4 u} visualizzazioni, dichiara tolta la seduta alle ore 12.21.

Il presente Verbale, composto da n. 3 (tre) pagine, sarà pubblicato sulla piattaforma Sintel, nell'area documentazione di gara, nonché sul sito istituzionale www.acquistiliguria.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Commissione giudicatrice

Presidente

Dott.ssa Franca Foppiano



Dott. Giulio Bovio



Ing. Alessandro Gallo




Presidente

Dott. Luigi Moreno Costa



Componente/Segretario

Dott.ssa Paola Gerbino




Componente


Dott.ssa Martina Canepa



Ufficiale Rogante

Dott. Mauro Vestri





REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti – Dott.ssa Paola Gerbino

gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di Radioprotezione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti 8, Importo presunto di gara: € 1.311.066,24 (Iva esclusa), gara n. 8314394. ID Sintel 146672404

**SEDUTA PUBBLICA IN STREAMING
Verbale di apertura della documentazione tecnica**

Il giorno 21/07/2022, alle ore 10,57 presso Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, 2° piano - si è riunito in seduta pubblica anche via streaming, il Seggio di gara per l'apertura della documentazione tecnica presentata dalla Ditta Servizi Ospedalieri concorrente alla procedura indicata in epigrafe.

Il Seggio di gara, nominato con Decreto del Dirigente n. 30 del 10/01/2022, risulta composto dai Signori:

Dott. Luigi Moreno Costa	Dirigente Amm.vo della S.U.A.R. R.U.P. e Presidente
Dott.ssa Paola Gerbino	Funzionario amm.vo della S.U.A.R. Componente
Sig.ra Loredana Lotti	Funzionario amm.vo della S.U.A.R. Componente e Segretario

La Dott.ssa Paola Gerbino, assente giustificata, così come previsto nel Decreto sopra indicato, è sostituita dalla Dott.ssa Martina Canepa, Funzionario amm.vo della S.U.A.R.

Svolge le funzioni di Ufficiale Rogante della Centrale il Dott. Valter Borrello, Funzionario amministrativo di Regione Liguria (nominato con Decreti del Direttore Generale n. 3306 del 28/05/2021 e n. 3725 del 16/06/2021), mentre partecipa alla seduta il Sig. Alessandro Valdiserri di SUAR, per l'assistenza tecnico-informatica.

E' altresì presente la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto n. 3536 del 06/06/2022, nelle persone di:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott.ssa Franca Foppiano	ASL 5	Direttore S.C. Fisica sanitaria Dip. Oncologico
Componente	Dott. Giulio Bovio	Policlinico San Martino	Dirigente medico U.O. Radiologia interventistica
Componente	Ing. Alessandro Gallo	ASL 3	Responsabile SPP

Come già anticipato a mezzo avviso Prot-2022-0517080 del 19/07/2022, pubblicato sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale, gli operatori economici interessati possono presenziare alla seduta odierna o assistere alla diretta streaming delle operazioni di gara accedendo da remoto al link indicato nel suddetto avviso.

Il Presidente del Seggio dà atto che nessuno degli OO. EE. interessati partecipa in presenza all'odierna seduta.

Il Presidente del Seggio di gara/RUP dà preliminarmente atto che:

- con decreto del Dirigente n. 2048 del 01/04/2022 veniva disposta l'esclusione alle successive fasi della procedura di gara in oggetto del concorrente Servizi Ospedalieri S.r.l. e l'ammissione alle successive fasi di gara degli ulteriori concorrenti;
- con Decreto 4113-2022, in ossequio a quanto disposto dal TAR Liguria in riferimento ai ricorsi proposti dal concorrente Servizi ospedalieri S.r.l., la SUAR stabiliva l'annullamento del decreto sopraccitato, limitatamente alla parte in cui disponeva l'esclusione del concorrente Servizi ospedalieri S.r.l. e la conseguente riammissione dello stesso alle successive fasi di gara.

Il Presidente del Seggio comunica che, conformemente alla pronuncia del Giudice, nel corso della seduta pubblica si procederà a verificare, tramite piattaforma Sintel, la presenza, nell'offerta tecnica della Ditta Servizi Ospedalieri S.r.l, dei documenti richiesti dal Disciplinare di Gara. Pertanto, non verrà visionato il contenuto dei singoli documenti prodotti che sarà esaminato dalla Commissione Giudicatrice in successive sedute riservate.

Il Disciplinare di Gara prevedeva i seguenti documenti costituenti l'offerta tecnica:

1. Offerta tecnica – Allegato M-5 Dichiarazione e questionario tecnico
2. Scheda Tecnica prodotto offerto
3. Certificazione CE
4. Dichiarazione di impegno/disponibilità aggiornamenti tecnologici - Allegato M-4
5. Offerta economica Silente
6. Dichiarazione di secretazione offerta tecnica – Allegato M-8
7. breve relazione in ordine alla proposta di formazione del personale utilizzatore sull'impiego dei DPI nell'apposito campo "corsi di informazione/formazione".

Il Seggio di Gara, alla presenza della Commissione Giudicatrice, procede, quindi, per tutti i lotti di gara partecipati dal concorrente Servizi ospedalieri S.r.l., riammesso a questa fase, all'apertura sulla piattaforma telematica Sintel delle buste contenenti la documentazione tecnica dallo stesso prodotta.

Il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice rilevano che nei campi previsti dal disciplinare di gara risulta presente la documentazione tecnica richiesta, il cui contenuto sarà esaminato in seduta riservata dalla Commissione Giudicatrice.

Il RUP della gara dichiara tolta la seduta alle ore 11,06.


Il presente Verbale, composto da n. 3 (tre) pagine, sarà pubblicato sulla piattaforma Sintel, nell'area documentazione di gara, nonché sul sito istituzionale www.acquistiliguria.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Commissione giudicatrice


Presidente

Dott.ssa Franca Foppiano




Componente

Dott. Giulio Bovio



Componente


Ing. Alessandro Gallo



Per il Seggio di gara:


Presidente

Dott. Luigi Moreno Costa

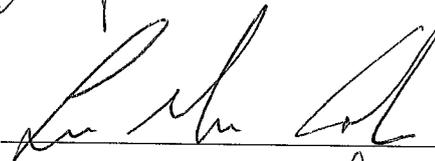


Componente/Segretario

Sig.ra Loredana Lotti



Componente


Dott.ssa Martina Canepa



Ufficiale Rogante

Dott. Valter Borrello





REGIONE LIGURIA

 DIREZIONE CENTRALE
 ORGANIZZAZIONE

 SETTORE
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 REGIONALE

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti – Dott.ssa Paola Gerbino

gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di Radioprotezione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti 8, Importo presunto di gara: € 1.311.066,24 (Iva esclusa), gara n. 8314394. ID Sintel 146672404

9^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Verbale di apertura della documentazione tecnica

Il giorno 16/01/2023, alle ore 9,10 presso Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante/Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, 2° piano si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto per la verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe, nominata con Decreto n. 3536 del 06/06/2022, nelle persone di:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott.ssa Franca Foppiano	ASL 5	Direttore S.C. Fisica sanitaria Dip. Oncologico
Componente	Dott. Giulio Bovio	Policlinico San Martino	Dirigente medico U.O. Radiologia interventistica
Componente	Ing. Alessandro Gallo	ASL 3	Responsabile SPP

Risultano altresì presente la Sig.a Loredana Lotti - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara e Referente della procedura, con funzioni di Segretario Verbalizzante, e la dott.ssa Paola Gerbino - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara.

Preliminarmente si dà atto che, come stabilito con la Commissione stessa per le vie brevi, le prove della campionatura sono state rinviate alla data del 8-9-10 febbraio p.v.

Nel corso della seduta odierna la Commissione procede alla valutazione della presenza dei requisiti minimi del Lotto 8 "SERVIZIO DI CONTROLLO DEI DPI ANTI-X DIFFUSA" per il quale è prevista l'aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso ed per il quale hanno presentato offerta le ditte Sago Medica S.rl. e Servizi Ospedalieri S.p.A.

All'esito della disamina della documentazione presentata dalle due ditte offerenti viene stabilito quanto segue:

Sago Medica S.rl.: la Commissione ritiene il servizio offerto corrispondente a quanto richiesto ed ammette la ditta alla successiva fase di apertura dell'offerta economica;

Servizi Ospedalieri S.p.A.: la Commissione ritiene che la documentazione fornita dall'offerente non riporti informazioni sufficienti a consentire la valutazione dell'idoneità del servizio offerto, anche in ragione della mancata allegazione del doc. "SCHEDE/RELAZIONE TECNICA" cui il concorrente fa riferimento nel Mod. M5 Questionario tecnico e, di conseguenza, la ditta non viene ammessa alla successiva fase di apertura delle offerte economiche.

Viene pertanto dato mandato a SUAR di comunicare l'esclusione alla Soc. Servizi Ospedalieri S.p.A.

Alle ore 13,00 la Commissione giudicatrice decide di interrompere la seduta e di aggiornare i lavori a data da destinarsi.

Letto, confermato e sottoscritto.


Dott.ssa Franca Foppiano




Dott. Giulio Bovio




Ing. Alessandro Gallo

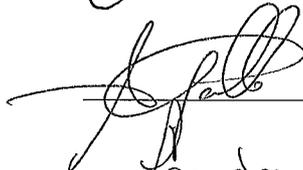


Sig.ra Loredana Lotti



Dott.ssa Paola Gerbino




REGIONE LIGURIA
**DIREZIONE CENTRALE
 ORGANIZZAZIONE**
**SETTORE
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 REGIONALE**

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti – Dott.ssa Paola Gerbino

gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di Radioprotezione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti 8, Importo presunto di gara: € 1.311.066,24 (Iva esclusa), gara n. 8314394. ID Sintel 146672404

1^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Verbale di apertura della documentazione tecnica

Il giorno 21/07/2022, alle ore 09,00 presso Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, 2° piano si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto per la verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto n. 3536 del 06/06/2022, risulta così composta:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott.ssa Franca Foppiano	ASL 5	Direttore S.C. Fisica sanitaria Dip. Oncologico
Componente	Dott. Giulio Bovio	Policlinico San Martino	Dirigente medico U.O. Radiologia interventistica
Componente	Ing. Alessandro Gallo	ASL 3	Responsabile SPP

Risulta altresì presente la Sig.a Loredana Lotti - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara e Referente della procedura, con funzioni di Segretario Verbalizzante.

La Commissione Giudicatrice dà preliminarmente atto che:

- con decreto del Dirigente n. 2048 del 01/04/2022 veniva disposta l'esclusione alle successive fasi della procedura di gara in oggetto del concorrente Servizi Ospedalieri S.r.l. e l'ammissione alle successive fasi di gara degli ulteriori concorrenti;
- nella seduta pubblica del 16/06/2022 (verbale Prot-2022-0418949 del 17/06/2022) si procedeva all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse e, segnatamente:

N.	OPERATORE ECONOMICO	LOTTI	STATO
1	Bericah S.p.A.	6	AMMESSA
2	Cea S.p.A.	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	AMMESSA
3	Chemil S.r.l.	6	AMMESSA
4	Clini-lab s.r.l.	1 - 4 - 6	AMMESSA
5	Microteck Italy S.r.l.	7	AMMESSA
6	Sago Medica S.r.l.	1 - 2 - 3 - 4 - 8	AMMESSA

- con Decreto 4113-2022, in ossequio a quanto disposto dal TAR Liguria in riferimento ai ricorsi proposti dal concorrente Servizi ospedalieri S.r.l., la SUAR stabiliva l'annullamento del decreto sopraccitato, limitatamente alla parte in cui disponeva l'esclusione del concorrente Servizi ospedalieri S.r.l. e la conseguente riammissione dello stesso alle successive fasi di gara.

Nel corso della seduta odierna la Commissione procederà all'accertamento della presenza dei requisiti minimi richiesti a pena di esclusione dal Capitolato tecnico-prestazionale.

I Componenti della Commissione hanno ricevuto con congruo anticipo la documentazione tecnica necessaria alla valutazione cartolare dei requisiti tecnici dei dispositivi offerti.

Gli uffici della SUAR hanno altresì predisposto apposite schede, inviate a ciascun commissario, riportante i requisiti minimi previsti ai fini dell'ammissibilità del concorrente.

Ciascun Commissario conferma di aver ricevuto ed esaminato il materiale inviato e, pertanto, a partire dal Lotto 7 "TELI ANTI X DIFFUSA STERILI", monopartecipato dalla Ditta Microtek Italy S.r.l., alla presenza del Segretario, sulla base delle indicazioni fornite dai singoli Componenti, vengono compilati i campi relativi alle caratteristiche indispensabili, riscontrando punto per punto i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico di Gara.

Alle ore 10,30 la Commissione interrompe la seduta riservata onde consentire, come da avviso Prot-2022-0517080, la seduta pubblica di apertura dell'offerta tecnica del concorrente Servizi Ospedalieri S.r.l.

I lavori riprendono in seduta riservata alle ore 11,15.

La Commissione dà atto che all'esito delle operazioni di apertura della relativa busta telematica, il concorrente Servizi Ospedalieri S.r.l. risulta ammesso alla successiva fase di verifica dell'idoneità tecnica per i lotti 1 - 2 - 3 - 8.

La Commissione Giudicatrice, all'esito della disamina della documentazione presentata dalla Ditta Microtek Italy S.r.l in relazione al Lotto 7, rileva che la scheda di sicurezza inserita in offerta afferisce al materiale "Starlite" non citato nei documenti di gara. Viene pertanto stabilito di richiedere all'O.E. se la scheda di sicurezza prodotta sia riferita al materiale attenuante contenuto all'interno dei telini offerti - Drape Armour™ - costituito da film schermante in Antimonio - Sb numero atomico 51 e PVC di nuova generazione.


Alle ore 12,00 la Commissione giudicatrice decide di interrompere la seduta e di aggiornare i lavori al giorno 28/07/2022, come da calendario.

Le risultanze dei lavori saranno riepilogate in tabelle che verranno allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione Giudicatrice.


Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 21/07/2022

Dott.ssa Franca Foppiano




Dott. Giulio Bovio




Ing. Alessandro Gallo



Sig.ra Loredana Lotti





REGIONE LIGURIA

 DIREZIONE CENTRALE
 ORGANIZZAZIONE

 SETTORE
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 REGIONALE

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti - Dott.ssa Paola Gerbino

gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di Radioprotezione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti 8, Importo presunto di gara: € 1.311.066,24 (Iva esclusa), gara n. 8314394. ID Sintel 146672404

2^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Verbale di apertura della documentazione tecnica

Il giorno 28/07/2022, alle ore 08,30 presso Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, 2° piano si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto per la verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto n. 3536 del 06/06/2022, risulta così composta:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott.ssa Franca Foppiano	ASL 5	Direttore S.C. Fisica sanitaria Dip. Oncologico
Componente	Dott. Giulio Bovio	Policlinico San Martino	Dirigente medico U.O. Radiologia interventistica
Componente	Ing. Alessandro Gallo	ASL 3	Responsabile SPP

Risulta altresì presente la Sig.a Loredana Lotti - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara e Referente della procedura, con funzioni di Segretario Verbalizzante.

Nel corso della seduta odierna la Commissione procederà all'accertamento della presenza dei requisiti minimi richiesti a pena di esclusione dal Capitolato tecnico-prestazionale in relazione al lotto 1 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'OPERATORE.

I Componenti della Commissione hanno ricevuto con congruo anticipo la documentazione tecnica necessaria alla valutazione cartolare dei requisiti tecnici dei dispositivi offerti.

Gli uffici della SUAR hanno altresì predisposto apposite schede, inviate a ciascun commissario, riportante i requisiti minimi previsti ai fini dell'ammissibilità del concorrente.

Ciascun Commissario conferma di aver ricevuto ed esaminato il materiale inviato e, pertanto, a partire dall'offerta tecnica presentata dalla Ditta Servizi Ospedalieri S.r.l., alla presenza del Segretario, sulla base delle indicazioni fornite dai singoli Componenti, vengono compilati i campi relativi alle caratteristiche indispensabili, riscontrando punto per punto i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico di Gara.

Conclusa la disamina della documentazione del concorrente Servizi Ospedalieri S.r.l., si passa alla verifica della presenza dei requisiti minimi dell'offerente Clini-Lab S.r.l. e, a seguire quelli della Soc. Cea S.p.A.

La Commissione dà atto che, all'esito dell'attività di disamina della documentazione viene rilevata:

- in relazione alla certificazione CE presentata da Servizi Ospedalieri S.r.l., la mancata allegazione del citato modulo C2 di cui all'All. 7 del Regolamento 2016/425.
- relazione alla certificazione CE presentata da Clini-Lab S.r.l., la mancata allegazione del citato modulo B della dichiarazione di conformità di all'All. 5 del Regolamento UE 2016/425.

Trattandosi di mera carenza documentale la Commissione stabilisce di attivare soccorso istruttorio nei confronti di entrambi gli OO.EE. al fine del completamento della certificazione già presentata.

Alle ore 13,00 la Commissione giudicatrice decide di interrompere la seduta e di aggiornare i lavori al giorno 01/09/2022, come da calendario.

Le risultanze dei lavori saranno riepilogate in tabelle che verranno allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione Giudicatrice.


Letto, confermato e sottoscritto.


Dott.ssa Franca Foppiano

Dott. Giulio Bovio

Ing. Alessandro Gallo

Sig.ra Loredana Lotti

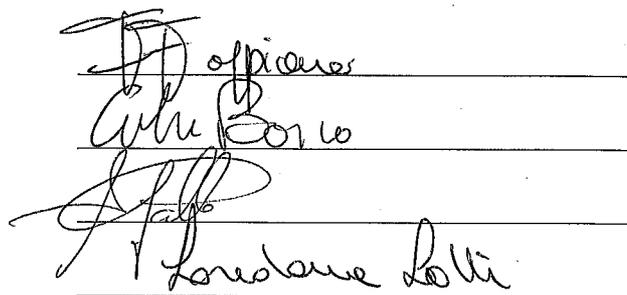

**REGIONE LIGURIA**
**DIREZIONE CENTRALE
 ORGANIZZAZIONE**
**SETTORE
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 REGIONALE**

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti – Dott.ssa Paola Gerbino

gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di Radioprotezione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti 8, Importo presunto di gara: € 1.311.066,24 (Iva esclusa), gara n. 8314394. ID Sintel 146672404

3^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**Verbale di apertura della documentazione tecnica**

Il giorno 01/09/2022, alle ore 9,10 presso Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante/Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, 2° piano si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto per la verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe, nominata con Decreto n. 3536 del 06/06/2022, nelle persone di:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott.ssa Franca Foppiano	ASL 5	Direttore S.C. Fisica sanitaria Dip. Oncologico
Componente	Dott. Giulio Bovio	Policlinico San Martino	Dirigente medico U.O. Radiologia interventistica

Risulta assente l'Ing. Alessandro Gallo, che ha comunicato di non poter essere presente per motivi personali ed imprevedibili. Gli altri due membri della Commissione, già presenti in loco, decidono di procedere con attività meramente compilatorie, rinviando la valutazione dell'idoneità dei concorrenti alle successive sedute, in presenza della Commissione in collegio perfetto.

Risulta altresì presente la Sig.a Loredana Lotti - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara e Referente della procedura, con funzioni di Segretario Verbalizzante, e la dott.ssa Paola Gerbino - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara.

Nel corso della seduta odierna pertanto la Commissione procede all'istruttoria relativa alla compilazione delle tabelle con i dati relativi alla presenza dei requisiti minimi richiesti a pena di esclusione dal Capitolato tecnico-prestazionale in relazione al lotto 1 ed al lotto 2.

I Componenti della Commissione hanno ricevuto con congruo anticipo la documentazione tecnica necessaria alla valutazione cartolare dei requisiti tecnici dei dispositivi offerti.

Gli uffici della SUAR hanno altresì predisposto apposite schede, inviate a ciascun commissario, riportante i requisiti minimi previsti ai fini dell'ammissibilità del concorrente.

Per quanto concerne il lotto 1, vengono compilati i campi dei requisiti minimi del concorrente Sago medica S.r.l.


Si procede, quindi, alla compilazione delle tabelle dei requisiti minimi relativi al lotto 2 per i concorrenti Cea S.r.l. e Sago medica s.r.l... Entrambe le tabelle vengono compilate parzialmente, rinviando il completamento della compilazione alle successive sedute.

Alle ore 13,40 la Commissione giudicatrice decide di interrompere la seduta e di aggiornare i lavori, a data da destinarsi dopo aver verificato anche la disponibilità dell'ing. Gallo.

Le risultanze dei lavori saranno riepilogate in tabelle che verranno allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione Giudicatrice.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Franca Foppiano




Dott. Giulio Bovio



Ing. Alessandro Gallo




Sig.ra Loredana Lotti



Dott.ssa Paola Gerbino




REGIONE LIGURIA
**DIREZIONE CENTRALE
 ORGANIZZAZIONE**
**SETTORE
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 REGIONALE**

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti – Dott.ssa Paola Gerbino

gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di Radioprotezione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti 8, Importo presunto di gara: € 1.311.066,24 (Iva esclusa), gara n. 8314394. ID Sintel 146672404

4^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Verbale di apertura della documentazione tecnica

Il giorno 30/09/2022, alle ore 9,10 presso Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante/Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, 2° piano si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto per la verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe, nominata con Decreto n. 3536 del 06/06/2022, nelle persone di:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott.ssa Franca Foppiano	ASL 5	Direttore S.C. Fisica sanitaria Dip. Oncologico
Componente	Dott. Giulio Bovio	Policlinico San Martino	Dirigente medico U.O. Radiologia interventistica
Componente	Ing. Alessandro Gallo	ASL 3	Responsabile SPP

Risulta altresì presente la Sig.a Loredana Lotti - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara e Referente della procedura, con funzioni di Segretario Verbalizzante, e la dott.ssa Paola Gerbino - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara.

Nel corso della seduta odierna la Commissione procede preliminarmente alla lettura delle risposte alle richieste di chiarimenti e integrazione documentazione inviata rispettivamente a Microteck (Prot-2022-0937824 del 05/09/2022) e a Servizi Ospedalieri (Prot-2022-0937826 del 05/09/2022), in base a quanto emerso nelle precedenti sedute.

Con comunicazione in data 13/09/2022 (ID 159.407.243 Sintel) Ecolab (Microteck) precisa che il “documento “Scheda di Sicurezza” presentata afferisce al nome commerciale - “Starlite” – del materiale attenuante contenuto all’interno dei telini offerti” (Drape ArmourTM)

Con comunicazione in data 09/09/2022 (ID 159.260.495 Sintel) Servizi ospedalieri allega i Certificati CE aggiornati relativi ai prodotti offerti. La Commissione giudicatrice rileva che i documenti presentati sono successivi alla data di presentazione dell’offerta, in quanto emessi il 30/06/2022. Pertanto, ritiene di richiedere al concorrente il “modulo C2” relativo ai lotti 1, 2 e 3 e il “modulo B” relativo ai lotti 2 e 3 in validità al momento della presentazione dell’offerta (22/12/2021).

Alle ore 11,15 la signora Loredana Lotti lascia la seduta.


Quindi la Commissione procede alla verifica delle certificazioni presentate da Cea e Sago nel lotto 2 ed alla verifica dell’idoneità dei prodotti offerti dalla ditta Sago medica nel lotto 2, completando la compilazione della tabella con i dati relativi alla presenza dei requisiti minimi richiesti a pena di esclusione dal Capitolato tecnico-prestazionale.

Alle ore 13,00 la Commissione giudicatrice decide di interrompere la seduta e di aggiornare i lavori indicativamente al giorno 14 ottobre p.v., salvo conferma.


Le risultanze dei lavori saranno riepilogate in tabelle che verranno allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione Giudicatrice.

Letto, confermato e sottoscritto.


Dott.ssa Franca Foppiano




Dott. Giulio Bovio




Ing. Alessandro Gallo

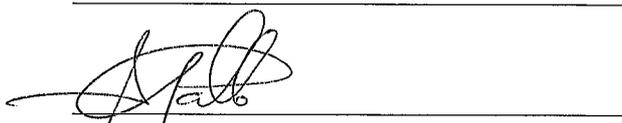


Sig.ra Loredana Lotti



Dott.ssa Paola Gerbino



**REGIONE LIGURIA**
**DIREZIONE CENTRALE
 ORGANIZZAZIONE**
**SETTORE
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 REGIONALE**

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti – Dott.ssa Paola Gerbino

gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di Radioprotezione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti 8, Importo presunto di gara: € 1.311.066,24 (Iva esclusa), gara n. 8314394. ID Sintel 146672404

5^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**Verbale di apertura della documentazione tecnica**

Il giorno 14/10/2022, alle ore 9,00 presso Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, 2° piano si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto per la verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe, nominata con Decreto n. 3536 del 06/06/2022, nelle persone di:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott.ssa Franca Foppiano	ASL 5	Direttore S.C. Fisica sanitaria Dip. Oncologico
Componente	Dott. Giulio Bovio	Policlinico San Martino	Dirigente medico U.O. Radiologia interventistica
Componente	Ing. Alessandro Gallo	ASL 3	Responsabile SPP

Risulta altresì presente la dott.ssa Paola Gerbino - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara.

La Commissione procede con la verifica della documentazione inviata da Clinilab (ID Sintel 159.079.749 del 07/09/2022) a seguito della richiesta Prot-2022-0937828 del 05/09/2022, relativa alla mancata allegazione del modulo B della dichiarazione di conformità di cui all'All. 5° del Regolamento UE 2016/425, ritenendo il documento allegato valido alla data di scadenza dell'offerta.

La Commissione procede, quindi, alla verifica della documentazione inviata da Servizi Ospedalieri, a seguito della richiesta Prot-2022-1132234 del 07/10/2022: presente il certificato C2 valido al momento della scadenza della presentazione delle offerte. Per quanto concerne il modello B, lo stesso risulta compreso nella documentazione già inviata. Pertanto, la Commissione ritiene che il requisito possa considerarsi assolto per quanto concerne il Lotto 1; mentre rileva che il modulo B presentato nei Lotti 2 e 3 è sempre quello relativo ai grembiuli del lotto 1, per cui ritiene di chiedere alla ditta concorrente l'invio di quelli relativi al lotto 2 ed al Lotto 3, validi alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, precisando che nella certificazione sono citati tutti e tre i moduli B e che, pertanto, si tratta di mera integrazione documentale.

Quindi la Commissione procede alla verifica delle offerte presentate da Cea, Sago Medica e Servizi ospedalieri nel lotto 3, relativamente all'idoneità dei prodotti offerti, completando la compilazione della tabella con i dati relativi alla presenza dei requisiti minimi richiesti a pena di esclusione dal Capitolato tecnico-prestazionale.

Terminata la verifica dei requisiti minimi del Lotto 3, la Commissione procede alla verifica dei requisiti minimi del Lotto 6, e precisamente della ditta Bericah.


Per quanto concerne la richiesta relativa al confezionamento, la Commissione si riserva la verifica del suddetto requisito a seguito della visione della campionatura, al fine di accertare che l'indicazione "destro" e "sinistro" sia visibile anche all'esterno del confezionamento e non soltanto sul polsino del guanto.

Alle ore 12,50 la Commissione giudicatrice decide di terminare la seduta e di aggiornare i lavori indicativamente al giorno 20 ottobre p.v..

Le risultanze dei lavori saranno riepilogate in tabelle che verranno allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione Giudicatrice.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Franca Foppiano



Dott. Giulio Bovio




Ing. Alessandro Gallo



Dott.ssa Paola Gerbino




REGIONE LIGURIA
**DIREZIONE CENTRALE
 ORGANIZZAZIONE**
**SETTORE
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 REGIONALE**

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti – Dott.ssa Paola Gerbino

gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di Radioprotezione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti 8, Importo presunto di gara: € 1.311.066,24 (Iva esclusa), gara n. 8314394. ID Sintel 146672404

6^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Verbale di apertura della documentazione tecnica

Il giorno 25/10/2022, alle ore 9,10 presso Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante/Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, 2° piano si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto per la verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe, nominata con Decreto n. 3536 del 06/06/2022, nelle persone di:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott.ssa Franca Foppiano	ASL 5	Direttore S.C. Fisica sanitaria Dip. Oncologico
Componente	Dott. Giulio Bovio	Policlinico San Martino	Dirigente medico U.O. Radiologia interventistica
Componente	Ing. Alessandro Gallo	ASL 3	Responsabile SPP

Risultano altresì presente la Sig.a Loredana Lotti - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara e Referente della procedura, con funzioni di Segretario Verbalizzante, e la dott.ssa Paola Gerbino - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara.

Nel corso della seduta odierna la Commissione procede all'istruttoria relativa alla presenza dei requisiti di minima dei dispositivi presentati dalle Ditte CEA, Chemil e Clinilab in riferimento al Lotto 6.

I Componenti della Commissione hanno ricevuto con congruo anticipo la documentazione tecnica necessaria alla valutazione cartolare dei requisiti tecnici dei dispositivi offerti.

Gli uffici della SUAR hanno altresì predisposto apposite schede, inviate a ciascun commissario, riportante i requisiti minimi previsti ai fini dell'ammissibilità del concorrente.


Vengono pertanto compilati tutti i campi relativi alla presenza dei requisiti minimi. Per quanto riguarda il requisito relativo al confezionamento la Commissione si riserva la verifica della riconoscibilità dell'indicazione "destra" e "sinistra" dei guanti in sede di valutazione della campionatura di tutti i concorrenti.

Alle ore 13,40 la Commissione giudicatrice decide di interrompere la seduta e di aggiornare i lavori, a data da destinarsi.

Le risultanze dei lavori saranno riepilogate in tabelle che verranno allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione Giudicatrice.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Franca Foppiano




Dott. Giulio Bovio



Ing. Alessandro Gallo




Sig.ra Loredana Lotti



Dott.ssa Paola Gerbino



**REGIONE LIGURIA**
**DIREZIONE CENTRALE
 ORGANIZZAZIONE**
**SETTORE
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 REGIONALE**

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti – Dott.ssa Paola Gerbino

gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di Radioprotezione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti 8, Importo presunto di gara: € 1.311.066,24 (Iva esclusa), gara n. 8314394. ID Sintel 146672404

7^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**Verbale di apertura della documentazione tecnica**

Il giorno 10/11/2022, alle ore 9,10 presso Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante/Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, 2° piano si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto per la verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe, nominata con Decreto n. 3536 del 06/06/2022, nelle persone di:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott.ssa Franca Foppiano	ASL 5	Direttore S.C. Fisica sanitaria Dip. Oncologico
Componente	Ing. Alessandro Gallo	ASL 3	Responsabile SPP

Risulta assente il Dott. Giulio Bovio che ha comunicato di non poter essere presente per motivi personali ed imprevedibili.

Risulta altresì presente la Sig.a Loredana Lotti - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara e Referente della procedura, con funzioni di Segretario Verbalizzante.

Gli altri due membri della Commissione, già presenti in loco, decidono pertanto di procedere con attività meramente compilatorie, rinviando la valutazione dell'idoneità dei concorrenti alle successive sedute, in presenza della Commissione in collegio perfetto.

I Componenti presenti stabiliscono di procedere alla verifica della presenza e della completezza dei documenti presentati dalle ditte concorrenti in relazione al lotto 4.

In riferimento alle ditte Cea S.r.l. e Clini Lab viene rilevato quanto segue:

Clinilab S.r.l. Sono presenti le certificazioni di conformità richieste ma non si evince il riferimento ai codici dei prodotti offerti. I Componenti ritengono opportuno richiedere al concorrente dove è possibile rinvenire tale indicazione nelle certificazioni fornite (cartelle Allegato_3 e Allegato_2 della documentazione presentata in gara).

Ditta Cea S.r.l.: è stata rilevata la mancata allegazione del modulo C2 di cui all'all. 7 del Regolamento 2016/425 riferito alla dichiarazione di conformità n. 523548/1 rilasciata dall'Ente notificato BTTG. Anche in questo caso i Componenti chiedono di invitare la Società di che trattasi ad inviare il modulo C2 a completamento della documentazione già fornita.

Alle ore 12,30 i Componenti decidono di interrompere la seduta e di aggiornare i lavori, a data da destinarsi.

Le risultanze dei lavori saranno poi riepilogate in tabelle che verranno allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione Giudicatrice.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Franca Foppiano




Dott. Giulio Bovio




Ing. Alessandro Gallo



Sig.ra Loredana Lotti





REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONESETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti – Dott.ssa Paola Gerbino

gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di Radioprotezione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti 8, Importo presunto di gara: € 1.311.066,24 (Iva esclusa), gara n. 8314394. ID Sintel 146672404

8^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Verbale di apertura della documentazione tecnica

Il giorno 23/11/2022, alle ore 9,10 presso Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante/Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, 2° piano si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto per la verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe, nominata con Decreto n. 3536 del 06/06/2022, nelle persone di:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott.ssa Franca Foppiano	ASL 5	Direttore S.C. Fisica sanitaria Dip. Oncologico
Componente	Dott. Giulio Bovio	Policlinico San Martino	Dirigente medico U.O. Radiologia interventistica
Componente	Ing. Alessandro Gallo	ASL 3	Responsabile SPP

Risultano altresì presente la Sig.a Loredana Lotti - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara e Referente della procedura, con funzioni di Segretario Verbalizzante, e la dott.ssa Paola Gerbino - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara.

Nel corso della seduta odierna la Commissione procede alla valutazione dei requisiti di minima dei dispositivi presentati dalle Ditte CEA, Sago Medica S.r.l. e Clinilab in riferimento al Lotto 4

Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti alle Ditte Cea S.r.l e Clinilab S.r.l. si dà atto che le stesse hanno fornito adeguata risposta con note inviate a mezzo piattaforma Sintel ID 161.587.517 e ID 161463549).

Per quanto riguarda la concorrente Clinilab S.r.l., la Commissione, sulla base di quanto riferito dalla concorrente, accerta che nella "nota informativa" allegata a pag.11 dell'Allegato 2, gli occhiali offerti risultano appartenere alla serie RG-50SS (protezione lente 0.75 – protezione laterale 0.50) cui si riferiscono le certificazioni allegate e pertanto il requisito viene ritenuto soddisfatto.

In relazione alla ditta CEA S.r.l., la Commissione tenuto conto dell'allegazione del Modulo D (con datazione precedente ai termini di scadenza per la presentazione dell'offerta) e di quanto dalla stessa dichiarato in merito all'alternatività dei moduli C2 o D ai fini del rilascio della certificazione stessa (come peraltro previsto dalla normativa), prende atto della validità dei certificati presentati per i prodotti offerti per il lotto 4.

All'esito della disamina della documentazione presentata da tutte le ditte offerti per i lotti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene stabilito quanto segue:

N.	OPERATORE ECONOMICO	LOTTI	STATO
1	Bericah S.p.A.	6	AMMESSA
2	Cea S.p.A.	1 - 2 - 3 - 4 - 6	AMMESSA
3	Chemil S.r.l.	6	AMMESSA
4	Clini-lab s.r.l.	1 - 4 - 6	AMMESSA
5	Microteck Italy S.r.l.	7	AMMESSA
6	Sago Medica S.r.l.	1 - 2 - 3 - 4	AMMESSA
7	Servizi Ospedalieri	1-2-3	AMMESSA

Viene altresì stabilito di fissare la prova della campionatura nelle giornate del 11-12-13 gennaio 2023 nei locali del SPP di ASL 3 presso la sede dell'Osp. Celesia, demandando alla SUAR gli adempimenti conseguenti (verifica disponibilità e autorizzazione da parte di ASL 3, comunicazione alle ditte concorrenti).

Alle ore 10,50 la Commissione giudicatrice decide di interrompere la seduta e di rinviare la valutazione del Lotto 8, a data da destinarsi.

Le risultanze dei lavori saranno riepilogate in tabelle che verranno allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione Giudicatrice.

Letto, confermato e sottoscritto.


Dott.ssa Franca Foppiano



Dott. Giulio Bovio




Ing. Alessandro Gallo



Sig.ra Loredana Lotti



Dott.ssa Paola Gerbino





REGIONE LIGURIA

 DIREZIONE CENTRALE
 ORGANIZZAZIONE

 SETTORE
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 REGIONALE

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti - Dott.ssa Paola Gerbino

gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di Radioprotezione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti 8, Importo presunto di gara: € 1.311.066,24 (Iva esclusa), gara n. 8314394. ID Sintel 146672404

10^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Verbale di valutazione della documentazione tecnica

Il giorno 08/02/2023, alle ore 9,30 presso la sala riunioni dell'Ex Ospedale Celesia - Via P.N. Cambiaso 62/C, 16159 Genova -- c/o S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione, Padiglione Valle - piano terra si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto per la verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe, nominata con Decreto n. 3536 del 06/06/2022, nelle persone di:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott.ssa Franca Foppiano	ASL 5	Direttore S.C. Fisica sanitaria Dip. Oncologico
Componente	Dott. Giulio Bovio	Policlinico San Martino	Dirigente medico U.O. Radiologia interventistica
Componente	Ing. Alessandro Gallo	ASL 3	Responsabile SPP

Risultano altresì presente la Sig.a Loredana Lotti - Funzionario della SUAR - Componente del Seggio di gara e Referente della procedura, con funzioni di Segretario Verbalizzante, e la dott.ssa Paola Gerbino - Funzionario della SUAR - Componente del Seggio di gara.

Preliminarmente si dà atto che con comunicazione Prot-2023-0039990 del 12/01/2023 gli uffici SUAR richiedevano ai concorrenti di far pervenire la campionatura relativa alla procedura di gara presso l'indirizzo di cui sopra.

Alla verifica della campionatura pervenuta si è riscontrato che era mancante quella relativa all'offerta presentata da Servizi Ospedalieri. A seguito di verifica ulteriore, è stato rilevato che per un mero errore materiale la comunicazione di cui sopra non è stata inviata al concorrente Servizi ospedalieri, il quale, contattato telefonicamente, si è reso disponibile all'immediato invio della campionatura, indicando quale tempo presumibile della consegna giovedì pomeriggio 09/02/2023 o venerdì mattina 10/02/2023.

La Commissione giudicatrice ritiene, quindi, di proseguire con la valutazione della campionatura dei lotti 7, 6 e 4, nei quali il suddetto concorrente non ha presentato offerta.

Per quanto concerne il **Lotto 7** Teli anti X diffusa sterili per la protezione dell'operatore, si precisa che l'unico concorrente ad aver presentato offerta è la ditta Microtek Italy S.r.l. in oggi ECOLAB, ed ha fornito quale campionatura il prodotto cod. RBFPS101.

La Commissione ha rilevato che la ditta concorrente presenta un'ampia gamma di misure e, inoltre, che la presenza del biadesivo e dei velcri applicabili al paziente ed al telo facilita il posizionamento. Ha, quindi, espresso la propria valutazione come indicato nella scheda allegata.

Si procede, quindi, alla valutazione dei prodotti offerti nel **Lotto 6**: partecipanti i concorrenti Bericah, CEA, CHEMIL e CLINILAB.

La Commissione giudicatrice procede alla verifica dei codici dei prodotti offerti ed alla valutazione degli stessi, utilizzando la taglia 8 per tutti, aprendo le confezioni, indossando i guanti e facendo una prova di resistenza del guanto, consistente nell'afferrare con il primo ed il secondo dito di una mano il guanto dell'altra mano nella zona del palmo e tirandolo tre volte. Tale prova viene fatta sia per i guanti di cui al sub lotto 6.1 sia quelli di cui al sub lotto 6.2.

Con riferimento al **sub lotto 6.1**. (Guanti anti-X sterili monouso sottili) la Commissione rileva quanto segue:

BERICAH: i guanti non presentano indicazione di destro e sinistro sul polsino, ma soltanto sulla busta; una volta indossati la sensibilità risulta buona, così come la conformazione. Alla prova di resistenza sopra descritta il guanto reagisce bene: mantiene memoria del tiraggio in modo leggero. Anche la svestibilità appare buona;

CEA e CHEMIL (hanno presentato lo stesso prodotto): indicazione destro/sinistro è presente sia sulla busta sia sul polsino; il grip è minore: scivolano di più; anche in questo caso la prova di resistenza dà un buon risultato (rimane un pochino di alone); la svestibilità è buona; la taglia risulta abbondante rispetto alla misura dichiarata;

CLINILAB: l'indicazione destro /sinistro è sia sulla busta sia sul polsino; i guanti risultano meno elastici, per cui l'indossabilità è meno agevole e la sensibilità ridotta.


Per quanto concerne il **sub lotto 6.2** (Guanti anti-X sterili monouso ultrasottili) la Commissione rileva quanto segue:

BERICAH: l'indicazione destro /sinistro si presenta una volta aperta la confezione; la sensibilità risulta non alterata; alla prova di resistenza sopradescritta sulla taglia 8 al terzo tiraggio (primo e secondo dito dell'altra mano) si rompe, la svestibilità è buona. La prova di resistenza viene ripetuta con esito positivo sulla taglia 7,5, dove il tiraggio lascia un lieve segno di memoria.

CEA e CHEMIL (hanno presentato lo stesso prodotto): l'indicazione destro /sinistro si trova sia sulla busta sia sul polsino; a parità di taglia (8) ha vestibilità maggiore, meno sensibilità tattile, alla prova di resistenza non si è rotto però si fatica a afferrare il guanto con le dita, perché più scivoloso (meno gripp). Per avere migliore sensibilità e gripp è necessario utilizzare una taglia inferiore, ma in questo caso risulta più stretto sul dorso della mano e corto tra le dita. Meno adattabile.

CLINILAB: l'indicazione destro /sinistro si trova sia sulla busta sia sul polsino, minore sensibilità, buona la prova di resistenza; si fatica a toglierli (risulta un po' rigido).

La commissione procede, pertanto, alla valutazione, compilando le schede allegate.

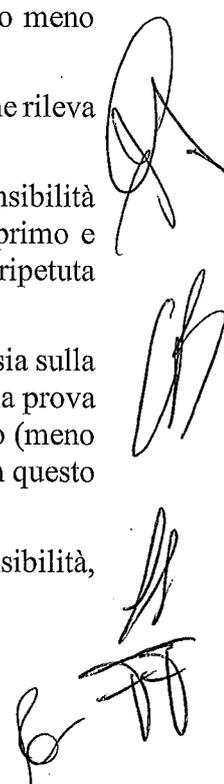

Dalle ore 13.00 alle ore 13.30 i lavori vengono sospesi per la pausa pranzo.

Si procede, quindi, alla disamina della campionatura pervenuta nel **Lotto 4** - Occhiali a protezione radiazioni ionizzanti.

I concorrenti partecipanti al Lotto 4 sono: CEA, CLINILAB e SAGO MEDICA. La Commissione giudicatrice procede con l'esame della campionatura presentata dai concorrenti, valutando i seguenti sub lotti e compilando le relative tabelle allegate:

Ref. 4.1 - Occhiali con lenti di protezione dalle radiazioni ionizzanti sovrapponibili ad altri occhiali

Ref. 4.2 - Occhiale anti-x non graduato leggero con protezione laterale

CEA: La ditta dichiara che il dispositivo offerto è "progettato per garantire protezione per tutta la superficie oculare senza necessità di aggiungere le protezioni laterali". Alla prova le barriere laterali risultano limitate.

Ref. 4.3 - Occhiale anti-X non graduato standard con protezione laterale

Ref. 4.4 - Occhiale anti-X graduato leggero con protezione laterale.

Alle ore 14.30 l'Ing. Alessandro Gallo lascia la seduta.

Dal momento che la campionatura del concorrente Servizi Ospedalieri non è nella disponibilità della Commissione, per i motivi meglio specificati in premessa, i restanti membri della Commissione decidono di procedere alla verifica dei codici della restante campionatura, al fine di accertare la presenza di tutti i campioni richiesti, riservandosi la valutazione in successiva sede.

Alle ore 17,30 la Commissione giudicatrice decide di interrompere la seduta e di aggiornare i lavori al giorno successivo, cioè 09/02/2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Franca Foppiano




Dott. Giulio Bovio




Ing. Alessandro Gallo




Sig.ra Loredana Lotti



Dott.ssa Paola Gerbino





REGIONE LIGURIA

 DIREZIONE CENTRALE
 ORGANIZZAZIONE

 SETTORE
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 REGIONALE

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti – Dott.ssa Paola Gerbino

gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di Radioprotezione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti 8, Importo presunto di gara: € 1.311.066,24 (Iva esclusa), gara n. 8314394. ID Sintel 146672404

11^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Verbale di valutazione della documentazione tecnica

Il giorno 09/02/2023, alle ore 9,30 presso la sala riunioni dell'Ex Ospedale Celesia - Via P.N. Cambiaso 62/C, 16159 Genova -- c/o S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione, Padiglione Valle - piano terra si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto per la verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe, nominata con Decreto n. 3536 del 06/06/2022, nelle persone di:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott.ssa Franca Foppiano	ASL 5	Direttore S.C. Fisica sanitaria Dip. Oncologico
Componente	Dott. Giulio Bovio	Policlinico San Martino	Dirigente medico U.O. Radiologia interventistica
Componente	Ing. Alessandro Gallo	ASL 3	Responsabile SPP

Risultano altresì presente la Sig.a Loredana Lotti - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara e Referente della procedura, con funzioni di Segretario Verbalizzante, e la dott.ssa Paola Gerbino - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara.

Si dà atto che il concorrente Servizi Ospedalieri ha contattato telefonicamente per far sapere che la consegna della campionatura avverrà presuntivamente entro le 14.00.

La Commissione procede, quindi, alla disamina della campionatura relativa ai lotti 1 e 2, riservandosi al pomeriggio la valutazione e le decisioni in merito.

Dalle ore 13.00 alle ore 13.30 i lavori vengono sospesi per la pausa pranzo.

Alle ore 14.00 circa si dà atto della consegna della campionatura da parte dei Servizi Ospedalieri.

La Commissione procede, quindi, alla valutazione della campionatura relativa al **Lotto 3 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OPERATORI: COLLARI**, i cui partecipanti sono CEA, SAGO MEDICA e SERVIZI OSPEDALIERI.

Si procede, quindi, alla verifica dei codici dei prodotti delle suddette campionature.

La Commissione nella valutazione che viene riportata nella tabella allegata, rileva quanto segue.

La presenza dell'etichetta irrigidisce il dispositivo sia di Sago Medica che di Servizi ospedalieri, in maniera più evidente nel prodotto offerto da questi ultimi.

SAGO MEDICA: per quanto concerne "cuciture, elasticità, minore rigidità" si rileva che lo spessore delle cuciture conferisce maggiore rigidità al dispositivo.

La Commissione giudicatrice, quindi, procede alla valutazione della campionatura dei concorrenti CEA, CLINILAB, SAGO MEDICA e SERVIZI OSPEDALIERI, nel **Lotto 1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'OPERATORE**, rilevando quanto segue:

Ref. 1.1 - Grembiule anti-x intero avvolgente

CEA: presentati COD. 168006-0 STYLE 3201 Male/HC medium, front 0.25/0,50/0,25 back 0,25 parzialmente sovrapponibile con protezione frontale inferiore a quella richiesta + COD. 168006-1 STYLE 3250 Male-LC, front 0.25 back 0,25 interamente avvolgente ma con spessore frontale inferiore a quanto richiesto. Trattasi di prodotti non offerti e pertanto la valutazione sui parametri a discrezionalità non è eseguibile.

SAGO: presentato FULL WRAP APRON size m front 0.5, back 0.25, non presenta una cintura ma una banda elastica interna e clip sotto-ascellare scomoda nell'allacciamento durante la vestizione;

CLINILAB.: l'O.E. presenta campioni aventi lo stesso codice di quelli offerti in gara, ma allega dichiarazione attestante che gli stessi hanno materiale schermante diverso da quello dei dispositivi offerti. Poiché non sono note le caratteristiche di tale materiale, gli item che non sono esclusivamente documentali non possono essere oggetto di valutazione.

S.O.: il dispositivo risulta "spesso al tatto", rigido con limitata facilità di vestizione. Una volta indossante viene percepito come "ingombrante".

Ref. 1.2 - Grembiule anti-x frontale protezione anteriore 0.25 mm PbEq e protezione scapolare 0.25 mm PbEq

CEA: presentati COD. 168006-2 STYLE 310A (LB) Male/HC medium, front 0.5 back 0,25 con protezione anteriore superiore a quella richiesta. La Commissione pertanto non può valutare il criterio relativo alla rigidità e vestibilità, in quanto le suddette caratteristiche risultano condizionate da materiale schermante avente peso e rigidità diversi.

Ref. 1.3 - Grembiule anti-x frontale con protezione anteriore 0.35 mm PbEq e protezione scapolare 0.25 mm pbeq

CLINILAB.: l'O.E. non presenta campione (i DPI presentati non corrispondono alle caratteristiche di attenuazione richieste). Inoltre allega dichiarazione attestante che il materiale schermante è diverso da quello dei dispositivi offerti. Pertanto, gli item che non sono esclusivamente documentali non possono essere oggetto di valutazione, in quanto condizionati dal diverso peso e rigidità del materiale schermante.

Ref. 1.4 - Grembiule anti-x frontale con protezione anteriore 0.50 mm PbEq e protezione scapolare 0.25 mm mm pbeq

CLINILAB.: l'O.E. presenta campione avente lo stesso codice di quello offerto in gara ma allega dichiarazione attestante che gli stessi hanno materiale schermante diverso da quello dei dispositivi offerti. Poiché non sono note le caratteristiche di tale materiale, gli item che non sono esclusivamente documentali non possono essere oggetto di valutazione;

S.O.: il dispositivo risulta "spesso al tatto", rigido con limitata facilità di vestizione. Una volta indossante viene percepito come "ingombrante".

Le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice vengono riportate nelle tabelle allegate.

La Commissione procede, quindi, con la valutazione della campionatura presentata dai concorrenti CEA, SAGO MEDICA e SERVIZI OSPEDALIERI nel **Lotto 2 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OPERATORI: GREMBIULI SPEZZATI:**

Ref. 2.1 - Grembiule spezzato standard: gonna anti-X + corpetto anti-X (0.50 Ant. e 0.25 Post.)

CEA: presentano una taglia in meno rispetto agli altri concorrenti, ma taglie differenziate per uomo e donna; il rivestimento esterno risulta rigido e scivoloso; la maggiore rigidità incide sulla vestibilità del prodotto e sulla comodità degli operatori.

SAGO MEDICA: il corpetto anteriormente sovrappone per un terzo della sua superficie con protezione pari a 1. La gonna presenta all'interno una cintura con supporto lombare per un maggior comfort di vestibilità.

S.O.: presentano una minore disponibilità di colori; il grembiule risulta di spessore maggiore al tatto, e ciò comporta maggiore pesantezza e minore vestibilità. Nella gonna la parte velcrata è meno ampia e rende meno agevole la chiusura.

Ref. 2.2 - Grembiule spezzato standard: gonna anti-X + corpetto anti-X (0.25 Ant. e 0.25 Post.)

CEA: presentati: corpetto Serial n. 168006-8 Style 325V MALE/LC front 0,25 back 0,25 (corpetto) - Serial n. 168006-7 Style 330S MALE/LC front 0,25 back 0,25 (gonna). Hanno campionato anche il corpetto Serial N. 168006-9 Style 330V MALE/LC front 0,25 back 0,25, che però non è stato offerto in gara e, pertanto, non viene esaminato dalla Commissione.

S.O.: Nella gonna la parte velcrata è meno ampia e rende meno agevole la chiusura. Sul corpetto è presente minore porzione di velcro e a garanzia della chiusura sono applicate fibbie in plastica.

Ref. 2.3 - Grembiule spezzato ergonomico: gonna anti-X + corpetto anti-X (0.50 Ant. e 0.25 Post.)

CEA: modello presentato 168006-11 Style 335V MALE/HC front 0,50 back 0,25 (corpetto) serial N. 168006-10 Style 330S MALE/HC front 0,5 back 0,25. La vestizione del corpetto risulta complessa e non facilmente realizzabile da un unico operatore: in particolare per la chiusura posteriore del corpetto sulla spalla sinistra. La concorrente ha presentato anche il corpetto 330V50, che non è offerto in gara, per cui la Commissione non lo esamina.

S.O.: al tatto il corpetto risulta di maggiore spessore che influisce sull'ingombro percepito e sulla vestibilità. La vestizione del corpetto, inoltre, risulta complessa e non facilmente realizzabile da un unico operatore, in particolare per la chiusura posteriore del corpetto sulla spalla sinistra.

Ref. 2.4 - Grembiule spezzato ergonomico: gonna anti-X + corpetto anti-X (0.25 Ant. e 0.25 Post.)

S.O.: al tatto il corpetto risulta di maggiore spessore che influisce sull'ingombro percepito e sulla vestibilità. La vestizione del corpetto, inoltre, risulta complessa e non facilmente realizzabile da un unico operatore, in particolare per la chiusura posteriore del corpetto sulla spalla sinistra.

CEA e SAGO MEDICA offrono lo stesso prodotto presentato nel subplotto Ref. 2.2.

Le valutazioni vengono riportate nelle tabelle allegate.

Alle ore 17,00 terminata la valutazione della campionatura, la Commissione giudicatrice decide di rinviare per gli ulteriori adempimenti a data da destinarsi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Franca Foppiano




Dott. Giulio Bovio



Ing. Alessandro Gallo




Sig.ra Loredana Lotti



Dott.ssa Paola Gerbino



**REGIONE LIGURIA**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONESETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALEDirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti – Dott.ssa Paola Gerbino

gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di Radioprotezione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti 8, Importo presunto di gara: € 1.311.066,24 (Iva esclusa), gara n. 8314394. ID Sintel 146672404

12^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**Verbale di valutazione della documentazione tecnica**

Il giorno 16/03/2023, alle ore 10,30 presso Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante/Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, 6° piano si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto per la verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe, nominata con Decreto n. 3536 del 06/06/2022, nelle persone di:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott.ssa Franca Foppiano	ASL 5	Direttore S.C. Fisica sanitaria Dip. Oncologico
Componente	Dott. Giulio Bovio	Policlinico San Martino	Dirigente medico U.O. Radiologia interventistica
Componente	Ing. Alessandro Gallo	ASL 3	Responsabile SPP

La Dott.ssa Franca Foppiano presenza alla seduta in collegamento SKYPE.

Risultano altresì presente la Sig.a Loredana Lotti - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara e Referente della procedura, con funzioni di Segretario Verbalizzante, e la dott.ssa Paola Gerbino - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara.

Nel corso della seduta odierna la Commissione, tenuto conto dell'esito delle attività valutative compiute nel corso delle prove della campionatura eseguite nelle giornate del 8 e 9 febbraio 2023,

procede all'imputazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche dei concorrenti nel file Excel allegato al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale.

I punteggi tecnici finali, risultano essere i seguenti:

Lotto	Ditta concorrente	Punteggio offerta tecnica (max 70 pt)
1	Cea S.p.A.	51,457
	Clini-lab S.r.l.	47,180
	Sago Medica S.r.l.	70,000
	Servizi ospedalieri S.r.l	55,725
2	Cea S.p.A.	53,410
	Sago Medica S.r.l.	70,00
	Servizi ospedalieri S.r.l	50,855
3	Cea S.p.A.	70,00
	Sago Medica S.r.l.	66,362
	Servizi ospedalieri S.r.l	60,204
4	Cea S.p.A.	70,00
	Clini-lab S.r.l.	57,774
	Sago Medica S.r.l.	66,728
5	DESERTO	
6	Bericah S.p.A.	67,676
	Cea S.p.A.	70,00
	Chemil S.r.l.	70,00
	Clini-lab S.r.l.	68,440
7	Microteck Italy S.r.l.	70,00

Conclusa l'attività di valutazione la Commissione giudicatrice decide di riconvocarsi in data 30/03/2023 per l'apertura delle offerte economiche.

La seduta è tolta alle ore 13,30

Letto, confermato e sottoscritto.


Dott.ssa Franca Foppiano

Dott. Giulio Bovio

Ing. Alessandro Gallo


Sig.ra Loredana Lotti


Dott.ssa Paola Gerbino











LOTTO 1 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'OPERATORE

Ref. 1.1 - Grembiule anti-x intero avvolgente	Max punti			CEA Mod. X325050	SAGO MEDICA XRABDAPBSSLF	CLINILAB 1109LF	SERVIZI OSPEDALIERI IRX012525S	
Caratteristiche di protezione	2	Q3*	60 (kVp) – Assorbimento	99,600	99,750	99,800	99,810	79,68
			<i>Punteggio</i>	1,979	1,994	1,999	2,000	
	2		70 (kVp) – Assorbimento	99,100	99,320	99,300	99,260	79,28
			<i>Punteggio</i>	1,978	2,000	1,998	1,994	
	1		90 (kVp) – Assorbimento	96,700	97,500	97,200	97,200	77,36
			<i>Punteggio</i>	0,960	1,000	0,985	0,985	
	1		120 (kVp) – Assorbimento	94,700	95,090	94,800	94,800	75,76
			<i>Punteggio</i>	0,980	1,000	0,985	0,985	
Taglie e personalizzazione	3	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,800	1,000	0,800	0,800	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	0,800	0,800	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,000	0,800	0,800	
			Media coefficienti	0,800	1,000	0,800	0,800	
			riportata a 1	0,80	1,00	0,80	0,80	
			<i>Punteggio</i>	2,400	3,000	2,400	2,400	
Materiale (Sono da preferire i prodotti con componenti plurime. Saranno altresì apprezzate cuciture, elasticità, minore rigidità) e sanificazione	2	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,000	1,000	0,000	0,800	
			Dott. Giulio Bovio	0,000	1,000	0,000	0,800	
			Ing. Alessandro Gallo	0,000	1,00	0,00	0,800	
			Media coefficienti	0,000	1,000	0,000	0,800	
			riportata a 1	0,00	1,00	0,00	0,80	
			<i>Punteggio</i>	0,000	2,000	0,000	1,600	
Peso (Kg/m2) al valore di assorbimento di 0.5 mm PbEq	7	Q4*		5,530	5,270	5,680	5,680	6,816
			<i>Punteggio</i>	5,823	7,000	5,144	5,144	
Caratteristiche di funzionalità (sistemi di chiusura e vestibilità)	5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,000	1,000	0,000	0,400	
			Dott. Giulio Bovio	0,000	1,000	0,000	0,300	
			Ing. Alessandro Gallo	0,000	1,000	0,000	0,400	
			Media coefficienti	0,000	1,000	0,000	0,367	
			riportata a 1	0,00	1,00	0,00	0,37	
			<i>Punteggio</i>	0,000	5,000	0,000	1,833	
Modalità di realizzazione della Tracciabilità sicura dei prodotti.	2	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,700	1,000	0,700	1,000	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	0,800	1,000	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,00	0,800	1,00	
			Media coefficienti	0,767	1,000	0,767	1,000	
			riportata a 1	0,77	1,00	0,77	1,00	
			<i>Punteggio</i>	1,533	2,000	1,533	2,000	

Totale punteggio di qualità	25,000			15,653	24,994	15,044	18,941
Totale punteggio di qualità riparametrato	25,000			15,657	25,000	15,048	18,946

LOTTO 1 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'OPERATORE

Ref. 1.2 - Grembiule anti-x frontale protezione anteriore 0.25 mm PbEq e protezione scapolare 0.25 mm PbEq	Max punti		CEA X310AL25+R127 o R128+XXAT	SAGO XRFADFQAPSLF	CLINILAB 1107HBLF25	SERVIZI OSPEDALIERI IRX0225		
Caratteristiche di protezione	1	Q3*	60 (kVp) – Assorbimento	97,500	97,800	97,600	97,650	78
			<i>Punteggio</i>	0,985	1,000	0,990	0,992	
	1		70 (kVp) – Assorbimento	95,600	96,190	95,700	95,670	76,48
			<i>Punteggio</i>	0,968	1,000	0,975	0,974	
	0,5		90 (kVp) – Assorbimento	90,100	91,730	90,900	90,930	72,08
			<i>Punteggio</i>	0,459	0,500	0,479	0,480	
	0,5		120 (kVp) – Assorbimento	85,600	87,400	85,800	85,800	68,48
			<i>Punteggio</i>	0,452	0,500	0,458	0,458	
Taglie e personalizzazione	2	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,800	1,000	0,800	0,800	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	0,800	0,800	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,000	0,800	0,800	
			Media coefficienti	0,800	1,000	0,800	0,800	
			riportata a 1	0,80	1,00	0,80	0,80	
			<i>Punteggio</i>	1,600	2,000	1,600	1,600	
Materiale (Sono da preferire i prodotti con componenti plurime. Saranno altresì apprezzate cuciture, elasticità, minore rigidità) e sanificazione	1,5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,000	1,000	0,800	0,800	
			Dott. Giulio Bovio	0,000	1,000	0,800	0,800	
			Ing. Alessandro Gallo	0,000	1,000	0,800	0,800	
			Media coefficienti	0,000	1,000	0,800	0,800	
			riportata a 1	0,00	1,00	0,80	0,80	
			<i>Punteggio</i>	0,000	1,500	1,200	1,200	
Peso (Kg/m2) al valore di assorbimento di 0.25 mm PbEq	4	Q4*		2,77	2,760	2,800	2,800	3,36
			<i>Punteggio</i>	3,933	4,000	3,733	3,733	
Caratteristiche di funzionalità (sistemi di chiusura e vestibilità)	3	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,000	1,000	0,900	0,500	
			Dott. Giulio Bovio	0,000	1,000	0,800	0,600	
			Ing. Alessandro Gallo	0,000	1,000	0,800	0,600	
			Media coefficienti	0,000	1,000	0,833	0,567	
			riportata a 1	0,00	1,00	0,83	0,57	
			<i>Punteggio</i>	0,000	3,000	2,500	1,700	
Modalità di realizzazione della Tracciabilità sicura dei prodotti.	1,5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,700	1,000	0,700	1,000	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	0,800	1,000	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,00	0,800	1,00	
			Media coefficienti	0,767	1,000	0,767	1,000	
			riportata a 1	0,77	1,00	0,77	1,00	
			<i>Punteggio</i>	1,150	1,500	1,150	1,500	

Totale punteggio di qualità	15,000			9,547	15,00	13,085	12,637
Totale punteggio di qualità riparametrato	15,000			9,547	15,000	13,085	12,637

LOTTO 1 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'OPERATORE

Ref. 1.3 - Grembiule anti-x frontale con protezione anteriore 0.35 mm PbEq e protezione scapolare 0.25 mm pbeq	Max punti			CEA X310AL35+R127 o R128+XXAT	SAGO XRFADFQAQSLF	GLINILAB 1107HBLF3525	SERVIZI OSPEDALIERI	
Caratteristiche di protezione	1	Q3*	60 (kVp) – Assorbimento	99,100	99,170	99,100	99,140	79,28
			<i>Punteggio</i>	0,996	1,000	0,996	0,998	
	1		70 (kVp) – Assorbimento	97,800	98,230	98,000	98,040	78,24
			<i>Punteggio</i>	0,977	1,000	0,988	0,990	
	0,5		90 (kVp) – Assorbimento	94,000	95,120	94,500	94,540	75,2
			<i>Punteggio</i>	0,472	0,500	0,484	0,485	
0,5	120 (kVp) – Assorbimento	90,800	91,800	91,300	90,950	72,64		
			<i>Punteggio</i>	0,474	0,500	0,487	0,478	
Taglie e personalizzazione	2	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,800	1,000	0,800	0,800	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	0,800	0,800	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,000	0,800	0,800	
			Media coefficienti	0,800	1,000	0,800	0,800	
			riportata a 1	0,80	1,00	0,80	0,80	
			<i>Punteggio</i>	1,600	2,000	1,600	1,600	
Materiale (Sono da preferire i prodotti con componenti plurime. Saranno altresì apprezzate cuciture, elasticità, minore rigidità) e sanificazione	1,5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,900	1,000	0,000	0,800	
			Dott. Giulio Bovio	0,900	1,000	0,000	0,800	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,00	0,000	0,800	
			Media coefficienti	0,867	1,000	0,000	0,800	
			riportata a 1	0,87	1,00	0,00	0,80	
			<i>Punteggio</i>	1,300	1,500	0,000	1,200	
Peso (Kg/m2) al valore di assorbimento di 0.35 mm PbEq	4	Q4*		3,79	3,780	3,900	3,900	4,68
			<i>Punteggio</i>	3,956	4,000	3,467	3,467	
Caratteristiche di funzionalità (sistemi di chiusura e vestibilità)	3	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,900	1,000	0,000	0,500	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	0,000	0,600	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,000	0,000	0,600	
			Media coefficienti	0,833	1,000	0,000	0,567	
			riportata a 1	0,83	1,00	0,00	0,57	
			<i>Punteggio</i>	2,500	3,000	0,000	1,700	
Modalità di realizzazione della Tracciabilità sicura dei prodotti.	1,5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,700	1,000	0,700	1,000	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	0,800	1,000	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,00	0,800	1,00	
			Media coefficienti	0,767	1,000	0,767	1,000	
			riportata a 1	0,77	1,00	0,77	1,00	
			<i>Punteggio</i>	1,150	1,500	1,150	1,500	
Totale punteggio di qualità	15,000			13,425	15,000	9,173	12,419	
Totale punteggio di qualità riparametrato	15,000			13,425	15,000	9,173	12,419	

LOTTO 1 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'OPERATORE

Ref. 1.4 - Grembiule anti-x frontale con protezione anteriore 0.50 mm PbEq e protezione scapolare 0.25 mm.mm pbeq	Max punti			CEA X310AL50+R127 o R128+XXAT	SAGO XRFADFGARSLF	CLINILAB 1107HBLF5025	SERVIZI OSPEDALIERI	
Caratteristiche di protezione	1	Q3*	60 (kVp) – Assorbimento	99,600	99,750	99,800	99,810	79,68
			<i>Punteggio</i>	0,990	0,997	1,000	1,000	
	1		70 (kVp) – Assorbimento	99,100	99,320	99,300	99,260	79,28
			<i>Punteggio</i>	0,989	1,000	0,999	0,997	
	0,5		90 (kVp) – Assorbimento	96,700	97,500	97,200	97,200	77,36
			<i>Punteggio</i>	0,480	0,500	0,493	0,493	
0,5	120 (kVp) – Assorbimento	94,700	95,090	94,800	94,800	75,76		
	<i>Punteggio</i>	0,490	0,500	0,492	0,492			
Taglie e personalizzazione	2	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,800	1,000	0,800	0,800	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	0,800	0,800	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,000	0,800	0,800	
			Media coefficienti	0,800	1,000	0,800	0,800	
			riportata a 1	0,80	1,00	0,80	0,80	
			<i>Punteggio</i>	1,600	2,000	1,600	1,600	
Materiale (Sono da preferire i prodotti con componenti plurime. Saranno altresì apprezzate cuciture, elasticità, minore rigidità) e sanificazione	1,5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,900	1,000	0,800	0,800	
			Dott. Giulio Bovio	0,900	1,000	0,800	0,800	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,00	0,800	0,800	
			Media coefficienti	0,867	1,000	0,800	0,800	
			riportata a 1	0,87	1,00	0,80	0,80	
			<i>Punteggio</i>	1,300	1,500	1,200	1,200	
Peso (Kg/m2) al valore di assorbimento di 0.50 mm PbEq	4	Q4*		5,530	5,270	5,680	5,680	6,816
			<i>Punteggio</i>	3,327	4,000	2,939	2,939	
Caratteristiche di funzionalità (sistemi di chiusura e vestibilità)	3	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,900	1,000	0,000	0,500	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	0,000	0,500	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,000	0,000	0,500	
			Media coefficienti	0,833	1,000	0,000	0,500	
			riportata a 1	0,83	1,00	0,00	0,50	
			<i>Punteggio</i>	2,500	3,000	0,000	1,500	
Modalità di realizzazione della Tracciabilità sicura dei prodotti.	1,5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,700	1,000	0,700	1,000	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	0,800	1,000	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,00	0,800	1,00	
			Media coefficienti	0,767	1,000	0,767	1,000	
			riportata a 1	0,77	1,00	0,77	1,00	
			<i>Punteggio</i>	1,150	1,500	1,150	1,500	

Totale punteggio di qualità	15,000			12,826	14,997	9,873	11,721
Totale punteggio di qualità riparametrato	15,000			12,828	15,000	9,875	11,724

70,000			51,457	70,000	47,180	55,725
70,000			51,457	70,000	47,180	55,725

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top, initials 'CB' in the middle, and other scribbles at the bottom.

LOTTO 2 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OPERATORI: GREMBIULI SPEZZATI

Ref. 2.1 - Grembiule spezzato standard: gonna anti-X + corpetto anti-X (0.50 Ant. e 0.25 Post.)	Max punti			CEA Corpetto X325V50 "FULL OVERLAP"; Gonna X330S50	SAGO MEDICA Corpetto XRSADCYAMSLF; Gonna XRCADCXACSLF + XRASB (cintura lombare integrata	SERVIZI OSPEDALIERI Corpetto con sovrapposizion e totale CRX022525S; Gonna GRX012525S	
Caratteristiche di protezione	1	Q3*	60 (kVp) – Assorbimento	99,600	99,750	99,810	79,68
			<i>Punteggio</i>	0,990	0,997	1,000	
	1		70 (kVp) – Assorbimento	99,100	99,320	99,260	79,28
			<i>Punteggio</i>	0,989	1,000	0,997	
	0,5		90 (kVp) – Assorbimento	96,700	97,500	97,200	77,36
			<i>Punteggio</i>	0,480	0,500	0,493	
	0,5		120 (kVp) – Assorbimento	94,700	95,090	94,800	75,76
			<i>Punteggio</i>	0,490	0,500	0,492	
Taglie e personalizzazione	2	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,800	1,000	0,800	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	0,800	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,000	0,800	
			Media coefficienti	0,800	1,000	0,800	
			riportata a 1	0,80	1,00	0,80	
			<i>Punteggio</i>	1,600	2,000	1,600	
Materiale (Sono da preferire i prodotti con componenti plurime. Saranno altresì apprezzate cuciture, elasticità, minore rigidità) e sanificazione	1,5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,900	1,000	0,800	
			Dott. Giulio Bovio	0,900	1,000	0,800	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,00	0,80	
			Media coefficienti	0,867	1,000	0,800	
			riportata a 1	0,87	1,00	0,80	
			<i>Punteggio</i>	1,300	1,500	1,200	
Peso (Kg/m2) al valore di assorbimento di 0.50 mm PbEq	5	Q4*		5,53	5,270	5,680	6,816
				<i>Punteggio</i>	4,159	5,000	3,674
Caratteristiche di funzionalità (sistemi di chiusura e vestibilità)	4	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,800	1,000	0,500	
			Dott. Giulio Bovio	0,700	1,000	0,500	
			Ing. Alessandro Gallo	0,700	1,000	0,500	
			Media coefficienti	0,733	1,000	0,500	
			riportata a 1	0,73	1,00	0,50	
			<i>Punteggio</i>	2,933	4,000	2,000	
Modalità di realizzazione della Tracciabilità sicura dei prodotti.	1,5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,700	1,000	1,000	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	1,000	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,000	1,00	
			Media coefficienti	0,767	1,000	1,000	
			riportata a 1	0,77	1,00	1,00	
			<i>Punteggio</i>	1,150	1,500	1,500	
Totale punteggio di qualità	17,000			14,091	16,997	12,956	
Totale punteggio di qualità riparametrato	17,000			14,093	17,000	12,958	







LOTTO 2 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OPERATORI: GREMBIULI SPEZZATI

Ref. 2.2 - Grembiule spezzato standard: gonna anti-X + corpetto anti-X (0.25 Ant. e 0.25 Post.)	Max punti			CEA Cod. prodotto offerto: Corpetto X325V25 "FULL OVERLAP"; Gonna X330S25	SAGO MEDICA Corpetto XRSADCYAGSLF; Gonna XRCADCXAUSLF + XRASB (cintura lombare integrata	SERVIZI OSPEDALIERI GRX012525U + GRX012525	
Caratteristiche di protezione	1	Q3*	60 (kVp) – Assorbimento	97,800	97,800	97,650	78,12
			<i>Punteggio</i>	1,000	1,000	0,992	
	1		70 (kVp) – Assorbimento	96,190	96,190	95,670	76,536
			<i>Punteggio</i>	1,000	1,000	0,974	
	0,5		90 (kVp) – Assorbimento	91,730	91,730	90,930	72,744
			<i>Punteggio</i>	0,500	0,500	0,479	
	0,5		120 (kVp) – Assorbimento	87,400	87,400	85,800	68,64
			<i>Punteggio</i>	0,500	0,500	0,457	
Taglie e personalizzazione	2	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,800	1,000	0,800	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	0,800	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,000	0,800	
			Media coefficienti	0,800	1,000	0,800	
			riportata a 1	0,80	1,00	0,80	
			<i>Punteggio</i>	1,600	2,000	1,600	
Materiale (Sono da preferire i prodotti con componenti plurime. Saranno altresì apprezzate cuciture, elasticità, minore rigidità) e sanificazione	1,5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,900	1,000	0,800	
			Dott. Giulio Bovio	0,900	1,000	0,800	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,000	0,80	
			Media coefficienti	0,867	1,000	0,800	
			riportata a 1	0,87	1,00	0,80	
			<i>Punteggio</i>	1,300	1,500	1,200	
Peso (Kg/m2) al valore di assorbimento di 0.25 mm PbEq	5	Q4*		2,76	2,760	2,800	3,36
			<i>Punteggio</i>	5,000	5,000	4,667	
Caratteristiche di funzionalità (sistemi di chiusura e vestibilità)	4	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,800	1,000	0,500	
			Dott. Giulio Bovio	0,700	1,000	0,700	
			Ing. Alessandro Gallo	0,700	1,000	0,600	
			Media coefficienti	0,733	1,000	0,600	
			riportata a 1	0,73	1,00	0,60	
			<i>Punteggio</i>	2,933	4,000	2,400	
Modalità di realizzazione della Tracciabilità sicura dei prodotti.	1,5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,700	1,000	1,000	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	1,000	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,000	1,00	
			Media coefficienti	0,767	1,000	1,000	
			riportata a 1	0,77	1,00	1,00	
			<i>Punteggio</i>	1,150	1,500	1,500	
Totale punteggio di qualità	17,000			14,983	17,000	14,269	
Totale punteggio di qualità riparametrato	17,000			14,983	17,000	14,269	

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top, a signature below it, and several initials and marks at the bottom.

LOTTO 2 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OPERATORI: GREMBIULI SPEZZATI

Ref. 2.3 - Grembiule spezzato ergonomico: gonna anti-X + corpetto anti-X (0.50' Ant. e 0.25 Post.)	Max punti			CEA	SAGO MEDICA	SERVIZI OSPEDALIERI CRX055025 + GRX012525S	
Caratteristiche di protezione	1	Q3*	60 (kVp) – Assorbimento	99,600	99,750	99,810	79,68
			<i>Punteggio</i>	1,000	0,997	1,000	
	1		70 (kVp) – Assorbimento	99,100	99,320	99,260	79,28
			<i>Punteggio</i>	0,989	1,000	0,997	
	0,5		90 (kVp) – Assorbimento	96,700	97,500	97,200	77,36
			<i>Punteggio</i>	0,480	0,500	0,493	
	0,5		120 (kVp) – Assorbimento	94,700	95,090	94,800	75,76
			<i>Punteggio</i>	0,490	0,500	0,492	
Taglie e personalizzazione	2	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,800	1,000	0,800	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	0,8	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,000	0,800	
			Media coefficienti	0,800	1,000	0,800	
			riportata a 1	0,80	1,00	0,80	
			<i>Punteggio</i>	1,600	2,000	1,600	
Materiale (Sono da preferire i prodotti con componenti plurime. Saranno altresì apprezzate cuciture, elasticità, minore rigidità) e sanificazione	1,5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,900	1,000	0,700	
			Dott. Giulio Bovio	0,900	1,000	0,700	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,00	0,60	
			Media coefficienti	0,867	1,000	0,667	
			riportata a 1	0,87	1,00	0,67	
			<i>Punteggio</i>	1,300	1,500	1,000	
Peso (Kg/m2) al valore di assorbimento di 0.50 mm PbEq	5	Q4*		5,53	5,270	5,680	6,816
			<i>Punteggio</i>	4,159	5,000	3,674	
Caratteristiche di funzionalità (sistemi di chiusura e vestibilità)	5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,200	1,000	0,100	
			Dott. Giulio Bovio	0,100	1,000	0,100	
			Ing. Alessandro Gallo	0,100	1,000	0,100	
			Media coefficienti	0,133	1,000	0,100	
			riportata a 1	0,13	1,00	0,10	
			<i>Punteggio</i>	0,667	5,000	0,500	
Modalità di realizzazione della Tracciabilità sicura dei prodotti.	1,5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,700	1,000	1,000	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	1,000	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,000	1,00	
			Media coefficienti	0,767	1,000	1,000	
			riportata a 1	0,77	1,00	1,00	
			<i>Punteggio</i>	1,150	1,500	1,500	
Totale punteggio di qualità	18,000			11,835	17,997	11,256	
Totale punteggio di qualità riparametrato	18,000			11,837	18,000	11,258	

FR

CB

FF

JK

LOTTO 2 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OPERATORI: GREMBIULI SPEZZATI

Ref. 2.4 - Grembiule spezzato ergonomico: gonna anti-X + corpetto anti-X (0.25 Ant. e 0.25 Post.)	Max punti			CEA X330S25+X335V25 +R127 o R128+XXAT	SAGO MEDICA XRSADCYAGSLF (corpetto) XRCADCXAUSLF_X RASB (gonna)	SERVIZI OSPEDALIERI GRX052525 + GRX012525	
Caratteristiche di protezione	1	Q3*	60 (kVp) – Assorbimento	97,500	97,800	97,650	78,00
			<i>Punteggio</i>	0,985	1,000	0,992	
	1		70 (kVp) – Assorbimento	95,600	96,190	95,670	76,952
			<i>Punteggio</i>	0,968	1,000	0,973	
	0,5		90 (kVp) – Assorbimento	90,100	91,730	90,930	72,08
			<i>Punteggio</i>	0,459	0,500	0,480	
0,5	120 (kVp) – Assorbimento	85,600	87,400	85,800	68,48		
	<i>Punteggio</i>	0,452	0,500	0,458			
Taglie e personalizzazione	2	Q1	Dott.ssa Franca Fopplano	0,800	1,000	0,800	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	0,800	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,000	0,800	
			Media coefficienti	0,800	1,000	0,800	
			riportata a 1	0,80	1,00	0,80	
			<i>Punteggio</i>	1,600	2,000	1,600	
Materiale (Sono da preferire i prodotti con componenti plurime. Saranno altresì apprezzate cuciture, elasticità, minore rigidità) e sanificazione	1,5	Q1	Dott.ssa Franca Fopplano	0,900	1,000	0,800	
			Dott. Giulio Bovio	0,900	1,000	0,800	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,00	0,80	
			Media coefficienti	0,867	1,000	0,800	
			riportata a 1	0,87	1,00	0,80	
			<i>Punteggio</i>	1,300	1,500	1,200	
Peso (Kg/m2) al valore di assorbimento di 0.25 mm PbEq	5	Q4*		2,77	2,760	2,800	3,36
			<i>Punteggio</i>	4,917	5,000	4,667	
Caratteristiche di funzionalità (sistemi di chiusura e vestibilità)	5	Q1	Dott.ssa Franca Fopplano	0,200	1,000	0,100	
			Dott. Giulio Bovio	0,100	1,000	0,100	
			Ing. Alessandro Gallo	0,100	1,000	0,100	
			Media coefficienti	0,133	1,000	0,100	
			riportata a 1	0,13	1,00	0,10	
			<i>Punteggio</i>	0,667	5,000	0,500	
Modalità di realizzazione della Tracciabilità sicura dei prodotti.	1,5	Q1	Dott.ssa Franca Fopplano	0,700	1,000	1,000	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	1,000	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,000	1,00	
			Media coefficienti	0,767	1,000	1,000	
			riportata a 1	0,77	1,00	1,00	
			<i>Punteggio</i>	1,150	1,500	1,500	

Totale punteggio di qualità	18,000			12,497	18,000	12,369
Totale punteggio di qualità riparametrato	18,000			12,497	18,000	12,369

70,000			53,410	70,000	50,855
70,000			53,410	70,000	50,855

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top, initials 'CB' in the middle, and several other signatures at the bottom.

LOTTO 3 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OPERATORI: COLLARI

Ref. 3.1a - Collare anti-X	Max punti			CEA 340T 0,50	SAGO MEDICA COLLARE TIPO B	SERVIZI OSPEDALIERI Collare anti-X TRX0250-4	
Caratteristiche di protezione	8	Q3*	60 (kVp) – Assorbimento	99,600	99,750	99,810	79,68
			<i>Punteggio</i>	7,917	7,976	8,000	
	8		70 (kVp) – Assorbimento	99,100	99,320	99,260	79,28
			<i>Punteggio</i>	7,910	8,000	7,976	
	4		90 (kVp) – Assorbimento	96,700	97,500	97,200	77,36
			<i>Punteggio</i>	3,841	4,000	3,940	
4	120 (kVp) – Assorbimento	94,700	95,090	94,800	75,76		
	<i>Punteggio</i>	3,919	4,000	3,940			
Taglie e personalizzazione	3	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	1,000	0,800	0,800	
			Dott. Giulio Bovio	1,000	0,800	0,800	
			Ing. Alessandro Gallo	1,000	0,800	0,800	
			Media coefficienti	1,000	0,800	0,800	
			riportata a 1	1,00	0,80	0,80	
			<i>Punteggio</i>	3,000	2,400	2,400	
Materiale (Sono da preferire i prodotti con componenti plurime. Saranno altresì apprezzate cuciture, elasticità, minore rigidità) e sanificazione	3	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	1,000	0,600	0,500	
			Dott. Giulio Bovio	1,000	0,600	0,500	
			Ing. Alessandro Gallo	1,000	0,60	0,50	
			Media coefficienti	1,000	0,600	0,500	
			riportata a 1	1,00	0,60	0,50	
			<i>Punteggio</i>	3,000	1,800	1,500	
Peso (Kg/m2) al valore di assorbimento di 0.50 mm PbEq	20	Q4*		5,53	5,270	5,680	6,816
			<i>Punteggio</i>	16,636	20,000	14,696	
Caratteristiche di funzionalità: sistemi di chiusura e vestibilità. In riferimento alla voce "vestibilità" saranno valutati sia il comfort e l'ampiezza del dispositivo sia la disponibilità di più taglie rispetto alla taglia unica.	15	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	1,000	0,600	0,600	
			Dott. Giulio Bovio	1,000	0,500	0,500	
			Ing. Alessandro Gallo	1,000	0,600	0,600	
			Media coefficienti	1,000	0,567	0,567	
			riportata a 1	1,00	0,57	0,57	
			<i>Punteggio</i>	15,000	8,500	8,500	
Modalità di realizzazione della Tracciabilità sicura dei prodotti.	5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,700	1,000	1,000	
			Dott. Giulio Bovio	0,800	1,000	1,000	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,00	1,00	
			Media coefficienti	0,767	1,000	1,000	
			riportata a 1	0,77	1,00	1,00	
			<i>Punteggio</i>	3,833	5,000	5,000	
Totale punteggio di qualità	70,000			65,057	61,676	55,952	
Totale punteggio di qualità riparametrato	70,000			70,000	66,362	60,204	

LOTTO 4 - OCCHIALI A PROTEZIONE RADIAZIONI IONIZZANTI

Ref. 4.1 - Occhiali con lenti di protezione dalle radiazioni ionizzanti sovrapponibili ad altri occhiali	Max punti			CEA RLT-400.A FGUARD- A	CLINILAB ES90	SAGO MEDICA XTRG33BK50SS Mod. FIT OVER RG33	
Caratteristiche di protezione	3	Q3*	150 (kVp) – Assorbimento	97,400	94,350	99,720	75,48
			<i>Punteggio</i>	2,713	2,335	3,000	
Vestibilità in termini di: • Ergonomia • Aderenza al viso	5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	1,000	1,000	1,000	
			Dott. Giulio Bovio	1,000	1,00	1,00	
			Ing. Alessandro Gallo	1,000	1,00	1,00	
			Media coefficienti	1,000	1,000	1,000	
			riportata a 1	1,00	1,00	1,00	
			<i>Punteggio</i>	5,000	5,000	5,000	
Presenza di inserti morbidi nelle stanghette e nel nasello	1	Q5	presente/assente	assente	assente	assente	
			<i>Punteggio</i>	0,000	0,000	0,000	
Peso	4	Q4	grammi	91,00	85,00	90,00	100
			<i>Punteggio</i>	2,400	4,000	2,667	
Modalità di allocamento del dosimetro	1	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	1,000	1,000	1,000	
			Dott. Giulio Bovio	1,000	1,00	1,00	
			Ing. Alessandro Gallo	1,000	1,00	1,00	
			Media coefficienti	1,000	1,000	1,000	
			riportata a 1	1,00	1,00	1,00	
			<i>Punteggio</i>	1,000	1,000	1,000	

Totale punteggio di qualità	14,000			11,113	12,335	11,667
------------------------------------	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Totale punteggio di qualità riparametrato	14,000			12,613	14,000	13,241
--	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

70,000				68,613	56,629	65,406
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

70,000				70,000	57,774	66,728
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

LOTTO 4 - OCCHIALI A PROTEZIONE RADIAZIONI IONIZZANTI

Ref. 4.2 - Occhiale anti-x non graduato leggero con protezione laterale	Max punti			CEA R9941UL+RPL	CLINILAB ES52 Sport Wrap	SAGO MEDICA XTRG1388S50S S Mod. RG1388	
Caratteristiche di protezione	3	Q3*	150 (kVp) – Assorbimento	97,400	94,350	99,720	75,48
			<i>Punteggio</i>	2,713	2,335	3,000	
Vestibilità in termini di: • Ergonomia • Aderenza al viso	5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,500	0,900	1,000	
			Dott. Giulio Bovio	0,500	1,000	0,900	
			Ing. Alessandro Gallo	0,500	1,000	0,90	
			Media coefficienti	0,500	0,967	0,933	
			riportata a 1	0,52	1,00	0,97	
			<i>Punteggio</i>	2,586	5,000	4,828	
Presenza di inserti morbidi nelle stanghette e nel nasello	1	Q5	presente/assente	presente	presente	presente	
			<i>Punteggio</i>	1,000	1,000	1,000	
Peso	4	Q4		64,0	70,0	75,0	80
			<i>Punteggio</i>	4,000	2,500	1,250	
Modalità di allocamento del dosimetro	1	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	1,000	1,000	1,000	
			Dott. Giulio Bovio	1,000	1,000	1,00	
			Ing. Alessandro Gallo	1,000	1,000	1,00	
			Media coefficienti	1,000	1,000	1,000	
			riportata a 1	1,00	1,00	1,00	
			<i>Punteggio</i>	1,000	1,000	1,000	

Totale punteggio di qualità	14,000			11,299	11,835	11,078	
Totale punteggio di qualità riparametrato	14,000			13,366	14,000	13,104	

LOTTO 4 - OCCHIALI A PROTEZIONE RADIAZIONI IONIZZANTI

Ref. 4.3 - Occhiale anti-X non graduato standard con protezione laterale	Max punti			GEA modello Proguard Leader Cod. ROG220S	CLINILAB ES250	SAGO MEDICA XTRG206050SS Mod. RG206 OB	
Caratteristiche di protezione	3	Q3*	150 (kVp) – Assorbimento	97,300	94,350	99,720	75,48
			<i>Punteggio</i>	2,700	2,335	3,000	
Vestibilità in termini di: • Ergonomia • Aderenza al viso	5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	1,000	0,600	0,900	
			Dott. Giulio Bovio	1,000	0,400	0,90	
			Ing. Alessandro Gallo	0,900	0,600	1,000	
			Media coefficienti	0,967	0,533	0,933	
			riportata a 1	1,00	0,55	0,97	
			<i>Punteggio</i>	5,000	2,759	4,828	
Presenza di inserti morbidi nelle stanghette e nel nasello	1	Q5	presente/assente	presente	assente	presente	
			<i>Punteggio</i>	1,000	0,000	1,000	
Peso	4	Q4		73,30	89,00	75,00	100
			<i>Punteggio</i>	4,000	1,648	3,745	
Modalità di allocamento del dosimetro	1	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	1,000	1,000	1,000	
			Dott. Giulio Bovio	1,000	1,000	1,000	
			Ing. Alessandro Gallo	1,000	1,000	1,000	
			Media coefficienti	1,000	1,000	1,000	
			riportata a 1	1,00	1,00	1,00	
			<i>Punteggio</i>	1,000	1,000	1,000	

Totale punteggio di qualità	14,000			13,700	7,742	13,573	
------------------------------------	---------------	--	--	---------------	--------------	---------------	--

Totale punteggio di qualità riparametrato	14,000			14,000	7,986	13,870	
--	---------------	--	--	---------------	--------------	---------------	--

LOTTO 4 - OCCHIALI A PROTEZIONE RADIAZIONI IONIZZANTI

Ref. 4.4 - Occhiale anti-X graduato leggero con protezione laterale	Max punti			CEA R9941UL+RPL o R9941UL- SMALL+RPL +R170 o R171 o R172 o R174	CLINILAB ES52-XX Sport Wrap	SAGO MEDICA XTRG206OBFT2 850SS Mod. RG206	
Caratteristiche di protezione	3	Q3*	150 (kVp) – Assorbimento	97,400	94,350	99,720	75,48
			<i>Punteggio</i>	2,713	2,335	3,000	
Vestibilità in termini di: • Ergonomia • Aderenza al viso	5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,700	0,900	0,900	
			Dott. Giulio Bovio	0,700	1,000	0,900	
			Ing. Alessandro Gallo	0,800	1,000	1,000	
			Media coefficienti	0,733	0,967	0,933	
			riportata a 1	0,76	1,00	0,97	
			<i>Punteggio</i>	3,793	5,000	4,828	
Presenza di inserti morbidi nelle stanghette e nel nasello	1	Q5	presente/assente	presente	presente	presente	
			<i>Punteggio</i>	1,000	1,000	1,000	
Peso	4	Q4		64,0	70,0	75,00	80
			<i>Punteggio</i>	4,000	2,500	1,250	
Modalità di allocamento del dosimetro	1	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	1,000	1,000	1,000	
			Dott. Giulio Bovio	1,000	1,000	1,000	
			Ing. Alessandro Gallo	1,000	1,000	1,000	
			Media coefficienti	1,000	1,000	1,000	
			riportata a 1	1,00	1,00	1,00	
			<i>Punteggio</i>	1,000	1,000	1,000	
Totale punteggio di qualità	14,000			12,506	11,835	11,078	
Totale punteggio di qualità riparametrato	14,000			14,000	13,249	12,401	

LOTTO 4 - OCCHIALI A PROTEZIONE RADIAZIONI IONIZZANTI

Ref. 4.5 - Occhiale anti-X graduato standard con protezione laterale	Max punti			CEA modello Proguard Leader Cod. ROG220S	CLINILAB ES250	SAGO MEDICA XTRG206O50SS Mod. RG206 OB	
Caratteristiche di protezione	3	Q3*	150 (kVp) – Assorbimento	98,630	94,350	99,720	75,48
			<i>Punteggio</i>	2,865	2,335	3,000	
Vestibilità in termini di: • Ergonomia • Aderenza al viso	5	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	1,000	0,600	0,900	
			Dott. Giulio Bovio	1,000	0,400	0,90	
			Ing. Alessandro Gallo	0,900	0,600	1,000	
			Media coefficienti	0,967	0,533	0,933	
			riportata a 1	1,00	0,55	0,97	
			<i>Punteggio</i>	5,000	2,759	4,828	
Presenza di inserti morbidi nelle stanghette e nel nasello	1	Q5	presente/assente	presente	assente	presente	
			<i>Punteggio</i>	1,000	0,000	1,000	
Peso	4	Q4		73,30	89,00	75,00	100
			<i>Punteggio</i>	4,000	1,648	3,745	
Modalità di allocamento del dosimetro	1	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	1,000	1,000	1,000	
			Dott. Giulio Bovio	1,000	1,000	1,000	
			Ing. Alessandro Gallo	1,000	1,000	1,000	
			Media coefficienti	1,000	1,000	1,000	
			riportata a 1	1,00	1,00	1,00	
			<i>Punteggio</i>	1,000	1,000	1,000	

Totale punteggio di qualità	14,000			13,865	7,742	13,573	
Totale punteggio di qualità riparametrato	14,000			14,000	7,817	13,705	

LOTTO 6 - GUANTI ATTENUATORI DI RADIAZIONI IONIZZANTI MONOUSO

Ref. 6.1 - Guanti anti-X sterili monouso sottili	Max punti			BERIGAH Model 2 Cod. prod. IG270 (7.0) - IG275 (7.5) - IG280 (8.0) - IG285 (8.5) - IG290 (9.0)	CEA Freeguard Model 2 TG 7 - 7,5 - 8 - 8,5	CHEMIL Freeguard Model 2 TG 7 - 7,5 - 8 - 8,5	CLINILAB RADIAXON Cod. prod. R3570-85; R3575-85; R3580-85; R3585-85	
Caratteristiche di protezione	5	Q3*	60 (kVp) - Assorbimento	52,000	63,000	63,000	63,020	41,6
			<i>Punteggio</i>	5,000	4,995	4,995	5,000	
	5		80 (kVp) - Assorbimento	44,000	56,000	56,000	53,670	35,2
			<i>Punteggio</i>	0,833	5,000	5,000	4,440	
	2,5		100 (kVp) - Assorbimento	40,000	50,000	50,000	48,530	32
			<i>Punteggio</i>	1,111	2,500	2,500	2,296	
2,5	120 (kVp) - Assorbimento	36,000	43,000	43,000	43,110	28,8		
	<i>Punteggio</i>	1,258	2,481	2,481	2,500			
Caratteristiche di vestibilità: facilità di accesso al dispositivo in relazione al confezionamento, conformazione anatomica, semplici da indossare e togliere, sensibilità tattile e aderenza in relazione alla destinazione d'uso	10	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	1,000	0,800	0,800	0,700	
			Dott. Giulio Bovio	1,000	0,800	0,800	0,700	
			Ing. Alessandro Gallo	1,000	0,800	0,800	0,700	
			Media coefficienti	1,000	0,800	0,800	0,700	
			riportata a 1	1,00	0,80	0,80	0,70	
			<i>Punteggio</i>	10,000	8,000	8,000	7,000	
Caratteristiche di funzionalità: elasticità e resistenza agli strappi, grip.	10	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	1,000	0,900	0,900	0,700	
			Dott. Giulio Bovio	1,000	0,900	0,900	0,700	
			Ing. Alessandro Gallo	1,000	0,900	0,900	0,700	
			Media coefficienti	1,000	0,900	0,900	0,700	
			riportata a 1	1,00	0,90	0,90	0,70	
			<i>Punteggio</i>	10,000	9,000	9,000	7,000	

Totale punteggio di qualità	35,000			28,202	31,976	31,976	28,236
Totale punteggio di qualità riparametrato	35,000			30,869	35,000	35,000	30,906

LOTTO 6 - GUANTI ATTENUATORI DI RADIAZIONI IONIZZANTI MONOUSO

Ref. 6.2 - Guanti anti-X sterili monouso ultrasottili	Max punti			BERICAH Ineguard Model 1Cod. prod. IG170 (7.0) – IG175 (7.5) – IG180 (8.0) – IG185 (8.5) – IG190 (9.0)	GEA Freeguard Model 1 TG 7 - 7,5 - 8 - 8,5	CHEMIL Freeguard Model 1 TG 7 - 7,5 - 8 - 8,5	CLINILAB RADIAXON SENSITIVE Cod. prod. R3570-86; R3575-86; R3580- 86; R3585-86	
Caratteristiche di protezione	5	Q3*	60 (kVp) – Assorbimento	61,000	55,000	55,000	68,040	44
			<i>Punteggio</i>	3,536	2,288	2,288	5,000	
	5		80 (kVp) – Assorbimento	54,000	48,000	48,000	58,000	38,4
			<i>Punteggio</i>	3,571	2,449	2,449	5,000	
	2,5		100 (kVp) – Assorbimento	49,000	43,000	43,000	52,030	34,4
			<i>Punteggio</i>	2,070	1,220	1,220	2,500	
	2,5		120 (kVp) – Assorbimento	45,000	37,000	37,000	47,070	29,06
			<i>Punteggio</i>	2,213	1,102	1,102	2,500	
Caratteristiche di vestibilità: facilità di accesso al dispositivo in relazione al confezionamento, conformazione anatomica, semplici da indossare e togliere, sensibilità tattile e aderenza in relazione alla destinazione d'uso	10	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	1,000	0,900	0,900	0,600	
			Dott. Giulio Bovio	1,000	0,900	0,900	0,600	
			Ing. Alessandro Gallo	1,000	0,900	0,900	0,600	
			Media coefficienti	1,000	0,900	0,900	0,600	
			riportata a 1	1,00	0,90	0,90	0,60	
			<i>Punteggio</i>	10,000	9,000	9,000	6,000	
Caratteristiche di funzionalità: elasticità e resistenza agli strappi, grip.	10	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	0,500	0,700	0,700	0,500	
			Dott. Giulio Bovio	0,300	0,700	0,700	0,500	
			Ing. Alessandro Gallo	0,500	0,70	0,70	0,50	
			Media coefficienti	0,433	0,700	0,700	0,500	
			riportata a 1	0,62	1,00	1,00	0,71	
			<i>Punteggio</i>	6,190	10,000	10,000	7,143	

Totale punteggio di qualità	35,000			27,581	26,059	26,059	28,143
------------------------------------	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Totale punteggio di qualità riparametrato	35,000			34,301	32,408	32,408	35,000
--	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------


70,000				65,170	67,408	67,408	65,906
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

70,000				67,676	70,000	70,000	68,440
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

LOTTO 7 - TELI ANTI X DIFFUSA STERILI PER LA PROTEZIONE DELL'OPERATORE

Ref. 7 - Teli anti X diffusa sterili per la protezione dell'operatore	Max punti			ECOLAB RBFPS101
Caratteristiche di protezione	16	Q3	60 (kVp) – Assorbimento	93,700
			<i>Punteggio</i>	16,000
	8		80 (kVp) – Assorbimento	90,100
			<i>Punteggio</i>	8,000
	8		100 (kVp) – Assorbimento	83,900
			<i>Punteggio</i>	8,000
Composizione e misure	13	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	1,000
			Dott. Giulio Bovio	1,000
			Ing. Alessandro Gallo	1,000
			Media coefficienti	1,000
			riportata a 1	1,00
			<i>Punteggio</i>	13,000
Caratteristiche di funzionalità (colore, resistenza, morbidezza)	25	Q1	Dott.ssa Franca Foppiano	1,000
			Dott. Giulio Bovio	1,000
			Ing. Alessandro Gallo	1,000
			Media coefficienti	1,000
			riportata a 1	1,00
			<i>Punteggio</i>	25,000
Totale punteggio di qualità	70,000			70,000
Totale punteggio di qualità riparametrato	70,000			70,000

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature at the top, followed by several smaller initials and signatures.



REGIONE LIGURIA

 DIREZIONE CENTRALE
 ORGANIZZAZIONE

 SETTORE
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 REGIONALE

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti – Dott.ssa Paola Gerbino

gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di Radioprotezione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti 8, Importo presunto di gara: € 1.311.066,24 (Iva esclusa), gara n. 8314394. ID Sintel 146672404

13^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Verbale di valutazione della documentazione tecnica

Il giorno 30/03/2023, alle ore 09:15 presso Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante/Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, 2° piano si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto per la verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe, nominata con Decreto n. 3536 del 06/06/2022, nelle persone di:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott.ssa Franca Foppiano	ASL 5	Direttore S.C. Fisica sanitaria Dip. Oncologico
Componente	Dott. Giulio Bovio	Policlinico San Martino	Dirigente medico U.O. Radiologia interventistica
Componente	Ing. Alessandro Gallo	ASL 3	Responsabile SPP

Risultano altresì presente la Sig.a Loredana Lotti - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara e Referente della procedura, con funzioni di Segretario Verbalizzante, e la dott.ssa Paola Gerbino - Funzionario della SUAR – Componente del Seggio di gara.

Premesso che con avviso Prot-2023-0314590 del 29/03/2023 è stata convocata per la giornata odierna alle ore 10,00 la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche dei Lotti 1 – 2 – 3 – 4 – 6 - 7 della presente procedura di gara, la Commissione giudicatrice, tenuto conto dell'esito delle attività valutative compiute nel corso delle sedute precedenti (verbali Prot-2023-0054789-Verbale 1^ seduta riservata C.G., Prot-2023-0054799-Verbale 2^ seduta riservata C.G., Prot-2023-0054802-Verbale 3^

seduta riservata C.G., Prot-2023-0054805-Verbale 4^ seduta riservata C.G., Prot-2023-0054810-Verbale 5^ seduta riservata C.G., Prot-2023-0054823-Verbale 6^ seduta riservata C.G., Prot-2023-0054834-Verbale 7^ seduta riservata C.G., Prot-2023-0054843-Verbale 8^ seduta riservata C.G., Prot-2023-0318326 Verbale 10^ seduta riservata C.G., Prot-2023-0318342 Verbale 11^ seduta riservata C.G., Prot-2023-0318367 Verbale 12^ seduta riservata C.G) e dopo aver visionato il riepilogo dei punteggi tecnici assegnati alle offerte tecniche dei concorrenti, procede all'imputazione degli stessi sulla piattaforma telematica SinTel attraverso la quale verranno effettuate le operazioni di gara.


I punteggi tecnici finali, così come cristallizzati nei files Excel allegati al verbale della seduta del 16/03/2023 verbale (Prot-2023-0318367), a seguito dell'arrotondamento a due decimali richiesto dalla piattaforma Sintel, risultano essere i seguenti:

Lotto	Ditta concorrente	Punteggio offerta tecnica (max 70 pt)
1	Cea S.p.A.	51,46
	Clini-lab S.r.l.	47,18
	Sago Medica S.r.l.	70,00
	Servizi ospedalieri S.r.l	55,72
2	Cea S.p.A.	53,41
	Sago Medica S.r.l.	70,00
	Servizi ospedalieri S.r.l	50,85
3	Cea S.p.A.	70,00
	Sago Medica S.r.l.	66,36
	Servizi ospedalieri S.r.l	60,20
4	Cea S.p.A.	70,00
	Clini-lab S.r.l.	57,77
	Sago Medica S.r.l.	66,73
5	DESERTO	
6	Bericah S.p.A.	67,68
	Cea S.p.A.	70,00
	Chemil S.r.l.	70,00
	Clini-lab S.r.l.	68,44
7	Microteck Italy S.r.l.	70,00

Alle ore 09:50, la seduta termina, onde consentire l'avvio della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Franca Foppiano



Dott. Giulio Bovio











Ing. Alessandro Gallo




Sig.ra Loredana Lotti



Dott.ssa Paola Gerbino



**REGIONE LIGURIA**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONESETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "Sistemi di Radioprotezione" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Gara n. 8314394.

SEDUTA PUBBLICA**Verbale di apertura delle offerte economiche**

Il giorno 30/03/2023 alle ore 10:10 presso una Sala riunioni della SUAR, sita in via G. D'Annunzio 64 2° piano, Genova, si sono riuniti il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 30 del 10/01/2022, e la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con Decreto n. 3536 del 06/06/2022, per l'apertura sulla piattaforma Sintel delle offerte economiche presentate dalle Ditte concorrenti per i Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 6 e 7 il Lotto 8 "SERVIZIO DI CONTROLLO DEI DPI ANTI-X DIFFUSA" della procedura indicata in epigrafe.

Sono presenti:

- Il Dott. Luigi Moreno Costa Dirigente Amministrativo della S.U.A.R., R.U.P. della procedura e Presidente del Seggio di gara;
- Sig.ra Loredana Lotti, Funzionario Amministrativo della SUAR, referente della procedura e componente del Seggio di gara che svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante; la dott.ssa Paola Gerbino, componente del Seggio di gara;
- La Commissione Giudicatrice composta dalla Dott.ssa Franca Foppiano in qualità di Presidente, dal Dott. Giulio Bovio e dall' Ing. Alessandro Gallo, in qualità di componenti.

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dal Dott. Valter Borrello, Funzionario amministrativo di Regione Liguria (nominata con Decreto del Direttore Generale n. 6772 del 27/10/2022)

Presenza alla seduta, al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming, il Sig. Alessandro Valdiserri tecnico della SUAR.

Il RUP della gara, constatata la regolare costituzione del Seggio e della Commissione giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

Per assicurare la pubblicità della presente seduta e la partecipazione di tutti gli interessati, è stato pubblicato sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale, l'avviso Prot-2023- 0314590 del 29/03/2023 contenente il link a cui accedere per assistere alla seduta pubblica via streaming.

Il RUP ricorda per i lotti in argomento l'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, assegnando un massimo di 70 punti su 100 alla qualità e un massimo di 30 punti su 100 al prezzo.

Il RUP ricorda altresì che, pena esclusione dalla gara, il prezzo complessivo proposto dalle ditte dovrà essere uguale o minore rispetto ai prezzi a base d'asta indicati negli atti di gara.

Ciò posto il Presidente del Seggio di Gara procede, alla lettura dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione Giudicatrice i quali sono stati inseriti precedentemente nella piattaforma Sintel come da schede di valutazione allegate ai verbali delle sedute riservate che saranno pubblicate unitamente al provvedimento di aggiudicazione.

Ciò determinato, Il Presidente del Seggio di gara, operando attraverso il Sistema, procede nel seguente modo:

- Apertura dell'offerta economica telematica
- Lettura dei prezzi offerti
- generazione della graduatoria di aggiudicazione
- Formulazione della proposta di aggiudicazione, salvo verifica dell'anomalia dell'offerta.

All'esito delle operazioni come sopra descritte, risulta la seguente graduatoria di aggiudicazione, salvo verifica di anomalia dell'offerta ex art. 97 D. Lgs. n. 50/2016:

Lotto CIG	Ditta concorrente	Punteggio offerta tecnica (max 70 pt)	Prezzi offerti (importo triennale IVA esclusa)	Punteggio offerta economica (max 30 pt.)	Punteggio Totale
LOTTO 1 Dispositivi di protezione degli operatori: GREMBIULI INTERI CIG 8938101248	Cea S.p.A.	51,46	209.422,78	11,12	62,58
	Clini-lab S.r.l.	47,18	204.271,00	15,04	62,22
	Sago Medica S.r.l.	70,00	205.652,62	13,99	83,99
	Servizi ospedalieri S.r.l	55,72	134.875,00	30,00	85,72
LOTTO 2 Dispositivi di protezione degli operatori: GREMBIULI SPEZZATI CIG 8938115DD2	Cea S.p.A.	53,41	262.265,20	9,77	63,18
	Sago Medica S.r.l.	70,00	235.771,00	25,01	95,01
	Servizi ospedalieri S.r.l	50,85	198.890,00	30,00	80,85
LOTTO 3 Dispositivi di protezione degli operatori: COLLARI CIG 893812346F	Cea S.p.A.	70,00	38.983,518	8,73	78,73
	Sago Medica S.r.l.	66,36	32.332,05	25,90	92,26
	Servizi ospedalieri S.r.l	60,20	24.396,55	30,00	90,20
LOTTO 4 Occhiali a protezione radiazioni ionizzanti CIG 8938140277	Cea S.p.A.	70,00	117.821,00	25,33	95,33
	Clini-lab S.r.l.	57,77	131.255,00	13,95	71,72
	Sago Medica S.r.l.	66,73	98.489,80	30,00	96,73

LOTTO 5 Dispositivi di protezione dei pazienti CIG 8938152C5B	DESERTO				
LOTTO 6 Guanti attenuatori di radiazioni ionizzanti monouso CIG 8938172CDC	Bericah S.p.A.	67,68	227.604,00	30,00	97,68
	Cea S.p.A.	70,00	260.685,00	17,33	87,33
	Chemil S.r.l.	70,00	268.500,00	0	70,00
	Clini-lab S.r.l.	68,44	268.500,00	0	68,44
LOTTO 7 Teli anti X diffusa sterili per la protezione dell'operatore CIG 8938189AE4	Microteck Italy S.r.l.	70,00	64.260,00	30,00	100,00

Risultano anomale le offerte di Sago Medica in relazione ai Lotti 2, 3 e 4, Servizi ospedalieri in relazione al Lotto 3, CEA in relazione al Lotto 4 e Bericah in relazione al Lotto 6, per i quali si procederà alle verifiche di legge.

Si dà atto che in chiusura di seduta risultano n. 9 collegamenti alla diretta streaming.


La seduta pubblica si è chiusa alle ore 10.27.

Il presente verbale composto di n. 3 (tre) pagine, oltre gli allegati, è rassegnato agli atti di gara e verrà pubblicato sulla piattaforma Sintel raggiungibile all'indirizzo www.ariaspa.it e sul profilo del committente www.acquistiliguria.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Commissione giudicatrice:

Dott.ssa Franca Foppiano Presidente



Dott. Giulio Bovio Componente




Ing. Alessandro Gallo Componente




Per il Seggio di gara:


Dott. Luigi Moreno Costa Presidente

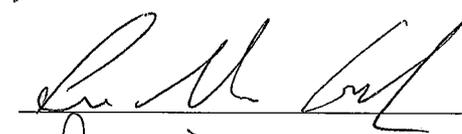

Dott.ssa Paola Gerbino Componente




Sig.ra Loredana Lotti Componente/Segretario



Ufficiale Rogante

Dott. Valter Borrello

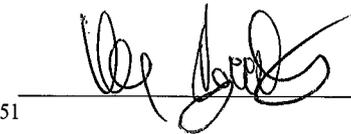

Fornitore	SERVIZI OSPEDALIERI SPA		SAGO MEDICA SRL		CEA SPA		Clini-Lab S.r.l.	
Offerta economica	Prezzo offerto	%	Prezzo offerto	%	Prezzo offerto	%	Prezzo offerto	%
Modalita' di partecipazione	Forma singola		Forma singola		Forma singola		Forma singola	
Ammissione alla fase successiva?	SI		SI		SI		SI	
Offerta economica:	EUR 134.875,00000	39,80%	EUR 205.652,62000	8,21%	EUR 209.422,78000	6,52%	EUR 204.271,00000	8,82%
Prezzo afferenti l'attivita' svolta dall'o	€ 674,00		EUR 31.876,16000		€ 163,63		€ 408,54	
di cui costi del personale:	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
di della sicurezza derivanti da interfer	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
Offerta economica complessiva:	EUR 134.875,00000		EUR 205.652,62000		EUR 209.422,78000		EUR 204.271,00000	
Documento d'offerta	-		-		-		-	
Dichiarazione di offerta economica	Modello M-6 - Dichiarazione Offerta economica.pdf.p7m		Modello M-6 - Dichiarazione Offerta economica LOTTO 1.pdf.p7m		Modello M-6 - Dichiarazione Offerta economica.pdf.p7m		Modello M-6 - Dichiarazione Offerta economica.pdf.p7m	
Dettaglio prezzi unitari	Modello_M-6_excel_Dettaglio_prezzi_unitari_L1.zip		dettaglio prezzi lotto 1.zip		OFFERTA LOTTO 1.zip		Modello M-6 excel Dettaglio prezzi unitari_rettificato.zip	

Allegato numero 18

Fornitore	SAGO MEDICA SRL		SERVIZI OSPEDALIERI SPA		CEA SPA	
Offerta economica	Prezzo offerto	%	Prezzo offerto	%	Prezzo offerto	%
Modalita' di partecipazione	Forma singola		Forma singola		Forma singola	
Ammissione alla fase successiva?	SI		SI		SI	
Offerta economica:	EUR 235.771,00000	15,57%	EUR 198.890,00000	28,77%	EUR 262.265,20000	6,08%
Allegato numero 19 prezzi unitari attività svolta dall'operatore	EUR 36.544,50500		€ 995,00		€ 205,26	
di cui costi del personale:	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
della sicurezza derivanti da interferenze	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
Offerta economica complessiva:	EUR 235.771,00000		EUR 198.890,00000		EUR 262.265,20000	
Documento d'offerta	-		-		-	
Dichiarazione di offerta economica	Modello M-6 - Dichiarazione Offerta economica LOTTO 2.pdf.p7m		Modello M-6 - Dichiarazione Offerta economica.pdf.p7m		Modello M-6 - Dichiarazione Offerta economica.pdf.p7m	
Dettaglio prezzi unitari	DETTAGLIO PREZZI L2.zip		Modello_M-6_excel_Dettaglio_prezzi_unitari_L2.zip		OFFERTA LOTTO 2.zip	

Fornitore	SAGO MEDICA SRL	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	CEA SPA
Offerta economica	Prezzo offerto %	Prezzo offerto %	Prezzo offerto %
Modalita' di partecipazione	Forma singola	Forma singola	Forma singola
Ammissione alla fase successiva?	SI	SI	SI
Offerta economica:	EUR 32.332,05000 23,68%	EUR 24.396,55000 42,41%	EUR 38.983,51800 7,98%
Prezzo afferenti l'attivita' svolta dall'operatore	EUR 5.011,47000	€ 122,00	€ 30,56
di cui costi del personale:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rischi della sicurezza derivanti da interferenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Offerta economica complessiva:	EUR 32.332,05000	EUR 24.396,55000	EUR 38.983,51800
Documento d'offerta	-	-	-
Dichiarazione di offerta economica	Modello M-6 - Dichiarazione Offerta economica LOTTO 3.pdf.p7m	Modello M-6 - Dichiarazione Offerta economica.pdf.p7m	Modello M-6 - Dichiarazione Offerta economica.pdf.p7m
Dettaglio prezzi unitari	dettaglio prezzi lotto 3.zip	Modello_M-6_excel_Dettaglio_prezzi_unitari_L3.zip	OFFERTA LOTTO 3.zip

Fornitore	SAGO MEDICA SRL	CEA SPA	Clini-Lab S.r.l.
Offerta economica	Prezzo offerto %	Prezzo offerto %	Prezzo offerto %
Modalita' di partecipazione	Forma singola	Forma singola	Forma singola
Ammissione alla fase successiva?	SI	SI	SI
Offerta economica:	EUR 98.489,80000 33,33%	EUR 117.821,00000 20,24%	EUR 131.255,00000 11,15%
Prezzo afferenti l'attivita' svolta dall'offerente	EUR 15.265,91900	€ 91,92	€ 262,51
di cui costi del personale:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi della sicurezza derivanti da interferenze:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Offerta economica complessiva:	EUR 98.489,80000	EUR 117.821,00000	EUR 131.255,00000
Documento d'offerta	-	-	-
Dichiarazione di offerta economica	Modello M-6 - Dichiarazione Offerta economica LOTTO 4.pdf.p7m	Modello M-6 - Dichiarazione Offerta economica.pdf.p7m	Modello M-6 - Dichiarazione Offerta economica.pdf.p7m
Dettaglio prezzi unitari	dettaglio prezzi lotto 4.zip	OFFERTA LOTTO 4.zip	Modello M-6 excel Dettaglio prezzi unitari_rettificato.zip

Fornitore	BERICAH S.P.A.		CEA SPA		CHEMIL S.R.L.		Clini-Lab S.r.l.	
Offerta economica	Prezzo offerto	%	Prezzo offerto	%	Prezzo offerto	%	Prezzo offerto	%
Modalita' di partecipazione	Forma singola		Forma singola		Forma singola		Forma singola	
Ammissione alla fase successiva?	SI		SI		SI		SI	
Offerta economica:	EUR 227.604,00000	15,23%	EUR 260.685,00000	2,91%	EUR 268.500,00000	0,00%	EUR 268.500,00000	0,00%
Prezzo afferenti l'attivit� svolta dall'offertore	€ 227,60		€ 204,87		€ 537,00		€ 537,00	
di cui costi del personale:	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
di cui costi di sicurezza derivanti da interferenze:	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
Offerta economica complessiva:	EUR 227.604,00000		EUR 260.685,00000		EUR 268.500,00000		EUR 268.500,00000	
Documento d'offerta	-		-		-		-	
Dichiarazione di offerta economica	Modello M-6 - Dichiarazione Offerta economica.pdf.p7m		Modello M-6 - Dichiarazione Offerta economica.pdf.p7m		Mod.M-6 - Dich Offerta economica.pdf.p7m		Modello M-6 - Dichiarazione Offerta economica.pdf.p7m	
Dettaglio prezzi unitari	dettaglio prezzi.zip.p7m		OFFERTA LOTTO 6.zip		MOD.M6 DETTAGLIO PREZZI UNITARI.zip		Modello M-6 excel Dettaglio prezzi unitari Rettificato.zip	

Fornitore	Microtek Italy S.r.l.	
Offerta economica	Prezzo offerto	%
Modalita' di partecipazione	Forma singola	
Ammissione alla fase successiva?	SI	
Offerta economica:	EUR 64.260,00000	10,00%
Prezzo afferenti l'attivita' svolta dall'o	€ 963,90	
di cui costi del personale:	€ 0,00	
di della sicurezza derivanti da interfer	€ 0,00	
Offerta economica complessiva:	EUR 64.260,00000	
Documento d'offerta	-	
Dichiarazione di offerta economica	Modello M-6 - Dichiarazione Offerta economica.pdf.p7m	
Dettaglio prezzi unitari	Mod. M-6 Dettaglio prezzi unitari L.7.pdf.zip	

Identificativo atto: 2023-AM-3918

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Luigi Moreno COSTA		-	12-06-2023 13:50
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Luigi Moreno COSTA		-	12-06-2023 13:50
Approvazione legittimità	Giorgia CATTI		-	12-06-2023 13:34
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luigi Moreno COSTA		-	12-06-2023 11:15

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria