

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Ilma PORCU tel. 010/548 8557
e-mail: ilma.porcu@regione.liguria.it

**Procedura aperta per la fornitura di
"Materiale di consumo per Chirurgia Maxillo-Facciale"
occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno**

DIALOGO TECNICO

Verbale di presa visione dei contributi presentati dagli operatori economici partecipanti al "Dialogo tecnico"

Il giorno 23 del mese di Luglio dell'anno duemilaquattordici, alle ore 14,30 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64, Genova, si è riunita in seduta non pubblica la Commissione tecnica della gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di "Materiali di consumo per Chirurgia Maxillo-Facciale" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per visionare i contributi presentati dagli operatori economici partecipanti al Dialogo tecnico pubblicato in data 12 Giugno 2014.

Sono presenti i componenti della Commissione tecnica – nominata con determinazione n. 99 del 8/10/2014 - composta dai Dottori:

- Dott.ssa Alessia SPINZIA Dirigente Medico U.O.C Chirurgia Maxillo-Facciale.
IRCCS A.O.U. San Martino/IST
- Dott. Guido MOSCATO Dirigente Medico U.O.C Chirurgia Maxillo-Facciale.
IRCCS A.O.U. San Martino/IST
- Dott. Luca MAZZONI Dirigente Medico - E.O. Ospedali Galliera


e in rappresentanza della Centrale Regionale di Acquisto:

- Ilma PORCU Collaboratore Amm.vo Esperto
- Sergio RIGHETTI Collaboratore Amm.vo

Il Commissione tecnica dà preliminarmente atto che:

- In data 20/03/2014 (prot. n. 4134) aveva trasmesso il documento tecnico per l'indizione della procedura di gara di che trattasi.

604



Centrale Regionale di Acquisto

- In data 12/06/2014 è stato pubblicato l'avviso di "Dialogo tecnico" volto a invitare gli operatori economici, che fossero interessati alla procedura di gara da ora finalizzata, a formulare osservazioni per il perfezionamento della documentazione di gara di prossima indizione.
- In data 26 Giugno 2014 alle ore 12,00 è scaduto il termine per la formulazione da parte degli operatori economici dei propri contributi.

La Commissione tecnica procede quindi all'esame dei vari contributi trasmessi dagli operatori economici:

DITTA [REDACTED]**Lotto 1**

La presente per chiedere se le viti vanno bene sia da 1mm che da 1.2mm, nello specifico l'azienda che noi rappresentiamo leader di mercato nel settore dell'osteosintesi cranio-maxillo facciale ha tolto dai propri cataloghi le viti aventi diametro 1mm in quanto considerate obsolete. Rispetto ai sistemi aventi viti con diametro 1.2mm non riportato vantaggi nè in termini di profilo nè di tenuta nè di invasività.

Lotto 3

La ditta domanda cosa significhi "viti autoritensive".

COMMISSIONE TECNICA**Lotto 1**

Le viti devono intendersi con diametro compreso fra 1mm e 1,2 mm.
Le misure dei diametri delle viti e degli spessori delle placche sono indicative e si accetterà una tolleranza del $\pm 10\%$.

Lotto 3

Per viti autoritensive deve intendersi "viti standard" che necessitano di fresatura prima dell'avvitamento.

DITTA [REDACTED]

Relativamente ad alcune misure delle viti e delle placche per osteosintesi indicate nella bozza di capitolato tecnico, si vuol far presente che stante le proprie attuali conoscenze le stesse identificano chiaramente i prodotti di una sola azienda.

Pertanto, posto che i differenti sistemi si identificano normalmente per il diametro delle viti maxillo-facciali, al fine di garantire la libera concorrenza sul mercato, si vuol far presente che gli standard universalmente riconosciuti in osteosintesi sono i seguenti:

- **LOTTO 1:** Microplacche con viti di diametro compreso tra 1.0 mm e 1,5 mm
- **LOTTO 2:** Placche con viti di diametro compreso tra 1.5 mm e 2.0 mm
- **LOTTO 3:** Placche con viti di diametro compreso tra 1.5 mm e 2.5 mm
- **LOTTO 4:** Placche con viti di diametro compreso tra 2.0 mm e 3.0 mm
- **LOTTO 6:** Placche riassorbibili con viti di diametro compreso tra 1.5 mm e 2.5 mm ??????

Relativamente al **LOTTO 5** (viti per bloccaggio maxillo-mandibolare) si evidenzia che **non** necessariamente devono essere in titanio in quanto vengono utilizzate temporaneamente. Ne consegue che alcune aziende le forniscano in acciaio.

COMMISSIONE TECNICA**Lotti da 1 a 6**

La Commissione tecnica ha predisposto i lotti in modo da garantire la massima concorrenzialità degli operatori economici presenti sul mercato tenuto conto della tolleranza $\pm 10\%$ prevista e delle esigenze operative delle Aziende Sanitarie Liguri.

Lotto 5

La Commissione tecnica accoglie l'osservazione formulata ed inserisce quale caratteristica del metallo "in acciaio/ in titanio".

DITTA**Lotto 1**

Nel lotto suindicato vengono richieste viti di varie lunghezze autofilettanti e/o autoperforanti: queste viti da 1.0mm di diametro, diversamente dagli altri diametri da noi commercializzati, non vengono realizzate nella versione auto perforante ed il motivo di tale scelta è dato dall'indicazione d'uso del diametro stesso. Sempre più frequentemente viene preferito l'inserimento tramite foro di preparazione al fine di agevolare l'autofilettatura della vite stessa durante l'impianto.

Nell'applicazione quotidiana infatti, su viti autoperforanti di questo diametro o simile, si sono verificati sovente problemi legati a rotture improvvise durante l'impianto, provocando il conseguente prolungamento dell'operazione a causa della necessaria rimozione e reimpianto.

Il motivo di tale rottura va spesso attribuito all'eccessivo carico di forze di torsione e spinta applicate durante l'inserimento della vite autoperforante in considerazione del diametro stesso.

Al fine di preservare gli operatori dal verificarsi seppure saltuario di questa condizione, si è preferito attenersi a quanto suggerito dalla pratica chirurgica, utilizzando il foro di preparazione preliminare unicamente su questo diametro.

COMMISSIONE TECNICA**Lotto 1**

La Commissione tecnica accoglie l'osservazione ed elimina la dicitura "e/o autoperforanti".

DITTA**Lotto 9**

Si chiede di poter inserire la tipologia del materiale costituente i suddetti dispositivi considerando la possibilità di suddividere il lotto per ogni voce richiesta in quanto non esiste in commercio, per quanto di nostra conoscenza, un kit costituito da impianto protesico dello scheletro facciale ed i mezzi di fissaggio.

Lotto 10

Si chiede di poter indicare la tipologia del materiale costituente i suddetti dispositivi considerando la possibilità di suddividere il lotto per ogni voce richiesta al fine di consentire, alle Aziende che ne avessero interesse, la più ampia ed aperta partecipazione anche in virtù del fatto che una descrizione così generica non consente di individuare esattamente la tipologia di dispositivo occorrente alle Vostre Spettabili Aziende

GM

Ospedaliere.

COMMISSIONE TECNICA**Lotto 9**

La Commissione tecnica accoglie l'osservazione formulata e stabilisce di suddividere il lotto 9 in sei lotti distinti, uno per ogni voce precedentemente indicata e di richiedere quale materiale costituente tali dispositivi "il materiale plastico".


Lotto 10

La Commissione tecnica stabilisce, dopo attenta valutazione, di non procedere all'indizione del lotto in questione non potendo indicare, per ciascuna voce, la tipologia del materiale costituente i dispositivi stessi.


Le operazioni si concludono alle ore 17,15

Letto, confermato e sottoscritto.


Dott.ssa Alessia SPINZIA

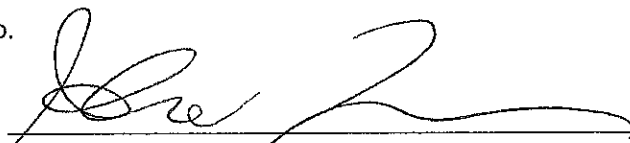


Dott. Guido MOSCATO



Dott. Luca MAZZONI



Ilma PORCU



Sergio RIGHETTI

