

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di "Sistemi antidecubito" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre - Lotti n. 5.

Verbale delle sedute svoltesi il 16/02/2011, 02/03/2011, 21/03/2011, 07/04/2011 e del 12/10/2011 per la verifica della documentazione presentata ai fini della assegnazione dei punteggi relativamente al parametro qualità e delle sedute del 14/06/2011 e del 26/07/2011 per la campionatura dei prodotti offerti.

I giorni 16/02/2011, 02/03/2011, 21/03/2011, 07/04/2011 e 12/10/2011 si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con deliberazione n. 12 del 26/01/2011 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la verifica della documentazione presentata dalle Ditte concorrenti ai fini dell'accertamento dei requisiti minimi essenziali e per l'assegnazione dei punteggi relativamente ai parametri della qualità. Sono stati presenti i Signori:

- **Dott. Antonino MASSONE** - Direttore dell'Unità Spinale dell' Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ASL 2 Savonese – **Presidente**;
- **Dott. Giovanni A. CHECCHIA** - Direttore S.C. RRF Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ASL 2 Savonese – **Componente**;
- **Sig.ra Deborah GRANARA** – Infermiere Specializzato in Wound Care N.O. Lesioni Cutanee, ASL 3 Genovese – **Componente**;

Erano presenti altresì la dr.ssa Silvia Simonetti, dirigente della Centrale e la dr.ssa Paola Burlando, funzionario della Centrale, con funzioni alternativemente di segretario della Commissione e il Sig. Roberto Boretti Assistente Amm.vo della Centrale.


Le sedute non sono state pubbliche.

La Commissione Giudicatrice ha dato preliminarmente atto

- che il 14/12/2010, alle ore 10,00 presso la Sala riunioni dell'Ospedale Villa Scassi (Palazzina Uffici Amministrativi), si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara della Centrale Regionale di Acquisto composto dalla Dott.ssa Silvia Simonetti, Dirigente Responsabile della Centrale, in qualità di Presidente, dalla Dott.ssa Paola Burlando in qualità di Componente e dal sig. Roberto Boretti in qualità di Segretario, per la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti;
- che sono state ammesse al prosieguo della procedura tutte le ditte concorrenti, così come indicato nel verbale redatto nella suddetta seduta del 14/12/2010, prot. n. 1252;
- che la Ditta Ricordini Pietro, sorteggiata ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e informata con nota prot. n. 1247 del 14/12/2010 dell'esito del sorteggio, ha prodotto la documentazione richiesta pena esclusione dal disciplinare di gara, acquista agli atti con prot. n. 1289 del 23/12/2010, e cioè:
 - estratto dei bilanci dal quale si evinca il fatturato degli esercizi 2007-2008-2009;
 - documentazione probatoria relativa alle principali forniture eseguite negli ultimi tre anni 2007-2008-2009

In considerazione del positivo assolvimento degli adempimenti amministrativi la Commissione ha deciso di passare all'esame della documentazione tecnica.

Per comodità di procedura il Segretario ha riassunto ai Commissari lo stato delle offerte pervenute, lotto per lotto, così come esse risultano dalle istanze di partecipazione e come riassunto nella tabella seguente

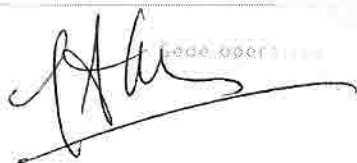

SS

Ditta	Lotti per i quali la Ditta presenta offerta
RICORDINI PIETRO di Ricordini Mauro & C. S.r.l	2, 3, 4
T.S.S. S.r.l	2,3
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	1,2,3
SANITARIA SCALIGERA S.r.l	2,3,4,5
REHA - Istituto Tecnico Ortopedico	2,4
ATI KCI Medical S.r.l Vivisol	2,3,4,5
Hill- Rom S.p.A.	1,2,3,4,5
Medic Air S.r.l	2,3,4

La Commissione ha preso atto che il Disciplinare di gara e relativi allegati (Capitolato tecnico e Capitolato Speciale) prevedevano che la procedura venisse esperita con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponderando perciò l'elemento prezzo con i parametri di qualità definiti in sede di capitolato tecnico e che ai parametri di qualità sono assegnati in ogni lotto **50 punti**.

La Commissione ha stabilito la procedura da seguire all'apertura dei plichi sigillati:

- il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità dei plichi pervenuti procederà ad aprire gli stessi;
- verrà accertato che in tutti i plichi (**Busta 3**) sia presente la documentazione indispensabile, pena esclusione, richiesta nel Disciplinare di Gara. In mancanza di tale documentazione non si procederà alla valutazione degli item di punteggio e alla campionatura;
- verrà verificata la presenza di tutti i requisiti tecnici minimi pena esclusione. In assenza anche di uno solo dei requisiti minimi non si procederà alla valutazione degli item di punteggio e alla campionatura;
- si passerà quindi ad esaminare la documentazione tecnica presentata da ciascuna ditta (**Busta 3**) concorrente per ciascun lotto al fine di attribuire il punteggio qualitativo;
- si procederà alla campionatura dei prodotti offerti da ciascuna Ditta mediante l'allestimento dei sistemi presso dall'Unità Spinale dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure
- verrà determinato, alla fine della valutazione tecnica della documentazione di ogni lotto, il punteggio ottenuto da ciascuna mediante la sommatoria dei punti attribuiti per singolo item qualitativo.

La Commissione nella data del **16/02/2011** ha proceduto preliminarmente all'esame della documentazione indispensabile prevista dal Disciplinare di gara, le cui risultanze sono riepilogate nell'**Allegato 1** al presente verbale.

Nella data del **02/03/2011** la Commissione ha proceduto alla verifica dei requisiti tecnici minimi pena esclusione dalla quale ed è emerso che sono escluse le offerte delle seguenti ditte per i lotti indicati con le allegate motivazioni:

Lotto	Ditta	Motivazione
Lotto 1	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	a) Altezza del materasso inferiore ai 15 cm richiesti. b) Non è provata la capacità del presidio di adeguare in modo automatico le pressioni da contatto in base al peso e alla postura del paziente
Lotto 2	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	a) Il certificato secondo la classe 1 rispetto alla resistenza al fuoco presentato non include la certificazione 1.IM, l'unica certificazione prodotta riguarda solo la cover. Suddetta certificazione è dichiarata dalla ditta ma non supportata da idonea certificazione b) Assenza della dichiarazione che i sistemi siano in regola col DM. Min. Sal. 20/02/2007 e del 21/12/2009 c) Assenza della dichiarazione di conformità alle norme CEI 62-5 (II-III edizione); d) Assenza della dichiarazione del basso consumo energetico.

Sede apert...

Lotto 3	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	a) Il certificato secondo la classe 1 rispetto alla resistenza al fuoco presentato non include la certificazione 1.IM, l'unica certificazione prodotta riguarda solo la cover. Suddetta certificazione è dichiarata dalla ditta ma non supportata da idonea certificazione. b) Assenza della dichiarazione che i sistemi siano in regola col DM. Min. Sal. 20/02/2007 e del 21/12/2009. c) Assenza della dichiarazione di conformità alle norme CEI 62-5 (II-III edizione). d) Assenza della dichiarazione del basso consumo energetico.
	MEDIC AIR S.R.L.	Il presidio offerto non risponde alla caratteristica richiesta per il lotto 3 "Bassa pressione alternata/fluttuazione dinamica".
Lotto 4	MEDIC AIR S.R.L.	Non si evince dalla documentazione tecnica fornita la possibilità, in modo adeguato, di gestire la macerazione cutanea in pazienti ad altissimo rischio
Lotto 5	SANITARIA SCALIGERA S.R.L.	Il prodotto offerto non risponde ai requisiti minimi richiesti: non è un "reale cessione d'aria"
	HILL- ROM S.P.A.	Il prodotto offerto non risponde ai requisiti minimi richiesti: non è un "reale cessione d'aria"

La Commissione nelle date del **21/03/2011** e del **07/04/2011** ha proceduto ad esaminare la documentazione tecnica presentata da ciascuna Ditta (Busta 3) concorrente per ciascun lotto al fine di attribuire il punteggio qualitativo.

Nella data del **14/06/2011**, presso i locali appositamente predisposti dall'Unità Spinale dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, la Commissione Giudicatrice, coadiuvata dalla dr.ssa Silvia Simonetti, dirigente della Centrale, che svolgeva le funzioni di segretario e dal Sig. Roberto Boretti Assistente Amm.vo della Centrale, ha convocato le Ditte SANITARIA SCALIGERA S.R.L. ATI: KCI MEDICAL S.r.l. – VIVISOL (ATI) e RICORDINI PIETRO di Ricordini Mauro & C. S.r.l. ed ha proceduto alle prove pratiche dei campioni dei prodotti che hanno superato positivamente la verifica dei requisiti minimi pena esclusione.

Successivamente la stazione appaltante, nell'espletamento dei suoi poteri di verifica e controllo, ha constatato l'assenza di un requisito minimo pena esclusione per l'offerta della Ditta Medic Air S.r.l. nello specifico a pg. 31 del progetto è indicata una cadenza di sanificazione dei materassi a noleggio quadrimestrale, mentre il capitolato prevedeva come requisito minimo pena esclusione una sanificazione a cadenza trimestrale.

La Commissione Giudicatrice, preso atto della segnalazione della Stazione Appaltante, stabilisce di escludere la Ditta Medic Air S.r.l. dal prosieguo della gara e pertanto di non procedere alla prevista campionatura.

Nella data del **26/07/2011** presso i locali appositamente predisposti dall'Unità Spinale dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e la Commissione Giudicatrice, coadiuvata dalla dr.ssa Silvia Simonetti, dirigente della Centrale, che svolgeva le funzioni di segretario e dal Sig. Roberto Boretti Assistente Amm.vo della Centrale, ha convocato le Ditte T.S.S. S.r.l., REHA – Istituto Tecnico Ortopedico e HILL- ROM S.p.A. e ha proceduto alle prove pratiche dei campioni dei prodotti che hanno superato positivamente la verifica dei requisiti minimi pena esclusione.

Sono state inoltre riconvocate le Ditte SANITARIA SCALIGERA S.R.L. ATI: KCI MEDICAL S.r.l. – VIVISOL (ATI) e RICORDINI PIETRO di Ricordini Mauro & C. S.r.l. per un'ulteriore verifica tecnica sul Lotto 4.

In data **29/09/2011** il Dr. Massone e il Dr. Checchia si sono incontrati presso la Centrale Regionale di acquisto al fine di effettuare un'ulteriore verifica della documentazione tecnica di gara. Le risultanze della suddetta verifica verranno sottoposte alla Commissione del 12/10/2011 per la disamina e l'approvazione.

In data **12/10/2011** la Commissione al completo si è riunita presso l'Unità Spinale di Santa Corona per una revisione globale della documentazione tecnica analizzata e dei risultati delle prove effettuate nelle precedenti sedute. Alla fine dei lavori concordemente ha stilato la tabella di cui agli **allegati 2 e 3** contenenti rispettivamente i punteggi assegnati a ciascuna Ditta per il servizio e i punteggi assegnati per ciascun lotto offerto.

Le risultanze dell'attribuzione del punteggio di qualità sono riepilogate nella tabella che segue:

Ditte	Lotto 1		Lotto 2		Lotto 3		Lotto 4		Lotto 5	
	P.ti	Ammissa	P.ti	Ammissa	P.ti	Ammissa	P.ti	Ammissa	P.ti	Ammissa
RICORDINI PIETRO DI RICORDINI MAURO & C. S.R.L.			27,42	SI	28,15	SI	24,48	NO	/	/
T.S.S. S.R.L.			21,92	NO	21,10	NO	/	/	/	/
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	/	/	/	/
SANITARIA SCALIGERA S.R.L.			31,63	SI	28,98	SI	28,78	SI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI
REHA - ISTITUTO TECNICO ORTOPEDICO			22,76	NO	/	/	22,45	NO	/	/
ATI KCI MEDICAL S.R.L. - VIVISOL			37,22	SI	44,70	SI	43,73	SI	46,50	SI
HILL- ROM S.P.A.	42,90	SI	38,26	SI	39,04	SI	38,55	SI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI
MEDIC AIR S.R.L.			N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	/	/

La Commissione ha stabilito di convocare la seduta per l'apertura delle offerte economiche per il giorno 02/11/2011 e ha dato mandato agli uffici della Centrale Acquisti di darne formale comunicazione alle ditte offerenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

- **Presidente :**

Dott. Antonino MASSONE

- **Componenti:**

Dott. Giovanni A. CHECCHIA






Sig.ra Deborah GRANARA

- **Segretario per le sedute del 16/02/11, 02/03/11, 21/03/11, 07/04/11, 12/10/11:**

Dott.ssa Paola BURLANDO

- **Segretario per le sedute del 14/06/11 e del 26/07/11:**

Dott.ssa Silvia SIMONETTI

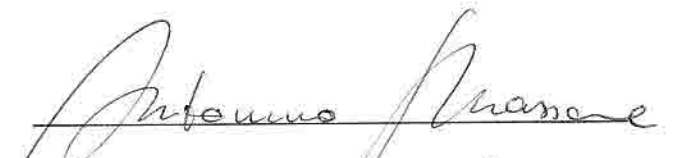






Allegato 1

Schede di rilevazione della documentazione tecnica
prevista dal Disciplinare di gara

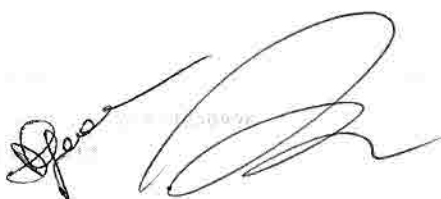

Sede operativa: Genova, Tel. 010 5102115


SS

 M

Ditta: RICORDINI PIETRO DI RICORDINI MAURO & C. S.R.L

Nome prodotto	Alpha Response	Auto Logic	Nimbus 3
<i>Requisiti minimi di ammissione</i>	<i>Lotto 2</i>	<i>Lotto 3</i>	<i>Lotto 4</i>
scheda informativa in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della ditta. La scheda andrà redatta sulla base del fac-simile previsto all'allegato F4: la scheda dovrà riportare, pena esclusione, il nome del prodotto, i codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 relativo alle "Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi "	OK	OK	OK
scheda tecnica del produttore/commercializzatore, catalogo illustrato , senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, dépliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara. Il punteggio di qualità sarà attribuito in base alle informazioni riportate nella scheda informativa e nella documentazione tecnica di cui al presente punto.	OK	OK	OK
copia della certificazione CE relativamente ai sistemi antidecubito(qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42;	OK	OK	OK
dichiarazione di impegno a prestare assistenza tecnica, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati nel Capitolato Speciale sez. B;	OK	OK	OK
modalità di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria;	OK	OK	OK
dichiarazione di presa visione dei DUVRI delle Aziende pubblicati sul sito;	OK	OK	OK
dichiarazione , se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali , pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;	assente	assente	assente

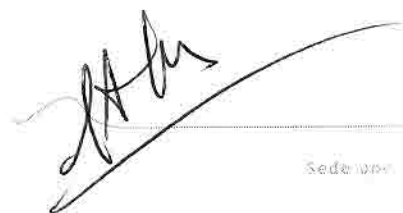

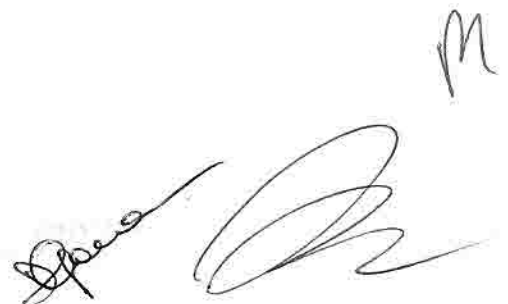

Ditta: T.S.S. SRL


Nome prodotto	Sistema Dual/Revo Lotto 2	Sistema Dual Lotto 3
Requisiti minimi di ammissione		
scheda informativa in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della ditta. La scheda andrà redatta sulla base del fac-simile previsto all'allegato F4; la scheda dovrà riportare, pena esclusione, il nome del prodotto, i codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 relativo alle " Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi "	OK	OK
scheda tecnica del produttore/commercializzatore, catalogo illustrato , senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, dépliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara. Il punteggio di qualità sarà attribuito in base alle informazioni riportate nella scheda informativa e nella documentazione tecnica di cui al presente punto.	OK	OK
copia della certificazione CE relativamente ai sistemi antidecubito(qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42;	OK	OK
dichiarazione di impegno a prestare assistenza tecnica, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati nel Capitolato Speciale sez. B;	OK	OK
modalità di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria;	OK	OK
dichiarazione di presa visione dei DUVRI delle Aziende pubblicati sul sito;	OK	OK
dichiarazione , se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali , pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;	assente	assente






Ditta: **OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO**


Nome prodotto	KM20	DEVICARE K10	DEVICARE K20
<i>Requisiti minimi di ammissione</i>	<i>Lotto 1</i>	<i>Lotto 2</i>	<i>Lotto 3</i>
scheda informativa in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della ditta. La scheda andrà redatta sulla base del fac-simile previsto all'allegato F4; la scheda dovrà riportare, pena esclusione, il nome del prodotto, i codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 relativo alle " Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi "	OK	OK	OK
scheda tecnica del produttore/commercializzatore, catalogo illustrato , senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, dépliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara. Il punteggio di qualità sarà attribuito in base alle informazioni riportate nella scheda informativa e nella documentazione tecnica di cui al presente punto.	OK	OK	OK
copia della certificazione CE relativamente ai sistemi antidecubito(qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42;	OK	OK	OK
dichiarazione di impegno a prestare assistenza tecnica, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati nel Capitolato Speciale sez. B;	OK	OK	OK
modalità di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria;	OK	OK	OK
dichiarazione di presa visione dei DUVRI delle Aziende pubblicati sul sito;	OK	OK	OK
dichiarazione , se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali , pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;	OK	OK	OK

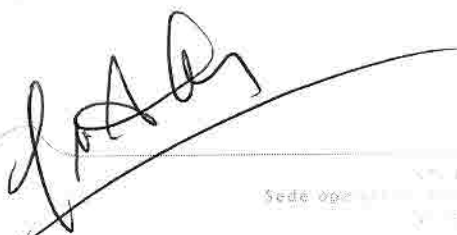

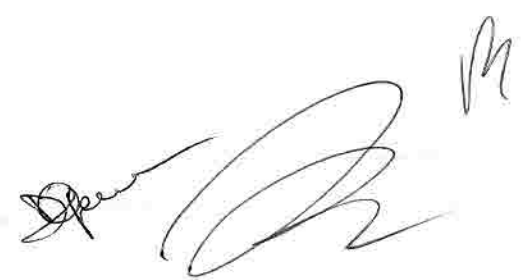

Ditta: **SANITARIA SCALIGERA S.R.L.**

Nome prodotto	PULSAR CHOICE MR	QUATTRO PLUS	QUATTRO ACUTE	SOFTECH 3000 NOKT
<i>Requisiti minimi di ammissione</i>	<i>Lotto 2</i>	<i>Lotto 3</i>	<i>Lotto 4</i>	<i>Lotto 5</i>
scheda informativa in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della ditta. La scheda andrà redatta sulla base del fac-simile previsto all'allegato F4; la scheda dovrà riportare, pena esclusione, il nome del prodotto, i codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 relativo alle " Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi "	OK	OK	OK	OK
scheda tecnica del produttore/commercializzatore, catalogo illustrato , senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, dépliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara. Il punteggio di qualità sarà attribuito in base alle informazioni riportate nella scheda informativa e nella documentazione tecnica di cui al presente punto.	OK	OK	OK	OK
copia della certificazione CE relativamente ai sistemi antidecubito(qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42;	OK	OK	OK	no CE Presentata Dichiarazione
dichiarazione di impegno a prestare assistenza tecnica, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati nel Capitolato Speciale sez. B;	OK	OK	OK	OK
modalità di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria;	OK	OK	OK	OK
dichiarazione di presa visione dei DUVRI delle Aziende pubblicati sul sito;	OK	OK	OK	OK
dichiarazione , se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali , pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006;	OK	OK	OK	OK

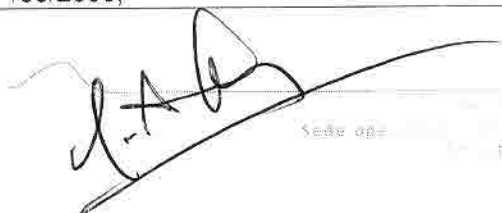




Ditta: RHEA – ISTITUTO TECNICO ORTOPEDICO

Nome prodotto	AIR EXPRESS P280DF	AUTO SURE FLOAT
<i>Requisiti minimi di ammissione</i>	<i>Lotto 2</i>	<i>Lotto 4</i>
scheda informativa in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della ditta. La scheda andrà redatta sulla base del fac-simile previsto all'allegato F4; la scheda dovrà riportare, pena esclusione, il nome del prodotto, i codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 relativo alle " Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi"	OK	OK
scheda tecnica del produttore/commercializzatore, catalogo illustrato , senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, dépliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara. Il punteggio di qualità sarà attribuito in base alle informazioni riportate nella scheda informativa e nella documentazione tecnica di cui al presente punto.	OK	OK
copia della certificazione CE relativamente ai sistemi antidecubito(qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42;	no CE Presentata Dichiarazione	no CE Presentata Dichiarazione
dichiarazione di impegno a prestare assistenza tecnica, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati nel Capitolato Speciale sez. B;	OK	OK
modalità di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria;	OK	OK
dichiarazione di presa visione dei DUVRI delle Aziende pubblicati sul sito;	OK	OK
dichiarazione , se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali , pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;	no	no

L.A.B.

88

Spencer

R M


Ditta (ATI): KCI MEDICAL S.R.L. – VIVISOL

Nome prodotto	AIRWORKS II	INNOVA EXTRA O.L.	INNOVA EXTRA MRS	THERAKAIR VISIO
Requisiti minimi di ammissione	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5
scheda informativa in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della ditta. La scheda andrà redatta sulla base del fac-simile previsto all'allegato F4; la scheda dovrà riportare, pena esclusione, il nome del prodotto, i codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 relativo alle " Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi "	OK	OK	OK	OK
scheda tecnica del produttore/commercializzatore, catalogo illustrato , senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, dépliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara. Il punteggio di qualità sarà attribuito in base alle informazioni riportate nella scheda informativa e nella documentazione tecnica di cui al presente punto.	OK	OK	OK	OK
copia della certificazione CE relativamente ai sistemi antidecubito(qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42;	OK	OK	OK	OK
dichiarazione di impegno a prestare assistenza tecnica, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati nel Capitolato Speciale sez. B;	OK	OK	OK	OK
modalità di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria;	OK	OK	OK	OK
dichiarazione di presa visione dei DUVRI delle Aziende pubblicati sul sito;	OK	OK	OK	OK
dichiarazione , se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali , pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;	OK	OK	OK	OK




Sede ogg...
tel. +39...




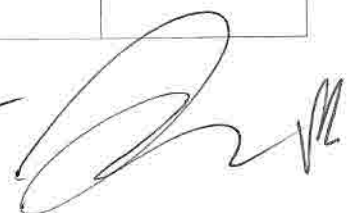

Ditta: HILL – ROM S.P.A.


Nome prodotto	P330 WOUND SURFACE	PRIMO	CLIN ACTIV PLUS	CLIN ACTIV PLUS MCM	CLIN ACTIV PLUS MCM
<i>Requisiti minimi di ammissione</i>	<i>Lotto 1</i>	<i>Lotto 2</i>	<i>Lotto 3</i>	<i>Lotto 4</i>	<i>Lotto 5</i>
scheda informativa in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della ditta. La scheda andrà redatta sulla base del fac-simile previsto all'allegato F4; la scheda dovrà riportare, pena esclusione, il nome del prodotto, i codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 relativo alle " Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi "	OK	OK	OK	OK	OK
scheda tecnica del produttore/commercializzatore, catalogo illustrato , senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, dépliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara. Il punteggio di qualità sarà attribuito in base alle informazioni riportate nella scheda informativa e nella documentazione tecnica di cui al presente punto	OK	OK	OK	OK	OK
copia della certificazione CE relativamente ai sistemi antidecubito(qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42;	OK	OK	OK	OK	OK
dichiarazione di impegno a prestare assistenza tecnica, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati nel Capitolato Speciale sez. B;	OK	OK	OK	OK	OK
modalità di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria;	OK	OK	OK	OK	OK
dichiarazione di presa visione dei DUVRI delle Aziende pubblicati sul sito;	OK	OK	OK	OK	OK
dichiarazione , se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali , pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006;	OK	OK	OK	OK	OK

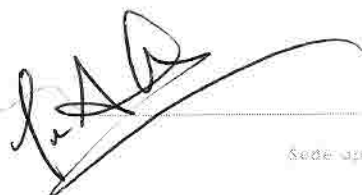

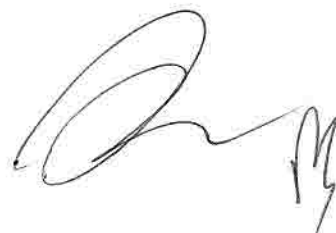Ditta **MEDIC AIR S.R.L.**

Nome prodotto	AIR SISTEM PRO III + COMPRESSORE AIR LOGIC	EURO GENIUS	EURO GENIUS
Requisiti minimi di ammissione	<i>Lotto 2</i>	<i>Lotto 3</i>	<i>Lotto 4</i>
scheda informativa in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della ditta. La scheda andrà redatta sulla base del fac-simile previsto all'allegato F4; la scheda dovrà riportare, pena esclusione, il nome del prodotto, i codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 relativo alle " Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi "	OK	OK	OK
scheda tecnica del produttore/commercializzatore, catalogo illustrato , senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, dépliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara. Il punteggio di qualità sarà attribuito in base alle informazioni riportate nella scheda informativa e nella documentazione tecnica di cui al presente punto.	OK	OK	OK
copia della certificazione CE relativamente ai sistemi antidecubito(qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42;	no CE Presentata Dichiarazione	no CE Presentata Dichiarazione	no CE Presentata Dichiarazione
dichiarazione di impegno a prestare assistenza tecnica, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati nel Capitolato Speciale sez. B;	OK	OK	OK
modalità di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria;	OK	OK	OK
dichiarazione di presa visione dei DUVRI delle Aziende pubblicati sul sito;	OK	OK	OK
dichiarazione , se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali , pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;	OK	OK	OK



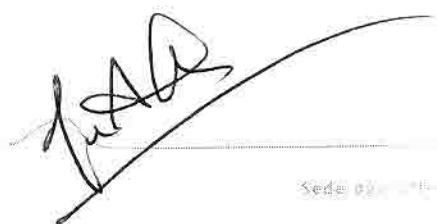

Allegato 2

Schede di valutazione del servizio



[Handwritten signature]






SS



[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

All. 2 Scheda riepilogativa valutazione servizio

Sub parametri	Punteggio max	RICORDINI	TSS	SANITARIA SCALIGERA	RHEA	ATI: KCI-VIVISOL	HILL ROM
		punteggio attribuito	punteggio attribuito	punteggio attribuito	punteggio attribuito	punteggio attribuito	punteggio attribuito
Sede/Distributore							
n° automezzi							
n° personale: funzione e tempo dedicato							
locazione centri di sanificazione							
aggiornamento personale n° ore							
n° verde	6,00	2,00	1,50	2,00	2,00	5,50	3,50
progetto di servizio ospedaliero							
possesso di certificazioni di qualità							
modalità sanificazione	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,50
presenza protocollo di sanificazione	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO (max punti 3)	3,00	1,50	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
MIGLIORIE (max punti 2)	2,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,00	1,90
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO	15,00	4,50	2,50	6,50	3,00	14,50	11,90

Struttura organizzativa RICORDINI	Dati rilevati	NOTE	Punti max	Punteggio assegnato
Sede/Distributore n° automezzi n° personale: funzione e tempo dedicato locazione centri di sanificazione aggiornamento personale n° ore n° verde	Genova 2 fiat Doblò 3 persone dedicate Liguria centro sanificazione stoccaggio Genova non meno di 16/anno 2 corsi teorico pratici con modalità da concordarsi con D.S. e Uff. inf affiancamento durante installazione NO fax/web	previsione aumento se vincono appalto. marca indicazione divisione sporco/pulito numero inadeguato. previsione aumento se vincono appalto manca indicazione contenuti manca indicazione contenuti; manca il numero delle ore previsto per l'aggiornamento. in attivazione con copertura ore ufficio	6,00 2,00	
STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI (max punti 6)	progetto di servizio ospedaliero 12h sempre 8 per intensive 24h fax 24/24 2 cell/1 fisso 1 cell h 7/21, 1 cell e 1 fisso orario ufficio lun ven h 7-45/18 un indirizzo mail reperibilità 24/24	il documento fa riferimento alla procedura n° 7 non presente agli atti il documento fa riferimento alla procedura n° 8 non presente agli atti il progetto presenta incongruenza tra quanto indicato al punto 6 rep personale e quanto indicato nel paragrafo assistenza full risk il n° di cell 348/7607062 nel primo documento risulta attivo dalle 7 alle 21, nel secondo 24/24 riferisce assistenza entro 24h e non 8 nei gg festivi come invece richiesto da capitolato	3,00	
ASPETTI IGIENICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONI E SANITIZZAZIONE. (max punti 4)	possesso di certificazioni di qualità sì modalità sanificazione presenza protocollo di sanificazione	dall'analisi dei percorsi nello schema non è indicato il locale dove vengono collocati i sistemi inoltre l'ingresso dello sporco e del pulito, non sembrano divisi fisicamente mancano i documenti di sanificazione. In sede di campionatura si è confermata la mancanza dei documenti di sanificazione e la commissione non ha potuto visionarli	1,00	
INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO (max punti 3)	progetto di Informatizzazione sì	La commissione non ha elementi di valutaz. Non sono indicate neppure le eventuali maschere che possono consentire la valutazione del sistema, applicaz. pratica e contenuti reportistica.	3,00	1,50
MIGLIORIE (max punti 2)	studio prevalenza no	Non è uno studio di prevalenza ma un audit effettuato da personale sanitario interno e non dalla ditta	2,00	-
Totale punti			15,00	4,50

Struttura organizzativa T.S.S.	Dati rilevati	NOTE	Punti max	Punteggio assegnato
Sede/Distributore n° automezzi n° personale: funzione e tempo dedicato locazione centri di sanificazione aggiornamento personale n° ore n° verde	Ferentino (FR) 3 - distinzione sporco/pulito non dichiarato Serravalle (Rep. San Marino) non specificato 3 tipologie di addestramento: 3 ore illustrazione prodotto e servizio; 2 ore illustrazione utilizzo sì telefonata e conferma con fax	numero inadeguato solo esplicitate mansioni per qualifica ma non il numero del personale indicazione generica di idoneità alle mansioni	6,00	1,50
STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI (max punti 6)	modalità richiesta tempistica consegna, installazione, collaudo tempistica dismissione 6 ore -migliorativi rispetto al capitolato modalità assistenza telefonata e conferma con fax	non si fa menzione del certificato di sanificazione e di sicurezza elettrica. controllo della sicurezza elettrica solo nel caso in cui vengono sostituite delle parti:	3,00	3,00
ASPETTI IGIENICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONE E SANITIZZAZIONE (max punti 4)	possesso di certificazioni di qualità sì modalità sanificazione	Dalla documentaz. non si evince un percorso ben dettagliato sporco-pulito. Manca la piantina dei percorsi e degli ambienti (non si comprende posizionam. griglie asciugatura etc). Il procedim. descritto presenta le seguenti contraddiz./lacune: relativam. agli operatori sembra che mantengano gli stessi guanti per tutto il procedimento. non si capisce se ci sono operatori dedicati ad ogni parte del processo o se seguano il materasso. Per quanto riguarda la sanific. delle superfici di appoggio sembra che venga effettuata a fine giornata e non a fine di ciascun processo. La sanificaz. degli attrezzi avviene settimanalm. I cuscini interni del materasso sembrano essere lavati solo a freddo e mai in lavatrice, non si comprende come vengano trattati i panni non monouso. Non viene menzionata la pulizia delle parti interne del materasso (cottonnetti, sensori, etc.) le cover passano prima in asciugatore elettrico e successivamente in zona di ventilazione naturale. non se ne comprende il motivo. Per questi motivi la commissione ha ritenuto che il processo di sanificaz. non dia suffic. garanzie di igiene.	1,00	1,00
INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO (max punti 3)	presenza protocollo di sanificazione sì progetto di Informatizzazione	La commissione non ha elementi di valutaz. del software che pare non sia stato ancora predisposto. Nel documento si parla di demo solo dopo aggiudicazione. Non sono indicate neppure le eventuali maschere che possono consentire la valutazione del sistema. applicaz. pratica e contenuti reportistica.	3,00	3,00
MIGLIORIE (max punti 2)	studio prevalenza no	Non presente	2,00	2,00
Totale punti			15,00	2,50

Struttura organizzativa SANITARIA SCALIGERA	Dati rilevati	NOTE	Punti max	Punteggio assegnato
Sede/Distributore	Verona (sede centrale) 18 su territorio nazionale, presenza divisione sporco pulito	il dato risale al 10/1/2005 non si conosce la dotazione attuale	6,00	2,00
n° automezzi	20 su territorio nazionale	non si evince il n° di personale dedicato al servizio in Liguria. Si dichiara la qualifica OSA per tutto il personale addetto alla consegna/ritiro dei presidi ma all'allegato E si fa esplicito divieto movimentazione pazienti al personale no OSA.		
n° personale: funzione e tempo dedicato	Verona (sede centrale) Chiesina Uzzanese Savona Roma, Torino, San Marino, Palermo. Centri operativi autorizzati (Genova Caserta e Perugia)	Chiesina Uzzanese dovrebbe servire l'area Levante, Savona l'area Ponente i due centri hanno magazzino autonomo e personale dedicato (non si specifica numero personale e automezzi). Non sono chiare le condizioni di funzionamento dei Centri operativi autorizzati. Se la certificazione presentata riguarda anche il loro funzionamento.		
aggiornamento personale n° ore n° verde	interno ospedaliero n° verde, fax, web per richiesta, dismissione, installazione, ritiro e manutenzione	non indicato numero ore/docenti/programma		
progetto di servizio ospedaliero	12h sempre 8 per intensive	sistema GPRS per contatto personale. Centro di smistamento che individua il soggetto più vicino. Sistema computerizzato per ordini ecc.		
possesso di certificazioni di qualità	tempistica consegna, installazione, collaudo tempistica dismissione modalità assistenza si	conforme a capitolato. Contrario alla normativa su privacy: apposizione su nastro adesivo attaccato al presidio di NOME E COGNOME DEL PZ conforme a capitolato		
ASPETTI IGIENICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONI E SANITIZZAZIONE (max punti 4)	modalità sanificazione	Il protocollo presenta diversi aspetti contraddittori: 1) i presidi vengono divisi in due categorie infetti (sacco rosso) e non (sacco giallo) e vengono trattati in modo differente. I presidi, a giudizio della commissione, devono essere trattati tutti allo stesso modo perché non sempre è dichiarata o conclamata l'infezione. 2) mancano i criteri in base ai quali l'operatore decide se sanificare a caldo o a freddo. 3) non si evince come venga effettuata la prova di funzionamento del presidio non si evince se il motore, che segue un processo di sanificazione differente e viene imbastato, venga assemblato al presidio e in che fase del processo. 4) alla mappa dei percorsi sembra non esistere la separazione, sporco/pulito in fase di entrata/uscita per fine lavorazione. 5) manca il controllo/collaudo sulla parte elettrica a fine sanificazione, tuttavia nel corso della prova pratica tale controllo risulta effettuato e comprovato da idonea documentazione. Per questi motivi la commissione ha ritenuto che il processo di sanificaz. non dia sufficienti garanzie di igiene.	3,00	1,00
INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO (max punti 3)	presenza protocollo di sanificazione progetto di informatizzazione	sistema GPRS per contatto personale. Centro di smistamento che individua il soggetto più vicino. Sistema computerizzato per ordini ecc.		3,00
MIGLIORIE (max punti 2)	il documento presentato non è uno studio di prevalenza	il documento presentato presenta le seguenti criticità: 1) nera elecazione di dati che il programma può rilevare 2) manca la parte progettuale e la metodica di rilevazione dei dati 3) alcuni dati risultano non utilizzabili nella forma prevista dal progetto		0,50
Totale punti			15,00	6,50

Struttura organizzativa RHEA	Dati rilevati	NOTE	Punti max	Punteggio assegnato
Sede/Distributore	Mignanego (Ge)			
n° automezzi	21 su tutto il territorio nazionale 12 Iveco daily 7 Ford transit, 1 Opel movano, 1 fiat scudo, presenza divisione sporco pulito	non si vince quanti mezzi mettono a disposizione per appalto regione Liguria previsione aumento se vincono appalto		
n° personale: funzione e tempo dedicato	18 per la Liguria?	non si vince se il personale segnalato è dedicato solo per il progetto Liguria		
locazione centri di sanificazione	Altivole (TV) e Empoli (FI)	disponibilità in caso di aggiudicazione ad attrezzare la sede di Mignanego (GE) come quella di Altivole (TV)		
aggiornamento personale n° ore	interno	non quantificato, non indicate ore formazione		
n° verde	osped	8 ore, 3 livelli formazione, corsi di 4 ore (su corrette indicazioni ai presidi); corsi 2 ore (illustrazione prodotto e gestione del servizio); corso 1 ora (addestramento continuo su utilizzo dei sistemi); corsi 1 ora semestrali su sistema informatico e funzionalità prodotti	6.00	2.00
STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI (max punti 6)	n° verde	si, 24/24		
progetto di servizio ospedaliero	modalità richiesta	sistema informatico		
possesso di certificazioni di qualità	tempistica consegna, installazione, collaudo	tempistica consegna 10 ore da ricevimento richiesta		
sanificazione	tempistica dismissione	entro 12 ore		
ASPETTI IGIENICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONI E SANITIZZAZIONE (max punti 4)	modalità assistenza	web/telefonico, tempistica riparazione, intervento entro 4 ore dalla comunicazione	3.00	1.00
INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO (max punti 3)	modalità sanificazione	viene presentato l'elenco dei prodotti utilizzati per la disinfezione e lo studio di efficacia degli stessi		
MIGLIORIE (max punti 2)	presenza protocollo di sanificazione	si		
	informaticizzazione del servizio	il servizio di assistenza del sistema informatico è attivo solo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19. ESSENDO UNICO SISTEMA PER ACCEDERE AI SERVIZI DOVREBBE ESSERE ATTIVO 24/24 per 365 gg/anno. Il procedimento informatico seguito non risulta di facile utilizzo per personale sanitario.	3.00	
studio prevalenza	assente in quanto le ipotesi fornite non sono uno studio di prevalenza		2.00	
Totale punti			15.00	3.00

Struttura organizzativa KCI - Vivisol	Dati rilevati	NOTE	Punti max	Punteggio da riepilogo
Sede/Distributore	Genova - 380 m2 di superficie dedicata per la Liguria			
n° automezzi	13 dedicati per la Liguria - accessi separati (pulito/sporcio); deterzione-disinfezione-sanificazione per ogni tipo di trasporto; ogni 2 anni vengono cambiati			
n° personale: funzione e tempo dedicato	25 tecnici dedicati per la Liguria (di cui 13 solo per le consegne); 6 tecnici sanificatori KCI	previsto, in caso di aggiudicazione e al volume dell'attività, un aumento del personale dedicato (Vivisol)		
locazione centri di sanificazione	Assago (Milano), Torino, Firenze	per lo stoccaggio dedicato la sede è in Genova (se necessario vengono utilizzati i centri di stoccaggio di Ivrea e di Milano; il servizio prevede un collegamento con navette)		
aggiornamento personale n° ore	interni ospedaliero	previsti corsi di formazione dedicati, in base al ruolo ricoperto. Almeno 2 aggiorn. annui per un totale di 16 ore minimo 5 ore per Presidio Ospedaliero + 8 ore di corsi dedicati a tutto il personale coinvolto (rif. Pag 34). Totale 13 ore	6,00	5,50
n° verde	modalità richiesta tempistica consegna installazione collaudo tempistica dismissione	fax-mail-n. verde (presidiati 24/24 ore); software 6 ore solari con ricevimento 24 ore 24 ore - conforme al capitolo		
progetto di servizio ospedaliero	modalità assistenza	fax-mail-n. verde (presidiati 24/24 ore); software		
possesso di certificazioni di qualità		si (KCI-Vivisol)		
ASPETTI IGIENICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONI E SANITIZZAZIONE (max punti 4)	modalità sanificazione presenza protocollo di sanificazione	allamente dettagliata per tutti i tipi di superficie (allegato 10); si	3,00 1,00	3,00 1,00
INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO (max punti 3)	progetto di informatizzazione	si	3,00	3,00
MIGLIORIE (max punti 2)	studio prevalenza	si	2,00	2,00
Totale punti			15,00	14,50

Struttura organizzativa Hill- Rom	Dati rilevati	NOTE	Punti max	Punteggio assegnato
<p>Sede/Distributore</p> <p>n° automezzi</p> <p>n° personale funzione e tempo dedicato</p>	<p>Ditta ERO Snc di Genova</p> <p>36 furgoni allestiti per tutta Italia (Hill Rom)</p> <p>7 tecnici dedicati (Ditta ERO)</p>	<p>non si evince se i mezzi hanno la divisione sporco/pulito</p>		
<p>locazione centri di sanificazione</p>	<p>sede centrale di Milano/possibilità di sanificazione a Genova- Ditta ERO</p>	<p>sanificazione presso Milano con servizio navetta (mancano le specifiche per il servizio navetta); possibilità di sanificazione dei presidi presso la Ditta ERO di Genova</p>		
<p>aggiornamento personale n° ore</p>	<p>interno</p> <p>40 ore (5 giorni annui)</p>	<p>training e test on line (livello Basic o Advance), manca il dettaglio dei programmi di aggiornamento; non si evince quale percorso formativo viene proposto ai tecnici della Ditta ERO di Genova</p>		
<p>progetto di servizio ospedaliero</p>	<p>ospedaliero</p> <p>8 ore (1 o più giorni da concordare)</p>	<p>il personale verrà formato al momento dell'installazione del presidio da personale incaricato. E' presente un programma di massima per gli operatori (Safe Skin). Manca un programma specifico di formazione (n.ore, argomenti trattati...)</p>	6,00	3,50
<p>STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI (max punti 6)</p>	<p>n° verde</p> <p>no</p> <p>modalità richiesta</p> <p>tempistica consegna, installazione, collaudo</p> <p>tempistica dimissione</p>	<p>Call Center 24/24 ore per 365 giorni-on line 24/24 ore per 365 giorni</p> <p>installazione entro le 8 ore- intensiva entro le 6 ore</p> <p>18 ore</p>		
<p>progetto di servizio ospedaliero</p>	<p>modalità assistenza</p> <p>Call Center 24/24 ore per 365 giorni-on line 24/24 ore per 365 giorni</p>	<p>leggermente migliorativo</p> <p>leggermente migliorativo</p> <p>mancano i certif. di sanificazione e di sicurezza elettrica al momento della consegna del presidio; la bolla di accompagnamento verrà trasmessa tramite fax successivamente alla consegna del presidio (non si evince se i documenti di certificazione per la sanificazione e per la sicurezza elettrica siano parte integrante della bolla di</p>		
<p>possesso di certificazioni di qualità</p>	<p>si</p>	<p>Non si evince come vengano trattate le spugne poliuro dopo l'utilizzo Visto che la documentaz. Indica anche la ditta Hero come possibile sanificatore manca la piantina del locale di sanificaz. Hero e per quanto riguarda le procedure è presente una dichiaraz. di Hill rom che Hero utilizza le sue stesse procedure di sanific. nelle istruz. di lavoro non è ben chiaro quali prodotti vengano utilizzati per la sanificaz.</p>	3,00	2,50
<p>ASPETTI IGIENICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONI E SANITIZZAZIONE (max punti 4)</p>	<p>modalità sanificazione</p> <p>presenza protocollo di sanificazione</p>	<p>presenza di una check list (in lingua inglese), presentato percorso di sanificazione con evidenziazione del percorso sporco/pulito</p>		
<p>INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO max punti 3</p>	<p>progetto di Informatizzazione</p> <p>si (Therapy online)</p>	<p>il software sembra avere ottime potenzialità, dalla documentaz. presentata si evince la possibilità di avere uno buon studio di prevalenza su scala regionale con completezza di dati</p>	1,00	3,00
<p>MIGLIORIE max punti 2</p>	<p>studio prevalenza</p> <p>si</p>	<p>il software sembra avere ottime potenzialità, dalla documentaz. presentata si evince la possibilità di avere uno buon studio di prevalenza su scala regionale con completezza di dati</p>	2,00	1,90
<p>Totale punti</p>			15,00	11,90

Allegato 3

Scheda di valutazione tecnica dei lotti



The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'M.R.' with a long horizontal line extending to the right. To its right are the initials 'SS'. Further right, there is a signature that looks like 'Spere' and another signature that is partially obscured. On the far right, there are two more signatures, one above the other, with the top one being a simple 'R' and the bottom one being a more complex signature.

Scheda valutazione Lotto 1

Sistemi antidecubito a riduzione pressoria continua senza elettrocompressore per la prevenzione e/o il trattamento delle lesioni fino al
Il stadio;

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Dati rilevati - Lotto 1 Hill Rom P330 Wound Surface	Punti max	Punteggio assegnato - Lotto 1 Hill Rom P330 Wound Surface
Struttura organizzativa personale e mezzi impiegati	Sede/Distributore; Numero automezzi Numero personale; funzione e tempo dedicato Localizzazione centri di sanificazione Aggiornamento personale; numero ore Numero verde Possesso di certificazioni di qualità Progetto di servizio ospedaliero		6	3,50
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione	Modalità di lavaggio, sanificazione e asciugatura del sistema (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, ecc.) Possesso di certificazioni di qualità del percorso di sanificazione	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	3	2,50
Informatizzazione del servizio	Progetto di informatizzazione del servizio - richieste, dismissioni, informazioni e reportistica delle attività di		1	1,00
	Progetto di studio di prevalenza inerente le lesioni da pressione		3	3,00
Migliorie	Progetto di modalità di scarico dinamico delle pressioni di contatto		2	1,90
Principio di funzionamento	Scanco delle pressioni in relazione alle differenti zone corporee (anche con modalità differenti)	si	5	5,00
	Portata terapeutica in kg (> 120 kg) (a maggior portata corrisponderà maggior punteggiaggio)	testa e schiena sacrale cosce talloni	5	4,00
	Praticità d'uso (peso materasso, telo di copertura, maneggevolezza del sistema, versatilità dimensioni)	60 kg in più del richiesto La CPR a strappo corta può rimanere incastrata durante il rifacimento del letto	5	5,00
	Possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio		5	3,00
Comfort paziente	Stabilità e mantenimento della postura (prova del fondo)	buon piegamento e funzione terapeutica inalterata	4	4,00
	Facilità ad eseguire le manovre di nursing	non si sente il fondo a 90°	4	4,00
Comfort operatore	Facilità di sanificazione della cover (a maggior semplicità/praticità di sanificazione d'urgenza della cover corrisponderà maggior punteggiaggio)	si cover spessa	4	4,00
			3	2,00
TOTALE PUNTI			50	42,90
AMMESSO				si

1/3

1/4

[Handwritten signature]

Scheda valutazione Lotto 2
Sistemi a bassa pressione continua/ alternata per la prevenzione delle lesioni da pressione nei pazienti a medio rischio;

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Dati rilevati Lotto 2				Punteggi attribuiti Lotto 2				
		Rispondi Alpha Response	TSS Dual/Revo	Scale/gera Pulsar Choice MR	ATI: KCI-Vivrel Air Wares II	Hill Rom Primo	Rispondi Alpha Response	TSS Dual/Revo	Scale/gera Pulsar Choice MR	ATI: KCI-Vivrel Air Wares II
Struttura organizzativa personale e mezzi impiegati	Sede/Distributore: Numero automezzi Numero personale: funzione e tempo dedicato Località: centri di specializzazione Aggiornamento personale: numero ore Numero verde Progetto di servizio ospedaliero									
	Modalità di lavaggio, sanificazione e asciugatura del sistema (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, ecc.) Possesso di certificazioni di qualità del percorso di sanificazione									
	Progetto di informatizzazione del servizio: richieste, dismissioni, informazioni e reperibilità delle attività di noleggio.									
	Migliorie: Progetto di studio di prevedibilità inerente le lesioni da pressione Presenza di modalità di scarico dinamico delle pressioni di contatto.									
Principio di funzionamento	Scalico: livello pressioni in relazione alle differenti zone corporee (anche con modalità differenziali)									
	Funzionamento: presenza di sensori di temperatura, umidità, pressione, ecc.									
	Prodotto: materiali, durata, manutenzione, trasporto, ecc.									
	Modalità di utilizzo: modalità di utilizzo, manutenzione, ecc.									
Sicurezza	Comunicazione: implicazioni del tipo di comunicazione (visiva, uditiva, tattile, ecc.) Praticità d'uso: il datagramma (tattile, uditivo, ecc.) Sicurezza: presenza di sensori di temperatura, umidità, pressione, ecc.									
	Modalità di utilizzo: modalità di utilizzo, manutenzione, ecc.									
	Modalità di utilizzo: modalità di utilizzo, manutenzione, ecc.									
	Modalità di utilizzo: modalità di utilizzo, manutenzione, ecc.									
Impianto elettrico	Presenza di commutazione non elettrica: presenza di commutazione elettrica (tattile, uditiva, ecc.) Modalità di utilizzo: modalità di utilizzo, manutenzione, ecc.									
	Modalità di utilizzo: modalità di utilizzo, manutenzione, ecc.									
	Modalità di utilizzo: modalità di utilizzo, manutenzione, ecc.									
	Modalità di utilizzo: modalità di utilizzo, manutenzione, ecc.									
Unità motore	Modalità di utilizzo: modalità di utilizzo, manutenzione, ecc.									
	Modalità di utilizzo: modalità di utilizzo, manutenzione, ecc.									
	Modalità di utilizzo: modalità di utilizzo, manutenzione, ecc.									
	Modalità di utilizzo: modalità di utilizzo, manutenzione, ecc.									

Scheda valutazione Lotto 2
 Sistemi a bassa pressione continua/ alternata per la prevenzione delle lesioni da pressione nei pazienti a medio rischio;

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Dati rilevanti Lotto 2										Punti max	Recordimi	Punteggi attribuiti Lotto 2									
		Recordimi Alpha Response	TSS DualRevo	Scaligera Pulsar Choice MR	Rhea Air Express P280DF	ATI, KCA, Vivosol Air Works II	Hill Rom Primo	Recordimi Alpha Response	TSS DualRevo	Scaligera Pulsar Choice MR	Rhea Air Express P280DF			ATI, KCA, Vivosol Air Works II	Hill Rom Primo	Recordimi Alpha Response	TSS DualRevo	Scaligera Pulsar Choice MR	Rhea Air Express P280DF	ATI, KCA, Vivosol Air Works II	Hill Rom Primo		
Comfort paziente	Possibilità di plegamento per uso sui letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'aiuto.	buon plegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parziale/ alterata	buon plegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere alterata	buon plegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere alterata	buon plegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere alterata	buon plegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere alterata	buon plegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere alterata	buon plegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere alterata	buon plegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere alterata	buon plegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere alterata	buon plegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere alterata	2	1,80	1,80	1,50	1,80	1,50	1,50	2,00				
Comfort operatore	Facilità di utilizzo del sistema e dei comandi (tecnologia e posizione)	comandi in inglese con simbologia non di semplice interpretazione, blocco automatico della tastiera	comandi in inglese con simbologia non di semplice interpretazione, blocco automatico della tastiera	comandi in inglese con simbologia non di semplice interpretazione, blocco automatico della tastiera	comandi intuitivi	comandi intuitivi	comandi intuitivi	comandi intuitivi	comandi intuitivi	comandi intuitivi	comandi intuitivi	2	1,00	0,20	1,50	0,20	1,00	0,20	2,00				
	Facilità di sanificazione della cover (a)	display con poco contrasto/poco visibile	display con poco contrasto/poco visibile	display con poco contrasto/poco visibile	comandi intuitivi	comandi intuitivi	comandi intuitivi	comandi intuitivi	comandi intuitivi	comandi intuitivi	comandi intuitivi	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
	Facilità ad eseguire le manovre di nursing	tubo rigido, ostacolo manovre nursing	tubo rigido, ostacolo manovre nursing	tubo rigido, ostacolo manovre nursing	tubo flessibile non ostacola manovre nursing	tubo flessibile non ostacola manovre nursing	tubo flessibile non ostacola manovre nursing	tubo flessibile non ostacola manovre nursing	tubo flessibile non ostacola manovre nursing	tubo flessibile non ostacola manovre nursing	2	1,50	0,20	1,00	0,20	1,00	0,20	2,00					
TOTALE PUNTI AMMESSO												50	27,42	21,32	31,63	22,76	37,22	38,26					

Scheda valutazione Lotto 3

Sistemi a pressione alternata / fluttuazione dinamica per la prevenzione delle lesioni da pressione in pazienti ad alto rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione in un ospedale.

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Dati rilevati Lotto 3				Punteggi attribuiti Lotto 3					
		Ricordini Autologic	TSS Sistema Dual	Scaligera Quattro Plus	ATI/KCI-Vivisol Innova Extra O.L.	Hill Rom Clin Active Plus	Ricordini Autologic	TSS Sistema Dual	Scaligera Quattro Plus	ATI/KCI-Vivisol Innova Extra O.L.	Hill Rom Clin Active Plus
Struttura organizzativa personale e mezzi impiegati	Sede/Distributore										
	Numero automezzi dedicato										
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanificazione	Numero personale: funzione e tempo dedicato										
	Localizzazione centri di sanificazione										
Principio di funzionamento	Aggiornamento personale: numero ore										
	Numero verde										
Migliorie	Possesso di certificazioni di qualità del percorso di sanificazione										
	Progetto di studio di prevalenza inerente le lesioni da pressione										
Informalizzazione del servizio	Progetto di informatizzazione del servizio										
	Progetto di studio di prevalenza inerente le lesioni da pressione										
Principio di funzionamento	Presenza di modalità di scarico dinamico delle pressioni di contatto										
	Scarico delle pressioni in relazione alle differenti zone corporee (anche con modalità differenti)										
Principio di funzionamento	Funzione trasporto (+/- 3 ore) la maggior durata (rispondenza maggior privilegio)										
	Portata terapeutica in Kg (120 Kg / 40 Kg) portata corrispondente maggior vantaggio										
Principio di funzionamento	Accessibilità e facilità di utilizzo della valvola CPR										
	Caratteristiche migliorative del telo di copertura										
Principio di funzionamento	Praticità d'uso										
	peso										

Handwritten signature and notes at the top left of the page.

Scheda valutazione Lotto 3

1/3

[Handwritten signature]

Sistemi a pressione alternata / fluttuazione dinamica per la prevenzione delle lesioni da pressione fino al III° stadio. lesioni da pressione fino al III° stadio.

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Dati rivolti Lotto 3				Punti Max	Punteggi attribuiti Lotto 3			
		Ricordini AutoLogic	TSS Sistema Dual	Scaligera Quattro Plus	ATI: KCI-Vivisol Innova Extra O.L		Hill Rom Clim Active Plus	Ricordini AutoLogic	Sistema Dual	Scaligera Quattro Plus
	(peso materasso, n° dimensioni, tela di copertura, maneggevolezza del sistema, maneggevolezza versatilità dimensioni)	1	2	4	2	0,5	0,25	0,50	0,25	0,13
	l tubo verso l'esterno ingombrante: attacco difficile - doppio moschettone	si			si	1	1,00	0,50	1,00	1
Sicurezza	Allarmi (tipologia e parametri segnalati) (ad una più ampia gamma di allarmi (acustici, visivi) e parametri segnalati corrispondere maggior punteggio)	4	2 di difficile interpretazione e suona ogni fine ciclo. Pertanto il punteggio per il numero degli allarmi sarebbe 1 ma viene operata una penalizzazione di 0,50	8 "la prova pratica ha evidenziato che il prodotto di Scaligera ha un tono di allarme molto basso e difficilmente udibile in un contesto di reparto (penalizzazione 1 punto) la prova pratica ha evidenziato che in mancanza di alimentazione l'allarme NON è scattato (penalizzazione 0,50)	5	4	1,80	1,70	2,00	4,00
Impianto elettrico	Possibilità di sostituzione del cavo elettrico/spina in base alle esigenze della rete elettrica (cable - single unità operative)		spinnotto intercambiabile	spinnotto intercambiabile	spinnotto intercambiabile	2	0,25	2,00	2,00	2,00
Unità motore	Praticità di connessione del motore al materasso: pulizia, etc. Peso unità motore (a minor peso corrisponderà maggior punteggio) Estetica: Dimensioni (a migliore estetica a minor vibrazioni, a minori dimensioni corrisponderà maggior punteggio) Rumorosità della pompa (certificazione sul db") (a minor rumorosità corrisponderà maggior punteggio)	2,75	attacco difficile con doppio moschettone	connessione in plastica attaccata direttamente al tubo. La connessione provoca la torsione del tubo.	2,9	1	0,50	0,25	1,00	1,00
Comfort paziente	Stabilità e mantenimento della postura (prova del fondo). Possibilità di pleggiamento per uso su letti antichi (senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio)	33125	si sente parzialmente il fondo a 90°	buoni pleggiamenti ma funzione terapeutica potrebbe essere parziali alterata	12544	1	0,91	1,00	0,74	0,54
	Facilità di utilizzo del sistema e dei comandi (tecnologia e posizioni).	20	si sente parzialmente il fondo a 90°	buoni pleggiamenti ma funzione terapeutica potrebbe essere parziali alterata	30	1	0,75	0,54	1,00	0,50
Comfort operatore	Facilità di sanificazione della cover: la maggior semplicità/praticità di sanificazione d'urgenza della cover, corrispondere maggior punteggio) Facilità ad eseguire le manovre di nursing		si	si sente parzialmente il fondo a 90°	si	2	3,00	3,00	2,00	3,00
			si	buoni pleggiamenti ma funzione terapeutica potrebbe essere parziali alterata	si	2	1,80	1,80	1,50	2,00
			si	buoni pleggiamenti ma funzione terapeutica potrebbe essere parziali alterata	si	2	1,50	1,20	1,50	2,00
			si	buoni pleggiamenti ma funzione terapeutica potrebbe essere parziali alterata	si	1	1,00	1,00	1,00	1,00
			si	buoni pleggiamenti ma funzione terapeutica potrebbe essere parziali alterata	si	2	1,50	0,20	1,00	2,00
			si	buoni pleggiamenti ma funzione terapeutica potrebbe essere parziali alterata	si	50	28,15	24,10	28,98	44,70
										39,04

Scheda valutazione Lotto 4

Sistemi per la prevenzione dei pazienti ad altissimo rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al IV stadio di varia tecnologia in grado di gestire la macerazione cutanea.

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Punteggi attribuiti Lotto 4										
		Ricordini	Scaligera	Reha	ATI: KCI-Vivisol	Hill Rom	Punti max	Ricordini	Scaligera	Reha	ATI: KCI-Vivisol	Hill Rom
Struttura organizzativa personale e mezzi impiegati	<p>Sede/Distributore:</p> <p>Numero automezzi</p> <p>Numero personale: funzione e tempo dedicato</p> <p>Localizzazione centri di sanificazione</p> <p>Aggiornamento personale: numero ore</p> <p>Numero verde</p> <p>Possesso di certificazioni di qualità</p> <p>Progetto di servizio ospedaliero</p>	Nimbus 3	Quattro Acute	Auto Sure Float	Innova Eivra MRS	Clean Active Plus MCM	6	2,00	2,00	2,00	5,50	3,50
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanizzazione	<p>Modalità di lavaggio, sanificazione e asciugatura del sistema (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, ecc.)</p> <p>Possesso di certificazioni di qualità del percorso di sanificazione</p>	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	3	0,00	0,00	0,00	3,00	2,50
Informaticizzazione del servizio	<p>Progetto di informatizzazione del servizio</p> <p>richieste, dismissioni, informazioni e reperibilità delle attività di noleggio</p>	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Migliore	<p>Progetto di studio di prevalenza inerente le lesioni da pressione</p> <p>Presenza di modalità di scalico dinamico delle pressioni di contatto</p> <p>Scambio delle pressioni in relazione alle differenti zone corporali (anche con modalità differenti)</p> <p>Funzione trasporto (-) o (+) (a maggior durata corrisponderà maggior tempo)</p> <p>Puntata indipendente in Kg e Litri (a maggior portata corrisponderà maggior tempo)</p>	3 zone: testa tronco talloni	1 zona: celle tipo uguale che non garantiscono il trattamento diversificato delle diverse zone (torace)	3 zone: testa tronco talloni	5 zone: testa dorso sacro poplite talloni	2	1,20	1,20	0,40	1,20	2,00	2,00
Principio di funzionamento	<p>Accessibilità e facilità di utilizzo della valvola CER</p> <p>Caratteristiche ingegneristiche del telaio di copertura</p> <p>Praticità di uso (peso, dimensioni, maneggevolezza del sistema)</p>	La valvola viene individuata con una linguetta larga posta a sinistra e deve essere attivata ruotandola quindi la manovra risulta poco faticosa	La valvola viene individuata con una linguetta larga posta a sinistra e deve essere attivata ruotandola quindi la manovra risulta poco faticosa	La valvola viene individuata con una linguetta larga posta a sinistra e deve essere attivata ruotandola quindi la manovra risulta poco faticosa	La valvola viene individuata con una linguetta larga posta a sinistra e deve essere attivata ruotandola quindi la manovra risulta poco faticosa	2	2,00	1,11	1,11	2,00	1,11	1,11
Sicurezza	<p>Alarmi (tipologia e parametri segnalati) (ad una più ampia gamma di allarmi (acustici, visivi) e parametri segnalati corrisponderà maggior punteggio)</p>	La prova pratica ha evidenziato che il prodotto di Scaligera ha un peso di allarme molto basso e difficilmente udibile in un contesto di reparto penalizzazione di un punto da 2,20 a 2,00	La prova pratica ha evidenziato che il prodotto di Scaligera ha un peso di allarme molto basso e difficilmente udibile in un contesto di reparto penalizzazione di un punto da 2,20 a 2,00	La prova pratica ha evidenziato che il prodotto di Scaligera ha un peso di allarme molto basso e difficilmente udibile in un contesto di reparto penalizzazione di un punto da 2,20 a 2,00	La prova pratica ha evidenziato che il prodotto di Scaligera ha un peso di allarme molto basso e difficilmente udibile in un contesto di reparto penalizzazione di un punto da 2,20 a 2,00	2	0,50	0,27	0,50	0,50	2,00	1,00
Impianto elettrico	<p>Possibilità di sostituzione del cavo elettrico senza in base alle esigenze della rete elettrica delle singole unità operative</p>	La connessione al motore risulta poco funzionale per via della rigidità del tubo	La connessione al motore risulta poco funzionale per via della rigidità del tubo	La connessione al motore risulta poco funzionale per via della rigidità del tubo	La connessione al motore risulta poco funzionale per via della rigidità del tubo	2	0,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Infra motore	<p>Franchità di connessione del motore al materasso pulizia, etc</p> <p>Peso unità motore (a minor peso corrisponderà maggior punteggio)</p>	La connessione al motore risulta poco funzionale per via della rigidità del tubo	La connessione al motore risulta poco funzionale per via della rigidità del tubo	La connessione al motore risulta poco funzionale per via della rigidità del tubo	La connessione al motore risulta poco funzionale per via della rigidità del tubo	1	0,25	0,25	0,25	1,00	1,00	1,00
		5,7	3,4	4,3	2,9	4,6	0,51	0,85	0,67	1,00	0,63	0,63

Scheda valutazione Lotto 4

Sistemi per la prevenzione dei pazienti ad altissimo rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al IV stadio di varia tecnologia in grado di gestire la macerazione cutanea.

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Dati Rilevati Lotto 4				Punteggi attribuiti Lotto 4	Punti max	Punteggi attribuiti Lotto 4					
		Ricordini Nimbus 3	Scaligera Quattro Acute	Reha Auto Sure Float	ATI KCI-Vivisol Innova Extra MRS			Hill Rom Clean Active Plus MCM	Ricordini Nimbus 3	Scaligera Quattro Acute	Reha Auto Sure Float	ATI KCI-Vivisol Innova Extra MRS	Hill Rom Clean Active Plus MCM
	Estetica: Dimensioni (a migliore estetica, a minor vibrazioni, a minori dimensioni corrisponderà maggior punteggio) Rumorosità della pompa (certificazione sui db*) (a minor rumorosità corrisponderà maggior punteggio)	11176	12879	8632	12544	19096	1	0,79	0,69	1,00	0,70	0,46	
		20	15	32	30	35	1	0,75	1,00	0,47	0,50	0,43	
Comfort paziente	Stabilità e mantenimento della postura (prova del fondo) Possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio	si sente parzialmente il fondo a 90° buon piegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialm. alterata	si sente il fondo a 90° buon piegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere alterata	si sente parzialmente il fondo a 90° buon piegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialm. alterata	non si sente il fondo a 90° buon piegamento e funzione terapeutica inalterata	si sente parzialmente il fondo a 90° buon piegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialm. alterata	4	3,00	2,00	3,00	4,00	3,00	
		la funzione del transport non è facilmente attivabile in quanto da ricercare nel materasso e non nel motore. La differenziazione della zona taloni si ottiene mediante fasce elastiche che attivano lo sgonfiamento forzato (tecnologia assoluta)	con lo stesso puscante vengono attivate 4 funzioni: il display e di difficile interpretazione, la tastiera va in blocco automatico che per altro non viene segnalato da apposita spia	buon rigido e ingombro motore ostacolano manovre nursing inoltre la funzione transport non è facilmente attivabile in quanto da ricercare nel materasso e non nel motore	buon rigido. Connessione difficoltosa con il stesso puscante vengono attivate 4 funzioni: il display e di difficile interpretazione, la tastiera va in blocco automatico che nel tutto non viene segnalato da apposita spia	si sente parzialmente il fondo a 90° buon piegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialm. alterata	si sente il fondo a 90° buon piegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialm. alterata	si sente parzialmente il fondo a 90° buon piegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialm. alterata	2	0,10	1,00	0,20	2,00
Comfort operatore	Facilità di utilizzo del sistema e dei comandi (tecnologia e posizione) Facilità di sanificazione della cover (la maggior semplicità/praticità di sanificazione d'urgenza della cover corrisponderà maggior punteggio) Facilità ad eseguire le manovre di nursing	si	si	si	si	si	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		si sente parzialmente il fondo a 90° buon piegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialm. alterata	con lo stesso puscante vengono attivate 4 funzioni: il display e di difficile interpretazione, la tastiera va in blocco automatico che per altro non viene segnalato da apposita spia	buon rigido e ingombro motore ostacolano manovre nursing inoltre la funzione transport non è facilmente attivabile in quanto da ricercare nel materasso e non nel motore	buon rigido. Connessione difficoltosa con il stesso puscante vengono attivate 4 funzioni: il display e di difficile interpretazione, la tastiera va in blocco automatico che nel tutto non viene segnalato da apposita spia	si sente parzialmente il fondo a 90° buon piegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialm. alterata	si sente il fondo a 90° buon piegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialm. alterata	si sente parzialmente il fondo a 90° buon piegamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialm. alterata	2	0,50	1,00	0,50	2,00
TOTALE PUNTI							50	24,48	28,78	22,45	43,73	38,55	
AMMESSO								no	si	no	si	no	si

Handwritten signatures and initials: "VLC", "98", and a large signature.

Scheda valutazione lotto 5

Sistemi a reale cessione d'aria per la prevenzione dei pazienti ad altissimo rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al IV stadio per terapia intensiva.

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Parametri rilevati Lotto 5 ATI: KCI-Viviscil Thera Kair Visio	Punti max	Punti attribuiti Lotto 5 ATI: KCI-Viviscil Thera Kair Visio
Struttura organizzativa personale e mezzi impiegati	Sede/Distributore; Numero automezzi Numero personale: funzione e tempo dedicato Localizzazione centri di sanificazione Aggiornamento personale: numero ore Numero verde Possesso di certificazioni di qualità Progetto di servizio ospedaliero		6	5,50
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanificazione	Modalità di lavaggio, sanificazione e asciugatura del sistema (materasso, telo, unità motore, lubri di collegamento, ecc.) Possesso di certificazioni di qualità del percorso di sanificazione	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	3	3,00
Informatizzazione del servizio	Progetto di informatizzazione del servizio: richieste, dismissioni, informazioni e reportistica delle attività di noleggio		1	1,00
Migliorie	Progetto di studio di prevalenza inerente le lesioni da pressione		3	3,00
Principio di funzionamento	Presenza di modalità di scarico dinamico delle pressioni di contatto Scarico delle pressioni in relazione alle differenti zone corporee (anche con modalità differenti) Funzione trasporto: > di 3 ore (la maggior durata corrisponderà maggior punteggio) Portata terapeutica in kg: > 120 kg (la maggior portata corrisponderà maggior punteggio) Accessibilità e facilità di utilizzo della calotta CPR Caratteristiche meccaniche del telo di copertura Praticità d'uso: peso materasso: telo di copertura: > 1,3/2 Maneggevolezza del sistema: versatilità dimensioni Gestione della macerazione cutanea Allarmi, tipologia e parametri segnalati (ad alta per aritmia, garramiti, allarmi, allarmi visivi e parametri segnalati)	si non indicate quante ore di funzione di trasporto in g/m rispetto alle 3: 15 si quante te- 1,3/2 si	2 3 2 2 2 1 1 1 3	2,00 2,00 - 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00
Sicurezza	Possibilità di sostituzione del cavo elettrico/struttura in base alle esigenze della rete elettrica delle singole unità operative	si	2	2,00
Impianto elettrico	Praticità di connessione del motore al materasso, pila, etc.	si	1	1,00
Unità motore	Peso unità motore (la minor peso corrisponderà maggior punteggio) Esercizio/Dimensioni (la migliore struttura, a minor ingombro) Minori dimensioni: corrisponderà maggior punteggio Numerosità della pompa (certificazione sui db): a minor rumorosità corrisponderà maggior punteggio	si 6,3kg 236,14 39	1 1 1 1	1,00 1,00 1,00 1,00
Confort paziente	Stabilità e mantenimento della postura (prova dei fondi) Possibilità di piedamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio.	non si sente il fondo a 90° si	2 2	2,00 2,00
Confort operatore	Facilità di utilizzo del sistema e dei comandi: ibridologia e posizione Facilità di sanificazione della cover (la maggior semplicità/praticità di sanificazione di urgenza della cover corrisponderà maggior punteggio) Facilità ad eseguire le manovre di nursing	si	2 1 2	2,00 1,00 2,00
TOTALE PUNTI AMMESSO			50	46,50
				si