



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa tel.010/5488561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Francesca De Martini tel. 010/5488543 e-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi per laboratorio di Neurofisiopatologia occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, I.R.C.C.S San Martino, Istituto Gaslini per un periodo di 24 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 36. Numero gara 7215896

Verbale di valutazione delle offerte tecniche. Seduta riservata del 11-05-2020

Il giorno 11/05/2020, alle ore 14:15, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, la Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 59 del 21/02/2019 e successiva Determinazione 67 del 25/02/2019, formata da Dott.ssa Daniela Audenino, Dott.ssa Lizia Reni e Dott. Davide Faga, in conformità al Regolamento approvato con determinazione n. 118 del 06/03/2020, si riunisce nel suo plenum mediante collegamento simultaneo a distanza in videoconferenza, via SKYPE.

La Dott.ssa Francesca De Martini, Collaboratore Amministrativo della Centrale, in qualità di Segretario verbalizzante presenza mediante collegamento simultaneo via SKYPE.

Nella seduta odierna, essendosi conclusa la prova della campionatura dei prodotti offerti nei lotti 11-17-18-21-22-23-24-25-26-27-28-29-31-32-33-34-36, la Commissione procede all'attribuzione dei relativi punteggi tecnici per il lotto 11 e alla conferma dell'idoneità per gli altri lotti al minor prezzo, comunicando i medesimi al Segretario che provvede ad inserirli nelle tabelle riepilogative, allegate al presente verbale quali parti integranti e sostanziali.

La Commissione giudicatrice riprende i lavori dal lotto 8 e dà mandato alla Cra di richiedere alla ditta Spes ulteriori campioni. Le misure richieste sono:

- 37 x 0,45 mm, in numero di 3 campioni
- 50 x 0,45 mm, in numero di 3 campioni.

e quindi posticipa la valutazione a successiva seduta.

Si riportano le motivazioni della Commissione per ogni lotto valutato.

Per il lotto 11, si dà lettura della nota della ditta Ambu, acquisita agli atti con prot. 25770 del 25/11/2019, (esclusa perché Nucleo interno in AG e non nel materiale richiesto da Capitolato-*nucleo interno in platino o NiCr*), in cui chiede di essere riammessa al prosieguo della gara in quanto dichiara che il prodotto offerto è "...assolutamente equivalente a quanto richiesto ma oggettivamente migliorativo".

La Commissione riesamina la documentazione tecnica di tutte le offerte relative al lotto 11 e ritiene di riammettere la ditta Ambu accogliendo la dichiarazione di equivalenza fornita dalla stessa Ditta perchè l'argento è oggettivamente il miglior conduttore.

La Commissione, inoltre, dà atto che nell'offerta della ditta Ambu, il diametro dell'ago di lunghezza 75 mm è di 0,65 mm anziché 0,60 mm, ma ritiene che lo scarto tra 0,60 e 0,65 mm è irrilevante, insignificante e non inficia in alcun modo l'esito dell'esame.

| Lotto11-Ago-elettrodo concentrico EMG sconnettibile e relativo cavo schermato di collegamento | |
|---|--|
| 1) Qualità del segnale | Ambu: eccellente, stabile Sei: molti artefatti e disturbato. |
| 2) Affilatura dell'ago | Ambu: eccellente Sei: l'introduzione e gli spostamenti sono più traumatici. |

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria


C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

| | |
|---|---|
| 3) Rigidità dell'ago | Ambu: eccellente, adeguata. Sei: molto rigido. |
| 4) Caratteristiche del cavo di collegamento | Ambu: eccellente Sei: induce facilmente artefatti ambientali, sembrerebbe per schermatura non ottimale |
| 5) Confezionamento primario e secondario | entrambi eccellenti |

Per il lotto 13, si dà lettura della nota della ditta Sei Emg, acquisita agli atti con prot. 25119 del 18/11/2019, (esclusa perché non presenti le lunghezze dal min. al max. come richiesto dal Capitolato), in cui chiede di essere riammessa perché *"....possiamo infatti, essendo costruttori, produrre gli elettrodi in questione con qualsiasi lunghezza cavo voluta.Questo vale anche per le misure intermedie del cavo e per gli altri modelli di elettrodi indicati in offerta.Nel codice proposto abbiamo dovuto indicare per motivi di spazio -XX nel campo lunghezza cavo"*.

La Commissione fa notare che l'esclusione si riferiva al punto 2) del Capitolato tecnico e cioè: *"Lunghezza aghi compresa tra 12 mm e 40 mm (devono essere disponibili diverse misure dal minimo al massimo) e non alla lunghezza del cavo"*.

La Commissione ritiene comunque di riesaminare la documentazione tecnica di tutte le offerte relative al lotto 13, che erano state tutte escluse, e dall'esame risulta che solo la ditta Sei Emg offre aghi di lunghezza compresa tra 12 mm e 40 mm. In dettaglio, la Sei Emg offre i seguenti prodotti: "MU12HC1-XX, MU15HC1-XX, MU25HC1-XX, MU40HC1-XX".

La Commissione quindi, sulla base del sopracitato riesame, riammette la ditta Sei al prosieguo della gara.

Si procede con i lotti aggiudicati con il criterio del minor prezzo. Dalla prova della campionatura, risultano confermate le idoneità dei lotti 17-18-21-22-23-24-25-26-27-28-29-31-32-33-34-36. I lotti 16-19-20-30 non presentano offerte idonee ed il lotto 35 è deserto.

Per il lotto 32, si dà lettura della nota della ditta Spes Medica, acquisita agli atti con prot. 26634 del 5/12/2019. Alla richiesta di campionatura integrativa, la ditta Spes Medica ha inviato un prodotto (Cerebro) diverso da quello offerto in gara (Cortac). Si riporta stralcio della nota su citata: *"... la ditta PMT ha perso il marchio CE per problemi con il loro fornitore di sterilizzazione, ciò significa che nessuna ditta è più autorizzata a distribuire quel prodotto in Europa, pertanto la nostra alternativa è di un prodotto molto migliore da un punto di vista tecnico senza andare ad influire sul prezzo"*.

La Commissione prende atto della nota della Spes e la esclude di conseguenza e dà mandato alla Centrale di mandare lettera di esclusione.

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta.

La seduta è chiusa alle ore 17:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice:

Presidente

Dott.ssa Daniela Audenino

Componente

Dott. Davide Faga

Componente

Dott.ssa Lizia Reni


La Centrale Regionale di Acquisto:

Segretario

Dott.ssa Francesca De Martini

| Lotto11-Ago-elettrodo concentrico EMG sconnettibile e relativo cavo schermato di collegamento | Max punti | Parametri | Punteggi | AMBU SRL | BIONEN SAS | FIAB SPA | SEI EMG SRL | SPES MEDICA SRL | SYNOPO SPA |
|---|--------------|-----------|--|---|--|--|--|---|--|
| Requisiti essenziali | | | | idoneo | escluso:il prodotto offerto ("PREMIUM") non risulta dotato di nucleo interno in Platino o NiCr. Il cavo di collegamento non risulta schermato. La lunghezza del cavo non risulta sia compresa tra 100 e 150 cm. Non risulta che la lunghezza dell'ago sub punto c) del Capitolato sia compresa tra 60 e 75 mm. | escluso:Nucleo interno in Titanio e non nel materiale richiesto da Capitolato. | idoneo | escluso:Nucleo interno (Sensore) in Acciaio e non nel materiale richiesto da Capitolato. | escluso:Nucleo interno (elettrodo centrale) in Acciaio e non nel materiale richiesto da Capitolato. |
| 1) Qualità del segnale | 25 | Q1 | AUDENINO RENI FAGA Media coefficienti riportata a 1 Punteggio | 0,9 0,9 1 0,933 1 25,000 | | | 0,5 0,5 0,6 0,533 0,571 14,286 0,6 0,5 0,4 0,5 0,536 8,036 0,4 0,4 0,5 0,433 0,464 6,964 0,5 0,5 0,4 0,4 0,433 0,448 4,483 1 1 1 1 1 5,000 38,768 | | |
| 2) Affilatura dell'ago | 15 | Q1 | AUDENINO RENI FAGA Media coefficienti riportata a 1 Punteggio | 1 0,9 0,9 0,933 1 15,000 | | | | | |
| 3) Rigidità dell'ago | 15 | Q1 | AUDENINO RENI FAGA Media coefficienti riportata a 1 Punteggio | 1 0,9 0,9 0,933 1 15,000 | | | | | |
| 4) Caratteristiche del cavo di collegamento | 10 | Q1 | AUDENINO RENI FAGA Media coefficienti riportata a 1 Punteggio | 1 0,9 1 0,967 1 10,000 | | | | | |
| 5) Confezionamento primario e secondario | 5 | Q1 | AUDENINO RENI FAGA Media coefficienti riportata a 1 Punteggio | 1 1 1 1 1 5,000 | | | | | |
| Totale punteggio di qualità | 70 | | | 70,000 | | | | | |
| Totale punteggio di qualità riparametrato | 70 | | | 70,000 | | | | | |

| Lotto 16-Elettrodi adesivi pregellati di superficie accoppiati | EMS SRL | MEDTRONIC ITALIA SPA | SPES MEDICA SRL |
|--|---|---|--|
| Requisiti essenziali | escluso: manca requisito sterile richiesto dal capitolato. Manca requisito "biocompatibile" | escluso: manca requisito sterile richiesto dal capitolato. | escluso: manca requisito sterile richiesto dal capitolato. |





| | | | |
|--------------------------------|------------|----------|-----------------|
| Lotto17-Elettrodo a tampone | BIONEN SAS | FIAB SPA | SPES MEDICA SRL |
| Requisiti essenziali | idoneo | idoneo | idoneo |




Handwritten signature

| Lotto 18-Elettrodo a coppetta | AMBU SRL | BIONEN SAS | FIAB SPA | SPES MEDICA SRL |
|-------------------------------|--|--|----------|--|
| Requisiti essenziali | escluso: Mancano lunghezze cavo 250 e 300 cm. Manca diametro coppetta da 6 mm. | escluso: Manca il diametro 6 mm. Non risultano le lunghezze del cavetto di 100, 150, 200, 250 e 300 cm. Non risulta l'idoneità all'utilizzo con collodio e acetone. | idoneo | escluso: Manca cavetto di 300 cm. Manca diametro elettrodo 6 mm. |



| Lotto 19-Cavetti terminale a bottone | BIONEN SAS | FIAB SPA | SPES MEDICA SRL |
|--------------------------------------|--|--|---|
| Requisiti essenziali | escluso:Non risulta che il terminale a bottone sia siliconato e con guaina di rinforzo isolante. Non risulta la presenza delle lunghezze del cavetto di 150 e 200 cm. | escluso:Manca terminale a bottone siliconato e guaina di rinforzo isolante | escluso:Manca terminale a bottone siliconato e manca la lunghezza cavo di 300cm |

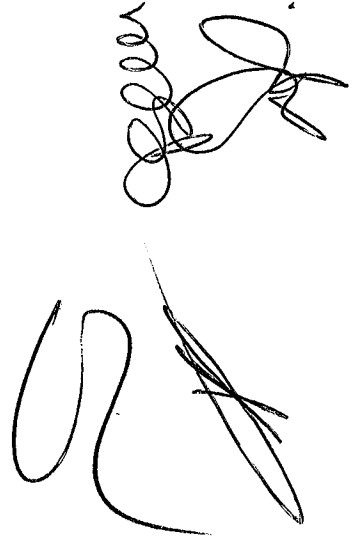


| Lotto20-Cavetti per EEG terminale a spinotto a molla | BIONEN SAS | SPES MEDICA SRL |
|--|---|--|
| Requisiti essenziali | <p>escluso:Non presente il terminale a spinotto a molla di diametro 2 mm, disponibile a 90°.</p> <p>Non presente il requisito che il cavetto sia siliconato, con guaina di rinforzo isolante.</p> | <p>escluso:Manca terminale a bottone siliconato. Manca angolazione 90° . Non indicata la lunghezza cavo come richiesto dal capitolato.</p> |







| | | |
|----------------------|---|-----------------|
| Lotto21-Ago smussato | BIONEN SAS | SPES MEDICA SRL |
| Requisiti essenziali | escluso:Non è indicato che la lunghezza sia compresa tra 15 e 25 mm | idoneo |




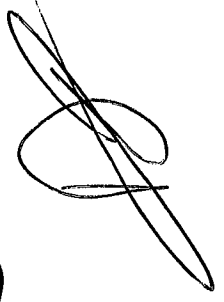

| Lotto22-Cuffia per EEG | BIONEN SAS | SEI EMG SRL | SPES MEDICA SRL |
|------------------------|---|-------------|-----------------|
| Requisiti essenziali | escluso: Non è sufficientemente regolabile. | idoneo | idoneo |

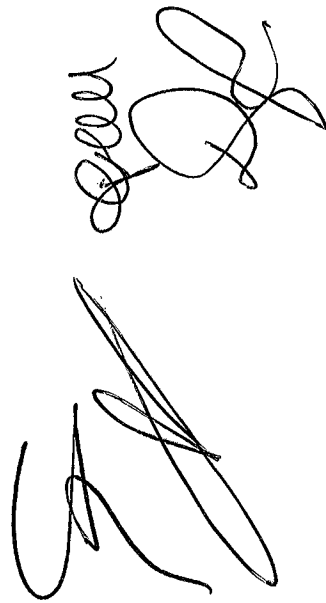


| | | | |
|--------------------------|------------|----------|-----------------|
| Lotto23-Pasta sgrassante | BIONEN SAS | FIAB SPA | SPES MEDICA SRL |
| Requisiti essenziali | idoneo | idoneo | idoneo |

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| Lotto24-Trasduttore oro- nasale | BIONEN SAS | SPES MEDICA SRL |
| Requisiti essenziali | idoneo | idoneo |

| | | |
|---------------------------------|------------|-----------------|
| Lotto25-Trasduttore toracico | BIONEN SAS | SPES MEDICA SRL |
| Requisiti essenziali | idoneo | idoneo |




| | | | |
|--|------------|-------------|-----------------|
| Lotto26-coppia di elettrodi ad anello in metallo di cavo di collegamento | BIONEN SAS | SEI EMG SRL | SPES MEDICA SRL |
| Requisiti essenziali | idoneo | idoneo | idoneo |

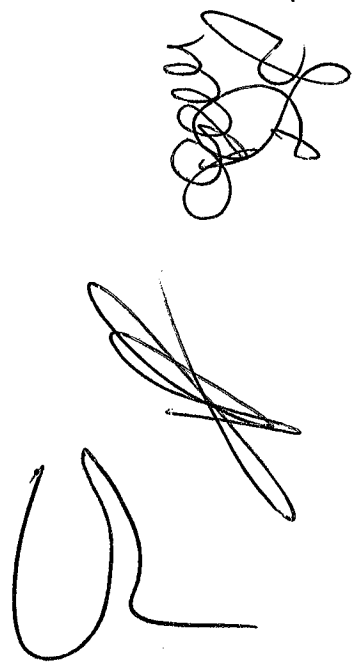




| | | |
|--|------------|-----------------|
| Lotto27-Stimolatore bipolare di superficie completo di fascia di fissaggio | BIONEN SAS | SPES MEDICA SRL |
| Requisiti essenziali | idoneo | idoneo |






| | | | |
|---|----------------|-------------------|------------------------|
| Lotto28-Sonda di stimolazione bipolare | EMS SRL | SYNOPO SPA | SPES MEDICA SRL |
| Requisiti essenziali | idoneo | idoneo | idoneo |






| | | | | |
|---|----------|---------|------------|-----------------|
| Lotto29-Sonda di stimolazione monopolare | AMBU SRL | EMS SRL | SYNOPO SPA | SPES MEDICA SRL |
| Requisiti essenziali | idoneo | idoneo | idoneo | idoneo |
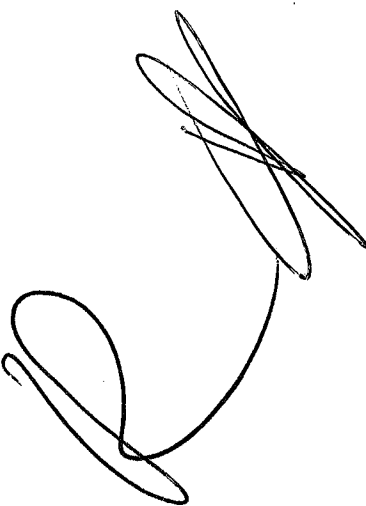
| | | |
|--|---|---|
| Lotto30-Manipolo di stimolazione bipolare a miniforchetta | EMS SRL | SPES MEDICA SRL |
| Requisiti essenziali | escluso:Lunghezza della punta esposta superiore a 48 mm | escluso:Lunghezza del manipolo inferiore a 18 cm |

| | |
|---|------------------------------------|
| <p>Lotto31-Set dilatatori per stimolazione e per inserimento cage laterale con procedura di DLIF</p> | <p>MEDTRONIC ITALIA SPA</p> |
| <p>Requisiti essenziali</p> | <p>idoneo</p> |
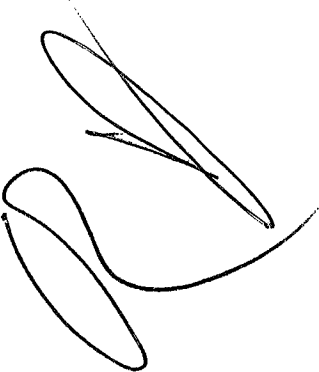
| | | |
|--|----------------|--|
| Lotto32-Elettrodo di registrazione e stimolazione corticale | EMS SRL | SPES MEDICA SRL |
| Requisiti essenziali | idoneo | escluso per sopraggiunta impossibilità di fornire il prodotto offerto in gara. |

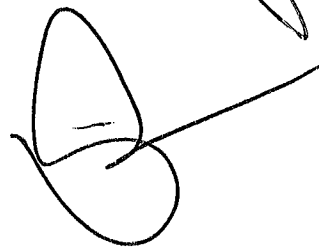



| | |
|--|---------|
| Lotto33-Elettrodi spinali epidurali | EMS SRL |
| Requisiti essenziali | idoneo |



Handwritten signature and stamp. The signature is a large, stylized 'S' or 'B' shape. The stamp is a circular official seal with illegible text inside.

| | | |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| Lotto34-Elettrodo a filo | SEI EMG SRL | SPES MEDICA SRL |
| Requisiti essenziali | idoneo | idoneo |

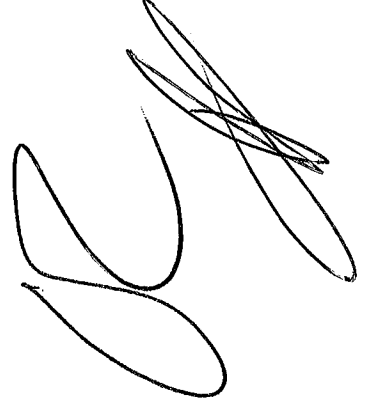


Lotto35-Elettrodo registrazione dei potenziali evocati acustici - DESERTO

7

2000

| | |
|------------------------|------------|
| Lotto36-Cannula nasale | BIONEN SAS |
| Requisiti essenziali | idoneo |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]