

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile RUP: Dott. Luigi Moreno COSTA – tel. 010 548 8561 luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI tel. 010/548-8553 tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

DETERMINAZIONE N. 259 DEL 15/7/2019

Oggetto: Procedura negoziata ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'effettuazione dei rilanci competitivi ex 59 D. Lgs. n. 163/2006 finalizzati all'affidamento, in attuazione dell'Accordo Quadro aggiudicato con Determinazione n. 197 del 18/7/2016, Determinazione n. 45 del 17/11/2016 e Determinazione n. 67 del 21.2.2017, della fornitura di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti alla ASL n. 3 Genovese, alla ASL n. 5 Spezzina, all'E.O. Ospedali Galliera e all'Ospedale Policlinico San Martino IRCCS. Lotti n. 5 N. Gara: 7334365. Aggiudicazione definitiva.

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Visto l'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dal 01/10/2016 da A.Li.Sa;

Viste le deliberazioni n. 152 e 153 del 23/11/2017 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. con la quale sono state definite e attribuite, in via transitoria, le responsabilità dirigenziali al Direttore e ai Dirigenti dell'Area CRA;

Visto l'art. 8 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento in materia di competenze del direttore dell'Area CRA;

Richiamata la propria Determinazione n. 44 del 7/2/2019, al cui contenuto necessariamente si rinvia, con la quale si era provveduto all'indizione della procedura negoziata ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'effettuazione dei rilanci competitivi ex 59 D. Lgs. n. 163/2006 finalizzati all'affidamento, in attuazione dell'Accordo Quadro aggiudicato con Determinazione n. 197 del 18/7/2016, Determinazione n. 45 del 17/11/2016 e Determinazione n. 67 del 21.2.2017, della fornitura di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti alla ASL n. 3 Genovese, alla ASL n. 5 Spezzina, all'E.O. Ospedali Galliera e all'Ospedale Policlinico San Martino IRCCS. Lotti n. 5 N. Gara: 7334365. ed alla contestuale approvazione della Lettera di Invito contenente le norme di partecipazione;

Considerato che, al rilancio competitivo, sono state invitate le ditte risultate rispettivamente aggiudicatarie dei corrispondenti Lotti dell'Accordo Quadro come di seguito meglio specificato:

LOTTO	DESCRIZIONE	CIG	SOCIETA' INVITATE A PRESENTARE OFFERTA
1	Ecografi portatile di servizio a supporto di indagini diagnostico/terapeutiche eco-guidate (ex lotto 1 Accordo Quadro)	7789843DCA	• Esaote spa • FujiFilm Italia spa



2	Noleggio ecografo di media fascia per applicazioni in radiologia e multidisciplinari (ex lotto 4 Accordo Quadro)	7790042206	• Esaote spa • Hitachi Medical Systems Italia spa • Siemens Healthcare
3	Ecografo di alta fascia per applicazioni radiologia e multidisciplinari (ex lotto 5 Accordo Quadro)	77900497CB	• Esaote spa • GE Medical Systems Italia spa • Sipar srl
4	Noleggio ecografo di alta fascia per applicazioni in radiologia e multidisciplinari (ex lotto 6 Accordo Quadro)	7790055CBD	• Esaote spa • GE Medical Systems Italia spa • Sipar srl
5	Ecografo di alta fascia per applicazioni in ostetricia/ginecologia (ex lotto 9 Accordo Quadro)	7790058F36	• Esaote spa • Philips Healthcare spa • Siemens Healthcare srl

Atteso che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 21/02/2019 sono pervenute le offerte delle Ditte seguenti:

Ditta	Protocollo
Philips spa	n. 3796 del 20/02/2019
ESAOTE spa	n. 3804 del 20/02/2019
SIEMENS HEALTHCARE srl	n. 3882 del 31/02/2019
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA spa	n. 3889 del 21/02/2019
FUJIFILM ITALIA spa	n. 3894 del 21/02/2019

Preso atto che in data 12/3/2019 si è riunito il seggio di gara per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e per la verifica dei documenti richiesti, come da verbale prot. n. 6070 del 18/3/2019 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Considerato che, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa si è reso necessario attivare il soccorso istruttorio al fine di regolarizzare la documentazione amministrativa per i motivi e con gli esiti di cui al verbale n. 8705 del 19/4/2019 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

Richiamata la deliberazione n. 204 del 30/5/2019 con la quale si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice della gara;

Dato atto che la Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta riservata per lo svolgimento delle pratiche delle apparecchiature oggetto che si sono svolte in data 9/7/2019 presso l'Ospedale Villa Scassi per i lotti 1 e 5 ed in data 11/7/2019 presso l'Ospedale Galliera per i lotti 2, 3 e 4;

Rilevato che la Società FujiFilm Italia spa non si è presentata alla prova pratica degli ecografi relativi al lotto 1 e che, conseguentemente, la Commissione Giudicatrice ha ritenuto di escludere sulla base di quanto previsto dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro;



Preso atto dei verbali dei lavori di valutazione tecnica della Commissione prot. n. 15174 del 10/7/2019 e prot. n. 15316 dell'11/7/2019 allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

Preso altresì atto del verbale della seduta pubblica dell'11/7/2019 di cui al prot. n. 15291 dell'11/7/2019 (Allegato 4) concernente l'apertura delle offerte economiche e l'individuazione dei migliori offerenti, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto con il quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei rilanci competitivi;

Dato atto delle risultanze delle diverse offerte, quali di seguito meglio precisate, a seguito delle quali emerge la proposta di aggiudicazione alle Ditte ed ai prodotti di seguito meglio precisati:

Lotto	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prodotto offerto	Prezzo unitario offerto (euro IVA esclusa)	Q.tà	Importo complessivo (IVA esclusa)
1	Ecografo portatile a supporto di procedure ecodiagnostiche eco-guidate	Esaote spa	Ecografo My Lab Gamma configurazione eco di servizio cod. 101741000	€ 13.450,00	3	€ 40.350,00
			Licenza cardio cod. 301007500	€ 700,00	1	700,00
			Sonda cardiologica adulti cod. 301007500	€ 2.200,00	1	€ 2.200,00
2	Noleggio ecografo di media fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinari	Esaote spa	Ecografo MyLab Seven cod. 101640000	€ 24.800,00	1	€ 24.800,00
			Modulo cardiologico	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00
			Sonda cardiologica adulti	€ 2.500,00	1	€ 2.500,00
3	Ecografo di alta fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinari	GE Medical Systems Italia spa	Ecografo Logiq S8 Xdclear cod. H4272LP	€ 27.000,00	4	€ 108.000,00
			Modulo Fusion Imaging cod. NL01	€ 5.000,00	1	€ 5.000,00
			Modulo Cardiologia cod. NL03	€ 1.575,00	1	€ 1.575,00
			Sonda cardiologica adulti cod. H48681AZ	€ 1.500,00	2	€ 3.000,00
			Sonda cardiologica pediatrica cod. H45021RR	€ 1.500,00	1	€ 1.500,00
			Sonda convex pediatrica cod. H46342LA	€ 1.500,00	1	€ 1.500,00
			Sonda lineare frequenza 10 MHz cod. H48062AA	€ 1.500,00	1	€ 1.500,00
			Kit biopsia sonda convex cod. H4913BB	€ 380,00	1	€ 380,00
4	Noleggio ecografo di alta fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinari	GE Medical Systems Italia spa	Ecografo Logiq S8 Xdclear cod. H46472LP	€ 34.022,00	3	€ 102.066,00
			Modulo elasto Shear Wave cod. H46482LA	€ 4.692,00	3	€ 14.076,00
			Modulo fusion imaging cod. NL01	€ 5.866,00	2	€ 11.732,00
			Sonda lineare 15 MHz cod. H40452LG	€ 1.759,00	2	€ 3.518,00
5	Ecografo di alta fascia per applicazioni in ginecologia e ostetricia	Philips spa	Ecografo Affinity 70	€ 58.000,00	2	€ 116.000,00
			Kit biopsia sonda C9-2 cod. FUS8826	€ 490,00	1	€ 490,00

Dato atto che tutti i verbali citati vengono integralmente allegati in copia alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte sostanziale;

Rilevato che non esistono per la fornitura in oggetto convenzioni nazionali CONSIP sovrapponibili alla presente procedura;

Ritenuto di procedere alla aggiudicazione dei rilanci competitivi, in conformità ai verbali allegati alla presente determinazione;

Su proposta del Dirigente responsabile,

DETERMINA

- Di approvare i verbali di gara allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto come in premessa specificato, relativi all'aggiudicazione dei rilanci competitivi per finalizzati all'affidamento, in attuazione dell'Accordo Quadro aggiudicato con Determinazione n. 197 del 18/7/2016, De-terminazione n. 45 del 17/11/2016 e Determinazione n. 67 del 21.2.2017, della fornitura di eco-grafi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti alla ASL n. 3 Genovese, alla ASL n. 5 Spezzina, all'E.O. Ospedali Galliera e all'Ospedale Policlinico San Martino IRCCS

- Di procedere alla aggiudicazione dei rilanci competitivi secondo lo schema seguente:

Lotto	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prodotto offerto	Prezzo unitario offerto (euro IVA esclusa)	Q.tà	Importo complessivo (IVA esclusa)
1	Ecografo portatile a supporto di procedure ecodiagnostiche eco-guidate	Esaote spa	Ecografo My Lab Gamma configurazione eco di servizio cod. 101741000	€ 13.450,00	3	€ 40.350,00
			Licenza cardio cod. 301007500	€ 700,00	1	700,00
			Sonda cardiologica adulti cod. 301007500	€ 2.200,00	1	€ 2.200,00
2	Noleggio ecografo di media fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinari	Esaote spa	Ecografo MyLab Seven cod. 101640000	€ 24.800,00	1	€ 24.800,00
			Modulo cardiologico	€ 1.000,00	1	€ 1.000,00
			Sonda cardiologica adulti	€ 2.500,00	1	€ 2.500,00
3	Ecografo di alta fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinari	GE Medical Systems Italia spa	Ecografo Logiq S8 Xdclear cod. H4272LP	€ 27.000,00	4	€ 108.000,00
			Modulo Fusion Imaging cod. NL01	€ 5.000,00	1	€ 5.000,00
			Modulo Cardiologia cod. NL03	€ 1.575,00	1	€ 1.575,00
			Sonda cardiologica adulti cod. H48681AZ	€ 1.500,00	2	€ 3.000,00
			Sonda cardiologica pediatrica cod. H45021RR	€ 1.500,00	1	€ 1.500,00
			Sonda convex pediatrica cod. H46342LA	€ 1.500,00	1	€ 1.500,00
			Sonda lineare frequenza 10 MHz cod. H48062AA	€ 1.500,00	1	€ 1.500,00
			Kit biopsia sonda convex cod. H4913BB	€ 380,00	1	€ 380,00
			Ecografo Logiq S8 Xdclear cod. H46472LP	€ 34.022,00	3	€ 102.066,00
4	Noleggio ecografo di alta fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinari	GE Medical Systems Italia spa	Modulo elasto Shear Wave cod. H46482LA	€ 4.692,00	3	€ 14.076,00
			Modulo fusion imaging cod. NL01	€ 5.866,00	2	€ 11.732,00
			Sonda lineare 15 MHz cod. H40452LG	€ 1.759,00	2	€ 3.518,00
			Ecografo Affinity 70	€ 58.000,00	2	€ 116.000,00
5	Ecografo di alta fascia per applicazioni in ginecologia e ostetricia	Philips spa	Kit biopsia sonda C9-2 cod. FUS8826	€ 490,00	1	€ 490,00

- Di dare atto che:

- I controlli previsti dalla normativa vigente sugli aggiudicatari sono già stati espletati dalla Centrale di Acquisto in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- Agli appalti specifici affidati sulla base di un accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 11 D. Lgs. n. 163/2006
- L'importo della garanzia fideiussoria da prestare da parte dell'aggiudicatario è determinata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 nella misura del 10% dell'importo dell'appalto specifico affidato;

- Di provvedere alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;

- Di disporre, la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara:
 - Servizio appalti Regione Liguria
 - Sito Web Aziendale.

4

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi ed è composto da n. 5 (con-
que) pagine oltre gli allegati.

IL DIRETTORE
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)



Allegati:

- Verbale apertura documentazione amministrativa (prot. n. 6070 del 18/3/2019)
- Verbale seduta riservata Seggio di Gara valutazione documentazione amministrativa (prot. n. 8705 del 19/4/2019)
- *Verballi lavori Commissione Giudicatrice:*
 - *II seduta del 9/7/2019 (prova pratica apparecchiature lotti 1 e 5) verbale prot. n. 15174 del 10/7/2019
 - *III seduta del 11/7/2019 (prova pratica apparecchiature lotti 2, 3 e 4) – verbale prot. n. 15316 dell'11/7/2019
- Verbale apertura offerte economiche – 11/7/2019 (prot. n. 15291 dell'11/7/2019)



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Tiziana Tazzoli - tel. 010/548-8553
e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

Procedura n. 7334365 – Rilancio competitivo tramite procedura negoziata ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento degli appalti specifici relativi all'Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59 D. lgs. n. 163/2006 per la fornitura di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria. Lotti n. 5.

Verbale di apertura buste afferenti la documentazione amministrativa

Il giorno 12/03/2019 alle ore 12:00, presso la Sala riunioni dell'Area Centrale Regionale di Acquisto in via D'Annunzio 64, 16121 Genova, si è riunito il Seggio di gara della procedura in oggetto, per la verifica della sussistenza della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti. Sono presenti:

- Dr. Luigi Moreno Costa - Dirigente della Centrale - Presidente
- Dr.ssa Tiziana Tazzoli - Collaboratore amm.vo prof.le della Centrale – Componente Segretario

L'Ufficiale rogante di A.Li.Sa., Area Centrale Regionale d'Acquisto, è presente nella persona del dott. Mauro Vestri

In rappresentanza delle Ditte partecipanti sono presenti i Signori:

Nominativo	Ditta
Sig. Goffredo Pinazzi	Esaote spa
Sig. Paolo Barboni	Phillips spa

muniti delle necessarie procure (presentate in copia o in originale) che verranno allegate quali parti integranti e sostanziali del presente verbale in caso di dichiarazioni rese a verbale.

Il Seggio di gara dà preliminarmente atto che:

- con determinazione **n. 44 del 7/2/2019** si è provveduto all'indizione della procedura in oggetto ed all'approvazione della lettera di invito e delle norme di partecipazione;
- Il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 12,00 del giorno 21/2/2019;

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563
MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Il Presidente del Seggio di gara rileva che entro il termine sopra indicato sono pervenute le offerte delle Ditte invitate: 2 di 3

Ditta	Protocollo
Philips spa	n. 3796 del 20/02/2019
ESAOTE spa	n. 3804 del 20/02/2019
SIEMENS HEALTHCARE srl	n. 3882 del 31/02/2019
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA spa	n. 3889 del 21/02/2019
FUJIFILM ITALIA spa	n. 3894 del 21/02/2019

Nella lettera di invito veniva richiesta la seguente documentazione amministrativa:

- l'istanza di partecipazione alla procedura negoziata, come da modello allegato (Allegato B1).
- DGUE** (da allegare all'istanza di partecipazione) aggiornato compilato e sottoscritto dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000;
- Attestazione** comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto	Codice CIG	Importo lotto stimato (esclusa IVA)	Importo contributo (espresso in Euro)
1	7789843DCA	€ 54.000,00	Non dovuto
2	7790042206	€ 42.000,00	Non dovuto
3	77900497CB	€ 368.544,00	35,00 €
4	7790055CBD	€ 405.000,00	35,00 €
5	7790058F36	€ 134.000,00	Non dovuto

- Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico;
- CD-ROM** (non riscrivibile) contenente tutta la documentazione di cui sopra salvata in formato PDF,

Il Presidente invita i presenti a verificare l'integrità dei plichi, dando altresì atto che sono stati custoditi presso la CRA, in armadio identificato e munito di serratura.

Il Presidente procede quindi all'apertura dei plichi separando le buste contenenti l'offerta economica dalle buste contenenti la documentazione amministrativa. Dopodiché si procede all'apertura delle buste recanti la documentazione amministrativa per la verifica del contenuto.

La verifica della sussistenza della documentazione amministrativa ha stabilito che la stessa è stata regolarmente presentata per tutti i sopraindicati offerenti.

[Handwritten signature]

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Il Seggio di Gara, esaminando la documentazione amministrativa prodotta, rileva quanto segue: ^{3 di 3}

- In relazione alla Ditta Philips spa risulta necessario richiedere chiarimenti in merito alle informazioni inserite alla Sezione C del DGUE;
- In relazione alla Ditta FujiFilm Italia spa risulta necessario richiedere chiarimento in merito alle informazioni inserite alla Sezione C del DGUE;
- In relazione alla Ditta Siemens HealthCare Italia srl risulta necessario richiedere l'integrazione delle informazioni relative ai fatturati di cui alla sezione B del DGUE
- In relazione alla Ditta Esaote spa risulta necessario richiedere una precisazione relativamente alle informazioni relative ai fatturati di cui alla sezione B del DGUE

La CRA procederà, quindi, a richiedere alle Ditte interessate i chiarimenti sopra evidenziati.

Le buste contenenti le offerte economiche vengono raccolte in un plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura dal Presidente del Seggio di Gara, dall'Ufficiale Rogante e dai rappresentanti delle Ditte presenti.

Il plico sarà riposto per la conservazione in armadio con serratura collocato in luogo chiuso.



La seduta è tolta alle ore 13:00

Letto, confermato e sottoscritto.

- **Presidente:**
Dott. Luigi Moreno Costa

- **Componente Segretario**
Dott.ssa Tiziana Tazzoli

- **L'Ufficiale Rogante:**
Dott. Mauro Vestri

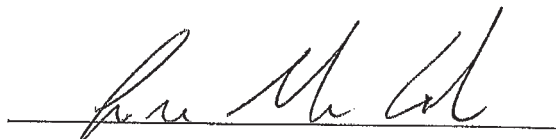



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa- tel.010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Tiziana Tazzoli- tel. 010/548-8553
e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

Procedura n. 7334365 – Rilancio competitivo tramite procedura negoziata ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento degli appalti specifici relativi all'Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59 D. lgs. n. 163/2006 per la fornitura di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria. Lotti n. 5.

Verbale seduta riservata Seggio di Gara

Il giorno 19/4/2019 alle ore 10:00, presso la Sala riunioni dell'Area Centrale Regionale di Acquisto in via D'Annunzio 64, 16121 Genova, si è riunito il Seggio di gara della procedura in oggetto, per il riscontro alle richieste di integrazioni documentali formulate alle Ditte Esaote spa, Philips spa, FujiFilm Italia spa e Siemens Healthcare srl a seguito della documentazione amministrativa presentata dalle medesime ditte concorrenti. Sono presenti:

- Dr. Luigi Moreno Costa - Dirigente della Centrale - Presidente
- Dr.ssa Tiziana Tazzoli - Collaboratore amm.vo prof.le della Centrale – Componente Segretario
- Dott. Mauro Vestri – Collaboratore amm.vo prof.le della Centrale in qualità di ufficiale rogante.

Il presidente da atto che con note prot. n. 6199, 6200, 6201 e 6202 del 19/3/2019 i competenti uffici di CRA hanno provveduto a richiedere quanto segue:

- alla Ditta Philips spa chiarimenti in merito alle informazioni inserite alla Sezione C del DGUE;
- alla Ditta FujiFilm Italia spa chiarimenti in merito alle informazioni inserite alla Sezione C del DGUE;
- alla Ditta Siemens HealthCare Italia srl integrazione delle informazioni relative ai fatturati di cui alla sezione B del DGUE
- Ditta Esaote spa precisazione relativamente alle informazioni relative ai fatturati di cui alla sezione B del DGUE

entro il termine delle ore 14:00 del 29/3/2019.

Si da atto che le Società Esaote spa (nota prot. n. 6536 del 25/3/2019), Philips spa (nota prot. n. 6979 del 29/3/2019), FujiFilm Italia spa (nota prot. n. 6331 del 21/3/2019) hanno riscontrato la richiesta di chiarimenti/integrazioni entro il termine assegnato mentre la Società Siemens ha

M
m.m

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

comunicato di non aver preso conoscenza della nota e, pertanto, ha risposto alla richiesta di integrazione dati in data 18/04/2019 (prot. n. 8678 del 19/04/2019) a seguito di sollecito. ^{2 di 2}

Il Seggio di Gara, esaminato il contenuto delle comunicazione come sopra indicate ha ritenuto quanto segue:

- Società Esaote spa: dati indicati nella sezione B del DGUE conformi
- Società Philips spa: trattasi di vicenda oggetto di contenzioso in atto non ancora definito comunque non configurabile quale grave illecito professionale ex art. 80 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016 e peraltro riferita a ramo di attività non coincidente con quello oggetto di gara;
- Società FujiFilm Italia spa. trattasi di vicenda risalente al 2010 ancora pendente e, pertanto, non configurabile quale causa di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2019

Relativamente alla Società Siemens Healthcare srl, il Seggio di gara considerato che:

- i requisiti di idoneità economico-finanziaria erano già stati valutati in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro in attuazione del quale è espletato il presente rilancio competitivo
- la Società, a seguito di sollecito, ha provveduto all'integrazione richiesta precisando di non aver avuto contezza della comunicazione di cui al prot. n. 6199 del 19/3/2019
- i dati di fatturato globale e specifico riferiti agli anni 2017 e 2018 risultano notevolmente sovrabondanti rispetto agli importi dei lotti oggetto del rilancio confermando la sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria già verificati in sede di Accordo Quadro

Tutto quanto sopra premesso, il Seggio di Gara ammette le società:


- Esaote spa
- Philips spa
- FujiFilm Italia spa
- Siemens Healthcare srl

prosegue della presente procedura di gara ritenendo conforme la documentazione amministrativa prodotta.

La seduta è tolta alle ore 11:00

Letto, confermato e sottoscritto.

- **Presidente :**
Dott. Luigi Moreno Costa
- **Componente Segretario**
Dott.ssa Tiziana Tazzoli
- **L'Ufficiale Rogante:**
Dott. Mauro Vestri

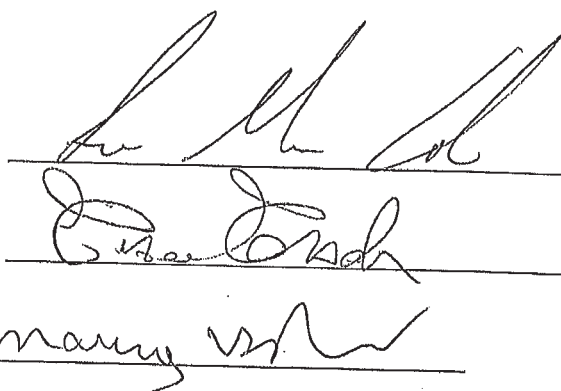



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Prot. n. 15874 del 10/07/2019

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel. 010/548-8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dr.ssa Tiziana TAZZOLI - tel. 010/548-8553
e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

Procedura ristretta negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 59 – D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento di un Appalto Specifico in attuazione dell'Accordo Quadro aggiudicato con Determinazione n. 197 del 18/07/2016 (lotti 1 e 2), n. 45 del 17/11/2016 (lotti 3, 4, 5, 6) e n. 67 del 21/02/2017 (lotti 7, 8, 9, 10, 11, 12) relativo alla fornitura in acquisto di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche richiesti da ASL 2, ASL 3, ASL 5, E.O. Ospedali Galliera e Ospedale Policlinico San Martino – LOTTI 5 – n. gara 7334365

Fase di valutazione delle offerte tecniche Esecuzione delle prove pratiche lotti 1 e 5 – 09/07/2019

Il giorno 09/07/2019, alle ore 08:40 presso la S.S.D. Ostetricia e Diagnostica Prenatale – Padiglione 7 – Ospedale Villa Scassi in Genova, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con Determinazione n. 204 del 30/05/2019, per l'effettuazione della prova pratica delle apparecchiature offerte relativamente ai lotti 1 e 5 della presente procedura.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice:

cognome e nome	struttura di appartenenza ed incarico	
Dott. Ennio BISCALDI	Dirigente Medico S.C. Radiodiagnostica E.O. Ospedali Galliera	in qualità di Presidente
Dr.ssa Enrica CAVIGLIA	Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione ASL 3	in qualità di Componente
Dott. Maurizio PODESTA'	Responsabile S.S. Ostetricia Ospedale Villa Scassi ASL 3	in qualità di Componente

Per la Centrale Regionale di Acquisto è presente la Sig.ra Bruna RICCI - Collaboratore amministrativo della Centrale - che svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante, in sostituzione della Dr.ssa Tiziana TAZZOLI.

Sono presenti, per le ditte partecipanti, i signori:

ditta	Nominativo
ESAOTE spa	Goffredo Pinazzi Mauro Leoncini Marco Gazzo
PHILIPS HEALTHCARE spa	Luigi Gatti Giuliano Farina Paolo Barboni
SIEMENS HEALTHCARE srl	Fabio Monteverde

Nel corso della riunione odierna la Commissione procederà ad effettuare le prove pratiche, come previsto ai paragrafi 10.2 e 11.1 del Disciplinare di gara dell'Accordo Quadro e specificato al punto 4.2 della lettera di invito prot. n. 2849 dell'08/02/2019, relativamente ai seguenti lotti:

LOTTO 1	
ditta	apparecchiatura
ESAOTE spa	ecografo My Lab Gamma
FUJIFILM ITALIA spa	ecografo Sonosite M-Turbo

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563

[Handwritten signatures and initials]



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

La Commissione prende atto che – con nota acquisita agli atti della Centrale con prot. n. 14631 del 04/07/2019 – FujiFilm Italia spa ha comunicato la propria impossibilità a partecipare alla prova pratica e, poiché tale prova è espressamente prevista, **pena esclusione**, al punto 4.2 della sopracitata lettera d'invito, dispone l'esclusione della Ditta FujiFilm Italia spa dal lotto 1.

LOTTO 5	
ditta	apparecchiatura
ESAOTE spa	ecografo My Lab Class C e HD
PHILIPS HEALTHCARE spa	ecografo Affiniti 70
SIEMENS HEALTHCARE srl	ecografo Acuson S2000

La Commissione assegnerà alle apparecchiature esaminate i punteggi di qualità (previsti – per la prova pratica – in max. 20 punti per entrambi i lotti) con i criteri di cui al punto 4.2 "Prova pratica" della lettera di invito. I punteggi espressi dai singoli Commissari saranno riportati su apposite schede individuali nominative allo scopo predisposte che verranno compilate manualmente da ciascun commissario ed allegate al presente verbale.

La prova si svolgerà su di un modello per il lotto 1, mentre per il lotto 5 le prove si svolgeranno su pazienti, individuate dalla Commissione Giudicatrice, di cui due gravide e una paziente ginecologica per la visione di tutte e tre le apparecchiature in gara in modo da garantire la parità di trattamento.

Si procede, pertanto, con lo svolgimento delle prove pratiche, nel seguente ordine, previa verifica – per ciascuna ditta - della corrispondenza fra l'apparecchiatura dichiarata in offerta e quella presentata per l'esecuzione della prova:

- 1) ESAOTE spa – lotto 1 (inizio prova ore 8:50 - fine prova ore 9:40)
- 2) ESAOTE spa – lotto 5 (inizio prova ore 9:50 - fine prova ore 10:35)
- 3) SIEMENS HEALTHCARE srl – lotto 5 (inizio prova ore 10:45 - fine prova ore 11:25)
- 4) PHILIPS HEALTHCARE spa – lotto 5 (inizio prova ore 11:35 - fine prova ore 12:20)

La Commissione dà atto che relativamente al lotto 5 il parametro c.2 (mezzo di contrasto) la commissione effettua una valutazione di tipo cartolare e basata sulle informazioni raccolte dalla Commissione nel corso della prova, dal momento che in prova non è stato possibile verificare l'utilizzo dei mezzi di contrasto. Relativamente al parametro c.7 (elastasonografia) la Commissione non ha potuto effettuare alcuna valutazione in quanto nessuna delle Ditte concorrenti ha esibito ha fornito elementi valutativi a dimostrazione di tale tecnologia. Pertanto, la Commissione al fine di non penalizzazione i concorrenti ritiene di assegnare una valutazione di pari valore relativamente al parametro considerato.

Al termine delle prove, i rappresentanti delle ditte dichiarano di non aver nulla da eccepire circa lo svolgimento delle stesse e vengono pertanto congedati.

Le prove hanno termine alle ore 12:20.

La Commissione Giudicatrice, sulla base delle prove pratiche effettuate, procede pertanto alla valutazione tecnica ed all'attribuzione del punteggio qualitativo, con le modalità precedentemente descritte. Gli esiti della valutazione sono riportati nelle schede allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

I lavori della Commissione Giudicatrice hanno termine alle ore 13:00.

Il presente verbale consta di complessive 2 (due) pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice:

Il Presidente: Dott. Ennio BISCALDI


A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

I Componenti: Dr.ssa Enrica CAVIGLIA

Dott. Maurizio PODESTA'

La segretaria verbalizzante: Sig.ra Bruna RICCI

C. Ricci
M. Podesta'
B. Ricci



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Prot. n. 15316 dell'11/4/2019

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel. 010/548-8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dr.ssa Tiziana TAZZOLI - tel. 010/548-8553
e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

Procedura ristretta negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 59 - D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento di un Appalto Specifico in attuazione dell'Accordo Quadro aggiudicato con Determinazione n. 197 del 18/07/2016 (lotti 1 e 2), n. 45 del 17/11/2016 (lotti 3, 4, 5, 6) e n. 67 del 21/02/2017 (lotti 7, 8, 9, 10, 11, 12) relativo alla fornitura in acquisto di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche richiesti da ASL 2, ASL 3, ASL 5, E.O. Ospedali Galliera e Ospedale Policlinico San Martino - LOTTI 2, 3 E 4 - n. gara 7334365

Fase di valutazione delle offerte tecniche

Esecuzione delle prove pratiche lotti 2, 3 e 4-11/07/2019

Il giorno 11/07/2019, alle ore 8:30 presso L'E.O. Ospedali Galliera, Padiglione B, Radiologia Diagnostica si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con Determinazione n. 204 del 30/05/2019, per l'effettuazione della prova pratica delle apparecchiature offerte relativamente ai lotti 1 e 5 della presente procedura.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice:

cognome e nome	struttura di appartenenza ed incarico	
Dott. Ennio BISCALDI	Dirigente Medico S.C. Radiodiagnostica E.O. Ospedali Galliera	in qualità di Presidente
Dr.ssa Enrica CAVIGLIA	Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione ASL 3	in qualità di Componente
Dott. Maurizio PODESTA'	Responsabile S.S. Ostetricia Ospedale Villa Scassi ASL 3	in qualità di Componente

Per la Centrale Regionale di Acquisto è presente la Dott.ssa Tiziana Tazzoli - Collaboratore amministrativo della Centrale - che svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante, in sostituzione della Dr.ssa Tiziana TAZZOLI.

Sono presenti, per le ditte partecipanti, i signori:

ditta	Nominativo
ESAOTE spa	Sig. Goffredo Pinazzi Sig. Domenico Ruello
GE Medical Systems Italia spa	Sig. Antonio Amaro Sig. Diego Balconi
SIEMENS HEALTHCARE srl	Sig. Fabio Monteverdi

Nel corso della riunione odierna la Commissione procederà ad effettuare le prove pratiche, come previsto ai paragrafi 10.2 e 11.1 del Disciplinare di gara dell'Accordo Quadro e specificato al punto 4.2 della lettera di invito prot. n. 2849 dell'08/02/2019, relativamente ai seguenti lotti 2, 3, 4.

La Commissione Giudicatrice procede a visionare gli ecografi di Esaote spa e Siemens Healthcare srl per il lotto 2 in quanto la Ditta Hitachi ha comunicato di non partecipare al rilancio competitivo. Mentre per i lotti 3 e

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

[Handwritten signatures and initials]

4 vengono visionate le apparecchiature delle Ditte Esaote spa e GE Medical Italia spa in quanto la Ditta Sipar srl ha comunicato di non partecipare al confronto competitivo.

La Commissione assegnerà alle apparecchiature esaminate i punteggi di qualità (previsti – per la prova pratica – in max. 20 punti per entrambi i lotti) con i criteri di cui al punto 4.2 “Prova pratica” della lettera di invito. I punteggi espressi dai singoli Commissari saranno riportati su apposite schede allo scopo predisposte, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

La prova viene effettuata su due modelli individuati dalla Commissione Giudicatrice (un soggetto di sesso maschile ed un soggetto di sesso femminile) assegnati entrambi a ciascuna prova degli ecografi in gara in modo da assicurare la parità di trattamento.

Si procede, pertanto, con lo svolgimento delle prove pratiche previa verifica – per ciascuna ditta - della corrispondenza fra l'apparecchiatura dichiarata in offerta e quella presentata.

La Commissione procede dapprima a visionare le apparecchiature del Lotto 2. L'ordine di priorità è determinato in base al sorteggio effettuato dal Sig. Monteverdi della Ditta Siemens Healthcare srl.

Viene estratta la Ditta Siemens Healthcare che, pertanto, inizia la prima. Seguirà la Ditta Esaote spa.

La prova inizia quindi alle ore 9:00 e termina alle ore 9:30.

Terminata la prova viene quindi esaminata l'apparecchiatura della Ditta Esaote spa. La prova inizia alle ore 9:35 e termina alle ore 10:00.

Si precisa che per quanto riguarda il criterio c.2 (qualità enhancement dell'ago) la Commissione procede, per entrambi gli ecografi visionati, con una simulazione utilizzando un ago da biopsia per effettuare una valutazione senza manovra invasiva sul modello.

Terminate le prove del lotto 2 la Commissione si ritira per le valutazioni in seduta riservata.


Alle ore 10:25 la Commissione riprende i lavori dai lotti 3 e 4. Poiché le apparecchiature offerte dai due competitors in gara (Esaote spa e GE Medical Systems Italia spa) sono identiche – ecografo MyLABClass C eHD per Esaote spa e Logiq S8 per GE Medical Italia spa - per i due lotti, la Commissione procederà ad un'unica prova per entrambi i lotti tenuto conto che, relativamente al lotto 4, è previsto un parametro di valutazione aggiuntivo relativo al Modulo Fusion che non è previsto per il lotto 3.

La prova inizia alle ore 10:30. Poiché la Ditta Esaote non ha a disposizione una clip registrata in merito all'utilizzo dei mezzi di contrasto ed al modulo fusion la Commissione sospende le prove alle ore 11:00 per consentire allo specialist della Ditta di recuperare due clip registrate da far visionare alla Commissione Giudicatrice. Nel frattempo la Commissione procederà con la visione dell'ecografo di GE Medical Systems Italia spa, che inizia alle ore 11:02. Per la valutazione del modulo Fusion la Ditta GE Medical Systems Italia spa ha preparato una prova su fantoccio. Per quanto riguarda la valutazione dei mezzi di contrasto GE Medical Systems Italia spa ha preparato una clip registrata in modo da consentire la visualizzazione alla Commissione Giudicatrice.

La prova termina alle ore 11:30.

Alle ore 11:32 la Commissione riprende la valutazione dell'ecografo della Ditta Esaote spa che non è in grado di esibire alcuna demo in merito sia all'utilizzo dei mezzi di contrasto sia al modulo Fusion. In particolare, in relazione al modulo Fusion non sono stati portati dalla Ditta gli strumenti per la Virtual Navigation per cui anche potendo reperire immagini TAC/RMN non si sarebbe potuto procedere alla prova. La Ditta Esaote spa afferma che nella convocazione ricevuta per la prova pratica non era stato richiesto che l'ecografo dovesse essere preparato per la valutazione di questi due parametri, tale rilievo non è accoglibile perché sia nella lettera di invito sia nel disciplinare di gara dell'Accordo Quadro sono specificati i parametri di valutazione valutati in prova pratica, né d'altra parte nella convocazione era precisato alcunché sulle modalità di svolgimento né tanto meno che si sarebbero

La prova termina alle ore 11:40

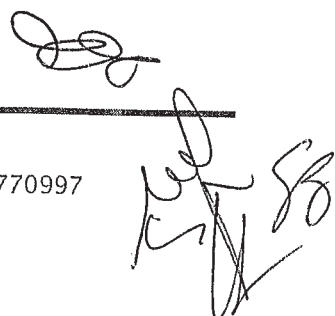



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

La Commissione Giudicatrice, terminata la prova pratica si ritira in seduta riservata per valutare, sulla base delle prove pratiche effettuate, ed attribuire il punteggio qualitativo, con le modalità precedentemente descritte. Gli esiti della valutazione sono riportati nelle schede allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

I lavori della Commissione Giudicatrice hanno termine alle ore 12:00.

Il presente verbale consta di complessive 3 (tre) pagine oltre le schede allegate.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice:

Il Presidente: Dott. Ennio BISCALDI

I Componenti: Dr.ssa Enrica CAVIGLIA

Dott. Maurizio PODESTA'

La segretaria verbalizzante: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI

[Handwritten signatures of the Commission members and secretary]



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Prot. n. 15231 del 12/07/2019

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel. 010/548-8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dr.ssa Tiziana TAZZOLI - tel. 010/548-8553
e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

Procedura ristretta negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 59 – D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento di un Appalto Specifico in attuazione dell'Accordo Quadro aggiudicato con Determinazione n. 197 del 18/07/2016 (lotti 1 e 2), n. 45 del 17/11/2016 (lotti 3, 4, 5, 6) e n. 67 del 21/02/2017 (lotti 7, 8, 9, 10, 11, 12) relativo alla fornitura in acquisto di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche richiesti da ASL 2, ASL 3, ASL 5, E.O. Ospedali Galliera e Ospedale Policlinico San Martino – LOTTI 5 – n. gara 7334365

Seduta pubblica apertura offerte economiche

Il giorno 11/7/2019, alle ore 14:30 presso la sede CRA in Via G. D'Annunzio n. 64 in Genova, al secondo piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con Determinazione n. 204 del 30/05/2019, per l'apertura delle offerte economiche dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 della procedura in oggetto.

Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice:

cognome e nome	struttura di appartenenza ed incarico	
Dott. Ennio BISCALDI	Dirigente Medico S.C. Radiodiagnostica E.O. Ospedali Galliera	in qualità di Presidente
Dr.ssa Enrica CAVIGLIA	Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione ASL 3	in qualità di Componente
Dott. Maurizio PODESTA'	Responsabile S.S. Ostetricia Ospedale Villa Scassi ASL 3	in qualità di Componente

Per la Centrale Regionale di Acquisto è presente la Dott.ssa Tiziana Tazzoli, Segretario, il Dott. Giorgio Sacco in sostituzione del Dott. Costa che non è potuto essere presente ed il Dott. Attilio Profumo quale Ufficiale Rogante.

Sono presenti, per le ditte partecipanti, i signori:

ditta	Nominativo
ESAOTE spa	Goffredo Pinazzi
PHILIPS HEALTHCARE spa	Paolo Barboni
SIEMENS HEALTHCARE srl	Fabio Monteverde
Ge Medical Systems Italia spa	Sig. Antonio Amaro

Il Segretario invita i rappresentanti presenti a verificare la sigillatura del plico contenente le offerte economiche. I presenti confermano la sigillatura del plico.

La Commissione Giudicatrice procede a comunicare i punteggi tecnici assegnati ai vari lotti nel corso delle prove pratiche svoltesi nelle giornate del 9 e dell'11 luglio 2019.

Effettuata la lettura, il Segretario, assistito dall'ufficiale Rogante, procede ad aprire le offerte economiche lotto per lotto. L'offerta economica presentata dalla Ditta FujiFilm Italia spa per il lotto 1 non viene aperta in quanto esclusa dalla procedura.

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

[Handwritten signatures and initials]



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

In relazione al lotto 3 la Commissione sospende la seduta per circa 10 minuti per verificare un'incongruenza relativa alla modulistica per le offerte economiche, invitando i presenti ad uscire.

La Commissione evidenzia che nella scheda di attribuzione del punteggio tecnico ed in quella relativa al calcolo del punteggio economico del lotto 3 non era stato inserito per mero errore materiale l'elemento relativo al modulo Fusion. Considerato che le apparecchiature presentate per i lotti 3 e 4 sono identiche il punteggio assegnato dalla Commissione per i due lotti è identico.

Si procede pertanto a riprendere la seduta pubblica aprendo le offerte economiche relative al lotto 3.

Le offerte economiche relative ai lotti 1, 2, 3 e 4 vengono allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale unitamente alle schede riepilogative dei punteggi tecnici ed economici predisposti dalla CRA e sottoscritti dai Commissari.

Alla luce delle risultanze come documentate dalle schede e dalle offerte allegate risulta la proposta di aggiudicazione relativamente a:

Lotto 1 Esaote spa

Lotto 2 Esaote spa

Lotto 3 GE Medical Systems Italia spa

Lotto 4 GE Medical Systems Italia spa

Lotto 5 Philips spa

LA seduta pubblica è tolta alle ore 15:35

Il presente verbale consta di complessive 2 (due) pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice:

Il Presidente: Dott. Ennio BISCALDI

I Componenti: Dr.ssa Enrica CAVIGLIA

Dott. Maurizio PODESTA'

Dott. Giorgio SACCO

L'Ufficiale Rogante Dott. Attilio PROFUMO

La segretaria verbalizzante: Dott.ssa Tiziana Tazzoli

All.ti

Offerte economiche e schede valutazione tecnica ed economica

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA PRATICA ECOGRAFI 9/11/2019

DOTT. ENNIO BISCALDI

LOTTO 1 – ECOGRAFO PORTATILE DI SERVIZIO A SUPPORTO DI PROCEDURE DIAGNOSTICHE ECO-GUIDATE

Parametro C.1 Qualità imaging 2D con particolare riferimento ai vasi del collo e periferici Punti 8

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0,3	adeguato alla ref clinica.
FUJIFIL ITALIA SRL		

Parametro C.2 Sistema di enhancement dell'immagine dell'ago Punti 2

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0,7	valido modo del software usato.
FUJIFIL ITALIA SRL		

Parametro C.3 Color doppler, doppler con particolare riferimento ai vasi del collo e periferici Punti 4

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0,5	buona visualizzazione doppler colore, qualità rispettata
FUJIFIL ITALIA SRL		

Ennio Biscaldi

Parametro C.4 Sonde lineari Punti 2

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0,3	qualità 2D valida e adeguata per esercizio portatile
FUJIFIL ITALIA SRL		

Parametro C.5 Sonde convex Punti 2

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0,3	funzione adeguata alle tipologie di esercizio e all'uso clinico.
FUJIFIL ITALIA SRL		

Parametro C.6.1 Facilità di pulizia/disinfezione Punti 1

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0,5	semplice pulizia efficace ergonomica.
FUJIFIL ITALIA SRL		

Parametro C.6.2 Velocità di passaggio tra modalità diverse Punti 1

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0,7	Efficiente e semplice.
FUJIFIL ITALIA SRL		

gilli

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA PRATICA ECOGRAFI 9/11/2019

DOTT. MAURIZIO PODESTA'

LOTTO 1 – ECOGRAFO PORTATILE DI SERVIZIO A SUPPORTO DI PROCEDURE DIAGNOSTICHE ECO-GUIDATE

Parametro C.1 Qualità imaging 2D con particolare riferimento ai vasi del collo e periferici Punti 8

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0.5	Adeguate qualità di imaging con buona risoluzione
FUJIFIL ITALIA SRL		

Parametro C.2 Sistema di enhancement dell'immagine dell'ago Punti 2

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0.3	Discreto enhancement in movimento
FUJIFIL ITALIA SRL		

Parametro C.3 Color doppler, doppler con particolare riferimento ai vasi del collo e periferici Punti 4

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0.4	Adeguate sensibilità dei canali color
FUJIFIL ITALIA SRL		



Parametro C.4 Sonde lineari Punti 2

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0.5	Good imaging
FUJIFIL ITALIA SRL		

Parametro C.5 Sonde convex Punti 2

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0.5	Good imaging
FUJIFIL ITALIA SRL		

Parametro C.6.1 Facilità di pulizia/disinfezione Punti 1

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0.7	Agile disinfection
FUJIFIL ITALIA SRL		

Parametro C.6.2 Velocità di passaggio tra modalità diverse Punti 1

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0.3	Simple occhio
FUJIFIL ITALIA SRL		

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA PRATICA ECOGRAFI 9/11/2019

DOTT.SSA ENRICA CAVIGLIA

LOTTO 1 – ECOGRAFO PORTATILE DI SERVIZIO A SUPPORTO DI PROCEDURE DIAGNOSTICHE ECO-GUIDATE

Parametro C.1 Qualità imaging 2D con particolare riferimento ai vasi del collo e periferici Punti 8

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0.6	Buona visualizzazione delle strutture esplorate
FUJIFIL ITALIA SRL		

Parametro C.2 Sistema di enhancement dell'immagine dell'ago Punti 2

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0.5	Buona visualizzazione del cat. puntatura
FUJIFIL ITALIA SRL		

Parametro C.3 Color doppler, doppler con particolare riferimento ai vasi del collo e periferici Punti 4

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0.4	Discreta immagine doppler
FUJIFIL ITALIA SRL		

C/8

Parametro C.4 Sonde lineari Punti 2

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0.4	Buona immagine
FUJIFIL ITALIA SRL		

Parametro C.5 Sonde convex Punti 2

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0.4	Buona immagine
FUJIFIL ITALIA SRL		

Parametro C.6.1 Facilità di pulizia/disinfezione Punti 1

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0.5	Agevole pulizia apparec. e sonde
FUJIFIL ITALIA SRL		

Parametro C.6.2 Velocità di passaggio tra modalità diverse Punti 1

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE	0.7	Ottima manovrabilità
FUJIFIL ITALIA SRL		

C.6.2

DOTT.SSA ENRICA CAVIGLIA

LOTTO 2 - ECOGRAFO ALTA FASCIA PER APPLICAZIONI IN RADIOLOGIA/MULTIDISCIPLINARI

Parametro C.1 Qualità imaging 2D PUNTI 4,27

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Seven eHd	0.4	Discreta qualità ultrasuone
SIEMENS HELATHCARE ACUSON X700	0.2	Sufficiente qualità

Parametro C.2 Qualità di enhancement dell'immagine dell'ago PUNTI 1,43

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Seven eHd	0.6	Buon enhancement dell'ultrasuone
SIEMENS HELATHCARE ACUSON X700	0.1	Diff. enhancement dell'ultrasuone

Parametro C.4 Color doppler, doppler con particolare riferimento: valutazione grossi vasi addominali, valutazione piccoli vasi prencimali, addominali (es. milza), del collo, periferici (es. tiroide, testicolo ecc.) -PUNTI 5,75

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Seven eHd	0.7	Ottimo color doppler dei vasi
SIEMENS HELATHCARE ACUSON X700	0.3	Discreto color doppler dei vasi

28

Parametro C.5 Sonde Lineari PUNTI 2,85

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Seven eHd	0.7	ottima performance
SIEMENS HELATHCARE ACUSON X700	0.4	Buona performance

Parametro C.6 Sonde convex Punti 2,85

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Seven eHd	0.7	ottima qualità dell'immagine
SIEMENS HELATHCARE ACUSON X700	0.1	sufficiente qualità dell'immagine

Parametro C.8 Ergonomia – facilità di cambio sonda, facilità di passaggio sonda connesse, facilità cambio modalità PUNTI 2,85

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Seven eHd	0.8	ottima manovrabilità cambio sonda
SIEMENS HELATHCARE ACUSON X700	0.2	sufficiente manovrabilità cambio sonda

C18

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA PRATICA ECOGRAFI 11/07/2019

DOTT. MAURIZIO PODESTA'

LOTTO 2 – ECOGRAFO ALTA FASCIA PER APPLICAZIONI IN RADIOLOGIA/MULTIDISCIPLINARI

Parametro C.1 Qualità imaging 2D PUNTI 4,27

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Seven eHd	0,6	Buona qualità qualità d'immagine
SIEMENS HELATHCARE ACUSON X700	0,2	Sufficiente qualità

Parametro C.2 Qualità di enhancement dell'immagine dell'ago PUNTI 1,43

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Seven eHd	0,4	Buon enhancement
SIEMENS HELATHCARE ACUSON X700	0,1	Sufficiente enhancement

Parametro C.4 Color doppler, doppler con particolare riferimento: valutazione grossi vasi addominali, valutazione piccoli vasi perichimali, addominali (es. milza), del collo, periferici (es. tiroide, testicolo ecc.) –PUNTI 5,75

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Seven eHd	0,6	Ottima valutazione vasi perichimali
SIEMENS HELATHCARE ACUSON X700	0,2	Sufficiente qualità Doppler

MP

Parametro C.5 Sonde Lineari PUNTI 2,85

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Seven eHd	0,6	Ottima performance
SIEMENS HELATHCARE ACUSON X700	0,4	Buona performance

Parametro C.6 Sonde convex Punti 2,85

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Seven eHd	0,7	Ottima performance
SIEMENS HELATHCARE ACUSON X700	0,1	Sufficiente qualità nell'immagine

Parametro C.8 Ergonomia – facilità di cambio sonda, facilità di passaggio sonda connesse, facilità cambio modalità PUNTI 2,85

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Seven eHd	0,6	Sonda leggera e maneggevole
SIEMENS HELATHCARE ACUSON X700	0,3	Difficile maneggiarla

Handwritten signature

LOTTO 2 –ECOGRAFO ALTA FASCIA PER APPLICAZIONI IN RADIOLOGIA/MULTIDISCIPLINARI

Parametro C.1 Qualità imaging 2D PUNTI 4,27

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Seven eHd	0,5	valido 2D Dimensione delle immagini nello schermo sempre troppo piccola dimensionalmente
SIEMENS HELATHCARE ACUSON X700	0.1	scadente immagine 2D sonde convex

Parametro C.2 Qualità di enhancement dell'immagine dell'ago PUNTI 1,43

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Seven eHd	0.5	dotazione software per attenuare le immagini dell'ago
SIEMENS HELATHCARE ACUSON X700	0.1	non dispone di software dedicato per attenuare la defezione dell'ago

Parametro C.4 Color doppler, doppler con particolare riferimento: valutazione grossi vasi addominali, valutazione piccoli vasi prechimali, addominali (es. milza), del collo, periferici (es. tiroide, testicolo ecc.) –PUNTI 5,75

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Seven eHd	0.7	buona dotazione software residente per attenuare la visualizzazione color
SIEMENS HELATHCARE ACUSON X700	0.2	dotazione nei limiti della accettabilità

Spallini

Parametro C.5 Sonde Lineari PUNTI 2,85

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Seven eHd	0.6	buone linee ampio range frequenza
SIEMENS HELATHCARE ACUSON X700	0.3	adeguate, limitato range dinamico

Parametro C.6 Sonde convex Punti 2,85

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Seven eHd	0.8	valide qualità, buon range dinamico
SIEMENS HELATHCARE ACUSON X700	0.1	B mode scadente

Parametro C.8 Ergonomia – facilità di cambio sonda, facilità di passaggio sonda connesse, facilità cambio modalità PUNTI 2,85

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Seven eHd	0.7	facile da orientare maneggevole cambio sonda rapido
SIEMENS HELATHCARE ACUSON X700	0.2	limitate ricambiabilità dell'orientamento del trasduttore cambio sonda nei limiti

Stelli

DOTT. ~~MAURIZIO PODESTA'~~ ENRICA CAVIGLIA

LOTTO 3 – ECOGRAFO ALTA FASCIA PER APPLICAZIONI IN RADIOLOGIA/MULTIDISCIPLINARI

Parametro C.1 Qualità imaging 2D PUNTI 5,89

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.4	braccio euro pe
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.8	Oliviero peraltro unif

Parametro C.2 Mezzo di contrasto: cospicuità, entità dell'enhancement, durata massima clip registrabile PUNTI : 2,35

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	ness valutabile	ness disponibile clip o determinazione
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.5	Univento clip di breve tempo addizionale

Parametro C.3 Color doppler, doppler con particolare riferimento: valutazione grossi vasi addominali, valutazione piccoli vasi prencimali , addominali (es. milza), del collo, periferici (es. tiroide, testicolo ecc.) –PUNTI 2,35

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.6	Buona visione li 2207. in color doppler
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.7	Oliviero visione li 2207. in color doppler

C/8

Parametro C.4 Sonde Lineari: maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless PUNTI 1,18

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.6	Buona manegge- volezza sonda
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.7	ottimo maneggevol. sonda

Parametro C.5 Sonde convex maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless Punti 1,18

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.6	Buona manegge- volezza e campo
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.8	ottimo maneggevol- ezza e campo

Parametro C.6 Sonda endocavitaria: maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless Punti 2,35

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.4	Buon campo di vista e adeguata maneggevolezza
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.4	Buon campo di vista e adeguata maneggevolezza

CF

Parametro C.7 Ergonomia – facilità di cambio sonda, facilità di passaggio sonda connesse, facilità cambio modalità
PUNTI 2,35

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.4	Buona facilità di cambio sonda e modalità
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.5	Buona facilità di cambio sonda e modalità

Parametro C.8 Elastasonografia: facilità d'uso, accuratezza, ripetibilità PUNTI 2,35

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.4	adeguata facilità di uso e accuratezza all'impiego
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.7	facile uso e accuratezza all'impiego

C/f

DOTT. MAURIZIO PODESTA'

LOTTO 3 –ECOGRAFO ALTA FASCIA PER APPLICAZIONI IN RADIOLOGIA/MULTIDISCIPLINARI

Parametro C.1 Qualità imaging 2D PUNTI 5,89

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0,3	Discreta qualità imaging
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,6	Buona qualità imaging

Parametro C.2 Mezzo di contrasto: cospicuità, entità dell'enhancement, durata massima clip registrabile PUNTI : 2,35

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	Non valutabile	Non ho fornito clausa documentazione
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,5	Unica clip video qualità soddisfacente

Parametro C.3 Color doppler, doppler con particolare riferimento: valutazione grossi vasi addominali, valutazione piccoli vasi prencchimali , addominali (es. milza), del collo, periferici (es. tiroide, testicolo ecc.) –PUNTI 2,35

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0,5	Buona qualità Doppler
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,7	Qualità molto buona

ref

Parametro C.4 Sonde Lineari: maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless PUNTI 1,18

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0,5	Buone performance
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,6	Molto buone performance

Parametro C.5 Sonde convex maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless Punti 1,18

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0,5	Buone performance
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,7	Molto buone performance

Parametro C.6 Sonda endocavitaria: maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless Punti 2,35

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0,5	Buon campo di vista e adeguata maneggevolezza
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,5	Buon campo di vista e adeguata maneggevolezza

rep

Parametro C.7 Ergonomia – facilità di cambio sonda, facilità di passaggio sonda connesse, facilità cambio modalità
PUNTI 2,35

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0,5	Performance soddisfacente
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,6	Performance molto buona

Parametro C.8 Elastasonografia: facilità d'uso, accuratezza, ripetibilità PUNTI 2,35

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0,4	Qualità adeguata
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,7	Facile utilizzo e ottima praticità



DOTT. ENNIO BISCALDI

LOTTO 3 – ECOGRAFO ALTA FASCIA PER APPLICAZIONI IN RADIOLOGIA/MULTIDISCIPLINARI

Parametro C.1 Qualità imaging 2D PUNTI 5,89

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0,4	Valide immagini B mode con dei limiti di qualità 2D
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,7	Immagine diminuale e scelta dell'operatore. Buone qualità

Parametro C.2 Mezzo di contrasto: cospicuità, entità dell'enhancement, durata massima clip registrabile PUNTI : 2,35

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	non valutabile	non disponibile alcune dimostrazione de esame eseguito in precedenza
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,6	tutto esame registrato, di valide qualità diagnostiche interfaccia utente semplice e di intuitivo utilizzo

Parametro C.3 Color doppler, doppler con particolare riferimento: valutazione grossi vasi addominali, valutazione piccoli vasi prencimali , addominali (es. milza), del collo, periferici (es. tiroide, testicolo ecc.) –PUNTI 2,35

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0,5	Valide qualità delle immagini Doppler, qualche limite nei piedi vas periferici
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,8	Buone qualità in ogni tipologia di valutazione. Ottimo livello doppler anche nel vasodare periferico.

g. Biscaldi

Parametro C.4 Sonde Lineari: maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless PUNTI 1,18

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0,6	Sonde maneggevole con valide defrizione Bmode
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,7	Buona immagine Bmode trasduttore di qualità economica valide

Parametro C.5 Sonde convex maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless Punti 1,18

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.6	Trasduttore maneggevole, quale limite di uso nel paziente sottoposto clinicamente
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.8	Convex di grande qualità anche in impiego clinico sottoposto.

Parametro C.6 Sonda endocavitaria: maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless Punti 2,35

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0,5	Valido trasduttore, buona camp di vista
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,5	Valido trasduttore, adeguato campo di vista.

Parametro C.7 Ergonomia – facilità di cambio sonda, facilità di passaggio sonda connesse, facilità cambio modalità
PUNTI 2,35

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.4	Adeguato
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.6	Però cambio di trasduttore rapido e modifiche dei settings e tra trasduttori diversi.

Parametro C.8 Elastasonografia: facilità d'uso, accuratezza, ripetibilità PUNTI 2,35

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.5	Adeguato al tipo di impiego clinico,
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.8	Software intuitivo, semplice con misure omogenee e facile manovrabilità

Gar.

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA PRATICA ECOGRAFI 11/07/2019

DOTT.SSA ENRICA CAVIGLIA

LOTTO 4 –NOLEGGIO ECOGRAFO ALTA FASCIA PER APPLICAZIONI IN RADIOLOGIA/MULTIDISCIPLINARI

Parametro C.1 Qualità imaging 2D PUNTI 5,30

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.4	Biscatto generalto image
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.8	ottimo generalto image.

Parametro C.2 Mezzo di contrasto: cospicuità, entità dell'enhancement, durata massima clip registrabile PUNTI : 2,10

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	non valutabile	non disponibile clip o documentazione
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.5	informato clip di generalto resolution.

Parametro C.3 Color doppler, doppler con particolare riferimento: valutazione grossi vasi addominali, valutazione piccoli vasi periferici, addominali (es. milza), del collo, periferici (es. tiroide, testicolo ecc.) -PUNTI 2,10

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.5	buona visualizzazio- ne color doppler
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.7	ottima visualizzazio- ne color doppler

✓

Parametro C.4 Sonde Lineari: maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless PUNTI 1,05

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.6	Buona maneggevolezza Vale 720° anche
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.7	Altamente maneggevole 720°

Parametro C.5 Sonde convex maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless Punti 1,05

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.6	Buona maneggevolezza e Campo
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.8	Altamente maneggevole e Campo

Parametro C.6 Sonda endocavitaria: maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless Punti 2,10

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.4	Buon Campo di vista e adeguata maneggevolezza
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.4	Buon Campo di vista e adeguata maneggevolezza

4/8

Parametro C.7 Ergonomia – facilità di cambio sonda, facilità di passaggio sonda connesse, facilità cambio modalità
PUNTI 2,10

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.4	Buone facilità di cambio sonda e modalità
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.5	Buone facilità di cambio sonda e modalità

Parametro C.8 Elastasonografia: facilità d'uso, accuratezza, ripetibilità PUNTI 2,10

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.4	facile d'uso e accuratezza all'impianto
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.7	facile d'uso e accuratezza all'impianto

Parametro C.9 Fusion: facilità d'uso, accuratezza, compatibilità multivendor PUNTI 2,10

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	non Valutabile	nessuna esperienza o non funzionante
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.7	ottime prestazioni Valutate su fantocino

Handwritten signature

LOTTO 4 –NOLEGGIO ECOGRAFO ALTA FASCIA PER APPLICAZIONI IN RADIOLOGIA/MULTIDISCIPLINARI

Parametro C.1 Qualità imaging 2D PUNTI 5,30

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0,3	Diretta qualità imaging
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,6	Buona qualità imaging

Parametro C.2 Mezzo di contrasto: cospicuità, entità dell'enhancement, durata massima clip registrabile PUNTI : 2,10

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	Non valutabile	Non ha fatto claus obstruttiva
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,5	Vincente clip video qualità soddisfacente

Parametro C.3 Color doppler, doppler con particolare riferimento: valutazione grossi vasi addominali, valutazione piccoli vasi prencimali , addominali (es. milza), del collo, periferici (es. tiroide, testicolo ecc.) –PUNTI 2,10

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0,5	Buona qualità Doppler
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,7	Qualità molto buona

[Handwritten signature]

Parametro C.4 Sonde Lineari: maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless PUNTI 1,05

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0,5	Buona performance
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,6	Molto buona performance

Parametro C.5 Sonde convex maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless Punti 1,05

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0,5	Buona performance
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,7	Performance molto buona

Parametro C.6 Sonda endocavitaria: maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless Punti 2,10

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0,5	Buon campo di vista e adeguata maneggevolezza
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,5	Buon campo di vista e adeguata maneggevolezza

Parametro C.7 Ergonomia – facilità di cambio sonda, facilità di passaggio sonda connesse, facilità cambio modalità
PUNTI 2,10

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0,5	Referenza soddisfacente
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,6	Referenza Referenza molto buona

Parametro C.8 Elastosonografia: facilità d'uso, accuratezza, ripetibilità PUNTI 2,10

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0,4	Qualità adeguata
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,7	Facile utilizzo e ottima praticità

Parametro C.9 Fusion: facilità d'uso, accuratezza, compatibilità multivendor PUNTI 2,10

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	Non valutabile	Nessun documentazione in merito
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0,7	Resulti valutati in futuro

[Handwritten signature]

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA PRATICA ECOGRAFI 11/07/2019

DOTT. ENNIO BISCALDI

LOTTO 4 –NOLEGGIO ECOGRAFO ALTA FASCIA PER APPLICAZIONI IN RADIOLOGIA/MULTIDISCIPLINARI

Parametro C.1 Qualità imaging 2D PUNTI 5,30

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.4	Valide immagini Bmode con limiti di qualità 2D
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.7	immagini ottimizzabili e scelte dell'utente Buone qualità

Parametro C.2 Mezzo di contrasto: cospicuità, entità dell'enhancement, durata massima clip registrabile PUNTI : 2,10

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	non valutabile	non disponibile alcune dimostrazioni da precedente esame
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.6	Video come registrato, di valide qualità di frame interfaccia utente semplice

Parametro C.3 Color doppler, doppler con particolare riferimento: valutazione grossi vasi addominali, valutazione piccoli vasi prencimali, addominali (es. milza), del collo, periferici (es. tiroide, testicolo ecc.) –PUNTI 2,10

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.5	valide qualità doppler
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.8	Buone qualità di op valutazione parte ottimo doppler anche nel periferico.

Ennio Biscaldi

Parametro C.4 Sonde Lineari: maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless PUNTI 1,05

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.6	Sonde maneggevole
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.7	Buone manovre Buone trasduttore di qualità ergonomie valide

Parametro C.5 Sonde convex maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless Punti 1,05

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.6	maneggevole con qualche limite di uso
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.8	convex di qualità anche nell'uso inferenziale

Parametro C.6 Sonda endocavitaria: maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless Punti 2,10

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.5	valido trasduttore buono campo di vista
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.5	valido trasduttore adeguato campo di vista

Parametro C.7 Ergonomia – facilità di cambio sonda, facilità di passaggio sonda connesse, facilità cambio modalità
PUNTI 2,10

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.4	adeguato
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.6	Più facile cambio di trasduttore ref. da modifica settings

Parametro C.8 Elastosonografia: facilità d'uso, accuratezza, ripetibilità PUNTI 2,10

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	0.5	adeguato
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.8	Software unificato semplice unificare angoli facile da utilizzare

Parametro C.9 Fusion: facilità d'uso, accuratezza, compatibilità multivendor PUNTI 2,10

Ditta	Punteggio	Motivazione
ESAOTE My Lab Class C	non valutabile	
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Logiq S8 XdClear	0.8	Software completo vinto su fantoccio. Agile, completo, di validissime qualità, di semplice utilizzo.

Stella

LOTTO 5

Parametro C. 1 Qualità imaging 2D

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE		0		PHILIPS		6	
ESAOTE		2		SIEMENS		0	
PHILIPS		6		SIEMENS		0	

ASL 3 GENOVESE
Dr. Maurizio Podestà
Dirigente Medico
Ostetricia e Ginecologia
O.M. GE 15338

Parametro C.2 Mezzo di contrasto - cospicuità, enetità dell'enhancement, durata massima della clip

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE		20		PHILIPS		4	
ESAOTE		1		SIEMENS		1	
PHILIPS		4		SIEMENS		0	

Parametro C.3 Color Doppler, Doppler

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE		0		PHILIPS		6	
ESAOTE		2		SIEMENS		0	
PHILIPS		6		SIEMENS		0	

Parametro C.4 - Sonda convex - maneggevolezza, campo vista, eventuale wireless

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE		0		PHILIPS		50	
ESAOTE		0		SIEMENS		2	
PHILIPS		6		SIEMENS		0	

Parametro C.5 - Sonda endocavitaria - maneggevolezza, campo vista, eventuale wireless

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE		0		PHILIPS		6	
ESAOTE		0		SIEMENS		2	
PHILIPS		6		SIEMENS		0	

Parametro C.6 - Ergonomia - facilità sostituzione sonde, facilità di commutazione tra sonde collegate, velocità di commutazione tra diverse modalità (es. da imaging a color doppler, o doppler pulsato ecc.)

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE		0		PHILIPS		6	
ESAOTE		0		SIEMENS		2	
PHILIPS		6		SIEMENS		0	

Parametro C.7 - Elastsonografia

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE		1		PHILIPS		1	
ESAOTE		1		SIEMENS		1	
PHILIPS		1		SIEMENS		1	

Parametro C. 8 - Modulo 3/4D - qualità imaging, praticità, sonda 3D, velocità di acquisizione, ampiezza campo, qualità di immagine sul piano coronale ricostruito)

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE		0		PHILIPS		6	
ESAOTE		1		SIEMENS		1	
PHILIPS		6		SIEMENS		0	

ENNIO BISCALDI

LOTTO 5

Btlu

Parametro C. 1 Qualità imaging 2D

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE	0			PHILIPS	5		
ESAOTE	1			SIEMENS	0		
PHILIPS	5			SIEMENS	0		

Parametro C.2 Mezzo di contrasto - cospicuità, enetità dell'enhancement, durata massima della clip

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE	0			PHILIPS	3		
ESAOTE	1			SIEMENS	1		
PHILIPS	3			SIEMENS	0		

Parametro C.3 Color Doppler, Doppler

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE	0			PHILIPS	5		
ESAOTE	2			SIEMENS	0		
PHILIPS	5			SIEMENS	0		

Parametro C.4 - Sonda convex - maneggevolezza, campo vista, eventuale wireless

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE	0			PHILIPS	6		
ESAOTE	1			SIEMENS	0		
PHILIPS	5			SIEMENS	0		

Parametro C.5 - Sonda endocavitaria - maneggevolezza, campo vista, eventuale wireless

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE	0			PHILIPS	5		
ESAOTE	0			SIEMENS	2		
PHILIPS	4			SIEMENS	0		

Parametro C.6 - Ergonomia - facilità sostituzione sonde, facilità di commutazione tra sonde collegate, velocità di commutazione tra diverse modalità (es. da imaging a color doppler, o doppler pulsato ecc.)

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE	0			PHILIPS	4		
ESAOTE	2			SIEMENS	0		
PHILIPS	5			SIEMENS	0		

Parametro C.7 - Elastsonografia

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE	1			PHILIPS	1		
ESAOTE	1			SIEMENS	1		
PHILIPS	1			SIEMENS	1		

Parametro C. 8 - Modulo 3/4D - qualità imaging, praticità, sonda 3D, velocità di acquisizione, ampiezza campo, qualità di immagine sul piano coronale ricostruito)

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE	0			PHILIPS	5		
ESAOTE	0			SIEMENS	2		
PHILIPS	4			SIEMENS	0		

Btlu

CAVIGLIA ENITA

LOTTO 5

C/8-

Parametro C. 1 Qualità imaging 2D

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE			0	PHILIPS			6
ESAOTE			2	SIEMENS			0
PHILIPS			6	SIEMENS			0

Parametro C.2 Mezzo di contrasto - cospicuità, enetità dell'enhancement, durata massima della clip

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE			0	PHILIPS			4
ESAOTE			1	SIEMENS			1
PHILIPS			4	SIEMENS			0

Parametro C.3 Color Doppler, Doppler

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE			0	PHILIPS			5
ESAOTE			3	SIEMENS			0
PHILIPS			6	SIEMENS			0

Parametro C.4 - Sonda convex - maneggevolezza, campo vista, eventuale wireless

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE			0	PHILIPS			6
ESAOTE			0	SIEMENS			9
PHILIPS			5	SIEMENS			0

Parametro C.5 - Sonda endocavitaria - maneggevolezza, campo vista, eventuale wireless

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE			0	PHILIPS			5
ESAOTE			0	SIEMENS			9
PHILIPS			5	SIEMENS			0

Parametro C.6 - Ergonomia - facilità sostituzione sonde, facilità di commutazione tra sonde collegate, velocità di commutazione tra diverse modalità (es. da imaging a color doppler, o doppler pulsato ecc.)

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE			0	PHILIPS			6
ESAOTE			3	SIEMENS			0
PHILIPS			5	SIEMENS			0

Parametro C.7 - Elastsonografia

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE			1	PHILIPS			2
ESAOTE			1	SIEMENS			2
PHILIPS			1	SIEMENS			1

Parametro C. 8 - Modulo 3/4D - qualità imaging, praticità, sonda 3D, velocità di acquisizione, ampiezza campo, qualità di immagine sul piano coronale ricostruito)

Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA	Ditta	BISCLADI	PODESTA'	CAVIGLIA
ESAOTE			0	PHILIPS			5
ESAOTE			2	SIEMENS			0
PHILIPS			4	SIEMENS			0

Lotto 1 - ecografo portatile di servizio a supporto di procedure diagnostico/terapeutiche eco-guidate	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara		ESAOTE SPA	FUJIFILM ITALIA SRL
				Valutazioni individuali	Valutazioni individuali
ECOGRAFO				MY LAB GAMMA	Sonosite M-turbo
c.1 Qualità imaging 2D con particolare riferimento ai vasi del collo e periferici	8	Q1	BISCALDI	0,30	
			PODESTA'	0,50	
			CAVIGLIA	0,60	
			Media coefficienti	0,47	0,00
			riportata a 1	1,00	0,00
			Punteggio	8,000	0,000
c.2 Sistema di enhancement dell'immagine dell'ago	2	Q1	BISCALDI	0,70	
			PODESTA'	0,30	
			CAVIGLIA	0,50	
			Media coefficienti	0,50	0,00
			riportata a 1	1,00	0,00
			Punteggio	2,000	0,000
c.3 color doppler, doppler con particolare riferimento ai vasi del collo e periferici	4	Q1	BISCALDI	0,50	
			PODESTA'	0,40	
			CAVIGLIA	0,40	
			Media coefficienti	0,43	0,00
			riportata a 1	1,00	0,00
			Punteggio	4,000	0,000
c.4 sonde lineari	2	Q1	BISCALDI	0,30	
			PODESTA'	0,50	
			CAVIGLIA	0,40	
			Media coefficienti	0,40	0,00
			riportata a 1	1,00	0,00
			Punteggio	2,000	0,000
c.5 sonda convex	2	Q1	BISCALDI	0,30	
			PODESTA'	0,50	
			CAVIGLIA	0,40	
			Media coefficienti	0,40	0,00
			riportata a 1	1,00	0,00
			Punteggio	2,000	0,000
c.6.1 Ergonomia: facilità di pulizia/disinfezione	1	Q1	BISCALDI	0,50	
			PODESTA'	0,70	
			CAVIGLIA	0,50	
			Media coefficienti	0,57	0,00
			riportata a 1	1,00	0,00
			Punteggio	1,000	0,000
c.6.2 Ergonomia: velocità di passaggio tra modalità diverse (es. da imaging a color doppler)	1	Q1	BISCALDI	0,70	
			PODESTA'	0,30	
			CAVIGLIA	0,70	
			Media coefficienti	0,57	0,00
			riportata a 1	1,00	0,00
			Punteggio	1,000	0,000
Totale punteggio di qualità	20,00			20,000	0,000
Totale punteggio di qualità prova pratica				20,000	0,000
Punteggio qualità ereditato				40,000	24,91
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				60,000	24,91
		Ecografo		13.450,00	
		Modulo cardiologico		700,00	
		Sonda cardiologica adulti		2.200,00	
		TOTALE		16.350,00	
		BASE GARA			
	40,00			40,000	
	100,00			100,000	

LOTTO 2 - NOLEGGIO ECOGRAFO DI ALTA FASCIA PER APPLICAZIONI IN RADIOLOGIA E MULTIDISCIPLINARI	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara		ESAO TE SPA		SIEMENS	
			Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		
ECOGRAFO							
c.1 qualità imaging 2D	4,27	Q1	BISCALDI	0,500	0,100		
			PODESTA'	0,600	0,200		
			CAVIGLIA	0,400	0,200		
			Media coefficienti	0,500	0,167		
			Riportati a 1	1,000	0,333		
			Punteggio	4,270	1,423		
c.2 Qualità enjancement dell'immagine dell'ago	1,43	Q1	BISCALDI	0,500	0,100		
			PODESTA'	0,400	0,100		
			CAVIGLIA	0,600	0,100		
			Media coefficienti	0,500	0,100		
			riportata a 1	1,000	0,200		
			Punteggio	1,430	0,286		
c.4 Color Doppler, Doppler: valutazione vasi addominali; valutazione piccoli vasi parenchimali, addominali (es. milza), del collo, periferici (es. tiroide, testicolo ecc.)	5,75	Q1	BISCALDI	0,70	0,20		
			PODESTA'	0,60	0,20		
			CAVIGLIA	0,70	0,30		
			Media coefficienti	0,67	0,23		
			riportata a 1	1,00	0,35		
			Punteggio	5,750	2,013		
c.5 sonde lineari	2,85	Q1	BISCALDI	0,60	0,30		
			PODESTA'	0,60	0,40		
			CAVIGLIA	0,70	0,40		
			Media coefficienti	0,63	0,37		
			riportata a 1	1,00	0,58		
			Punteggio	2,850	1,650		
c.6 sonda convex	2,85	Q1	BISCALDI	0,80	0,10		
			PODESTA'	0,70	0,10		
			CAVIGLIA	0,70	0,10		
			Media coefficienti	0,73	0,10		
			riportata a 1	1,00	0,14		
			Punteggio	2,850	0,389		
c.8 Ergonomia: facilità cambio sonda, facilità di passaggio sonda connesse, facilità cambio modalità	2,85	Q1	BISCALDI	0,70	0,20		
			PODESTA'	0,60	0,30		
			CAVIGLIA	0,80	0,20		
			Media coefficienti	0,70	0,23		
			riportata a 1	1,00	0,33		
			Punteggio	2,850	0,950		
Totale punteggio di qualità prova pratica	20,00			17,150	5,760		
Totale punteggio di qualità riparametrato				20,000	6,718		
Punteggio di qualità ereditato				40,000	21,735		
TOTALE PUNTEGGIO DI QUALITA'				60,000	28,453		
	BASE GARA	ECOGRAFO	34.781,000	24.800,00	29.971,00	25.000,00	34.781,00
		modulo cardiologico	1.507,000	1.000,00	1.507,00	1.100,00	1.239,00
		sonda cardiologica adulti	5.200,000	2.500,00	3.627,00	5.100,00	5.200,00
		TOTALE	41.488,000	28.300,00		31.200,00	
	Ribasso %	28,293		31,788		24,798	
	40,00			40,000		36,282	
	100,00			100,000		64,735	

LOTTO 3- ECOGRAFO DI ALTA FASCIA PER APPLICAZIONI IN RADIOLOGIA/MULTIDISCIPLINARI	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara		ESAOTE SPA		GE Medical Systems Italia spa	
			Valutazioni individuali		Valutazioni individuali		
ECOGRAFO							
c.1 qualità imaging 2D	5,3	Q1	BISCALDI	0,400		0,700	
			PODESTA'	0,300		0,600	
			CAVIGLIA	0,400		0,800	
			Media coefficienti	0,367		0,700	
			Riportati a 1	0,524		1,000	
			Punteggio	2,776		5,300	
C.2 mezzo di contrasto: cospicuità, entità dell'enhancement, durata massima clip registrabile	2,1	Q1	BISCALDI	0,000		0,600	
			PODESTA'	0,000		0,500	
			CAVIGLIA	0,000		0,500	
			Media coefficienti	0,000		0,533	
			riportata a 1	0,000		1,000	
			Punteggio	0,000		2,100	
c.3 color doppler, doppler: valutazione grossi vasi addominali, valutazione piccoli vasi parenchimali addominali (es. milza), periferici (es. tiroide, testicolo ecc.)	2,1	Q1	BISCALDI	0,50		0,80	
			PODESTA'	0,50		0,70	
			CAVIGLIA	0,50		0,70	
			Media coefficienti	0,50		0,73	
			riportata a 1	0,68		1,00	
			Punteggio	1,432		2,100	
c.4 sonde lineari: maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless	1,05	Q1	BISCALDI	0,60		0,70	
			PODESTA'	0,50		0,60	
			CAVIGLIA	0,60		0,70	
			Media coefficienti	0,57		0,67	
			riportata a 1	0,85		1,00	
			Punteggio	0,893		1,050	
c.5 sonda convex: maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless	1,05	Q1	BISCALDI	0,60		0,80	
			PODESTA'	0,50		0,70	
			CAVIGLIA	0,60		0,70	
			Media coefficienti	0,57		0,73	
			riportata a 1	0,77		1,00	
			Punteggio	0,811		1,050	
c.6 sonda endocavitaria: maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless	2,1	Q1	BISCALDI	0,50		0,50	
			PODESTA'	0,50		0,50	
			CAVIGLIA	0,40		0,40	
			Media coefficienti	0,47		0,47	
			riportata a 1	1,00		1,00	
			Punteggio	2,100		2,100	
c.7 ergonomia: facilità sostituzione sonde, facilità di commutazione tra sonde collegate, velocità di commutazione tra diverse modalità	2,1	Q1	BISCALDI	0,40		0,60	
			PODESTA'	0,50		0,60	
			CAVIGLIA	0,40		0,50	
			Media coefficienti	0,43		0,57	
			riportata a 1	0,76		1,00	
			Punteggio	1,606		2,100	
c.8 elastosonografia: facilità d'uso, accuratezza, ripetibilità	2,1	Q1	BISCALDI	0,50		0,80	
			PODESTA'	0,40		0,70	
			CAVIGLIA	0,40		0,70	
			Media coefficienti	0,43		0,73	
			riportata a 1	0,59		1,00	
			Punteggio	1,241		2,100	
c.9 Fusion: facilità d'uso, accuratezza, compatibilità multivendor	2,1	Q1	BISCALDI	0,00		0,80	
			PODESTA'	0,00		0,70	
			CAVIGLIA	0,00		0,70	
			Media coefficienti	0,00		0,73	
			riportata a 1	0,00		1,00	
			Punteggio	0,000		2,100	
Totale punteggio di qualità prova pratica	20,00			9,618		17,900	
Totale punteggio di qualità riparametrato				10,746		20,000	
Punteggio di qualità ereditato				50,000		46,236	
TOTALE PUNTEGGIO DI QUALITA'				60,746		66,236	
	BASE GARA	ECOGRAFO	58.146,000	26.000,00		27.000,00	
		modulo elastosonografia tessuti profondi	17.100,000	8.000,00		5.000,00	
		modulo cardiologico	1.842,000	1.000,00		300,00	
		sonda cardiologica adulti	4.401,000	2.000,00		1.500,00	
		sonda cardiologica pediatrica	4.401,000	2.000,00		1.500,00	
		sonda lineare 10 Mhz	4.500,000	2.000,00		1.500,00	
		sonda convex pediatrica	4.500,000	2.000,00		1.500,00	
		kit biopsia sonda convex	500,000	500,00		380,00	
		TOTALE	95.390,000	43.500,00		38.680,00	
	Ribasso %	56,924		54,398		59,451	
	30,00			26,676		30,000	
	100,00			87,422		96,236	






LOTTO 4 - NOLEGGIO ECOGRAFO DI ALTA FASCIA PER APPLICAZIONI IN RADIOLOGIA/MULTIDISCIPLINARI				Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	ESAO TE SPA	GE Medical Systems Italia spa
						Valutazioni individuali	Valutazioni individuali
ECOGRAFO							
c.1 qualità imaging 2D	5,3	Q1	BISCALDI		0,400		0,700
			PODESTA'		0,300		0,600
			CAVIGLIA		0,400		0,800
			Media coefficienti		0,367		0,700
			Riportati a 1		0,524		1,000
			Punteggio		2,776		5,300
C.2 mezzo di contrasto: cospicuità, entità dell'enhancement, durata massima clip registrabile	2,1	Q1	BISCALDI		0,000		0,600
			PODESTA'		0,000		0,500
			CAVIGLIA		0,000		0,500
			Media coefficienti		0,000		0,533
			riportata a 1		0,000		1,000
			Punteggio		0,000		2,100
c.3 color doppler, doppler: valutazione grossi vasi addominali, valutazione piccoli vasi parenchimali addominali (es. milza); periferici (es. tiroide, testicolo ecc.)	2,1	Q1	BISCALDI		0,50		0,80
			PODESTA'		0,50		0,70
			CAVIGLIA		0,50		0,70
			Media coefficienti		0,50		0,73
			riportata a 1		0,68		1,00
			Punteggio		1,432		2,100
c.4 sonde lineari: maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless	1,05	Q1	BISCALDI		0,60		0,70
			PODESTA'		0,50		0,60
			CAVIGLIA		0,60		0,70
			Media coefficienti		0,57		0,67
			riportata a 1		0,85		1,00
			Punteggio		0,893		1,050
c.5 sonda convex: maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless	1,05	Q1	BISCALDI		0,60		0,80
			PODESTA'		0,50		0,70
			CAVIGLIA		0,60		0,70
			Media coefficienti		0,57		0,73
			riportata a 1		0,77		1,00
			Punteggio		0,811		1,050
c.6 sonda endocavitaria: maneggevolezza, campo di vista, eventuale wireless	2,1	Q1	BISCALDI		0,50		0,50
			PODESTA'		0,50		0,50
			CAVIGLIA		0,40		0,40
			Media coefficienti		0,47		0,47
			riportata a 1		1,00		1,00
			Punteggio		2,100		2,100
c.7 ergonomia: facilità sostituzione sonde, facilità di commutazione tra sonde collegate, velocità di commutazione tra diverse modalità	2,1	Q1	BISCALDI		0,40		0,60
			PODESTA'		0,50		0,60
			CAVIGLIA		0,40		0,50
			Media coefficienti		0,43		0,57
			riportata a 1		0,76		1,00
			Punteggio		1,606		2,100
c.8 elastosonografia: facilità d'uso, accuratezza, ripetibilità	2,1	Q1	BISCALDI		0,50		0,80
			PODESTA'		0,40		0,70
			CAVIGLIA		0,40		0,70
			Media coefficienti		0,43		0,73
			riportata a 1		0,59		1,00
			Punteggio		1,241		2,100
c.9 Fusion: facilità d'uso, accuratezza, compatibilità multivendor	2,1	Q1	BISCALDI		0,00		0,80
			PODESTA'		0,00		0,70
			CAVIGLIA		0,00		0,70
			Media coefficienti		0,00		0,73
			riportata a 1		0,00		1,00
			Punteggio		0,000		2,100
Totale punteggio di qualità prova pratica	20,00				9,618		17,900
Totale punteggio di qualità riparametrato					10,746		20,000
Punteggio di qualità ereditato					50,000		46,236
TOTALE PUNTEGGIO DI QUALITA'					60,746		66,236
	BASE GARA	ECOGRAFO	68.208,000	32.240,00	50.835,00	34.022,00	68.208,00
		modulo elastosonografia tessuti profondi	13.760,000	8.000,00	9.920,00	4.692,00	13.760,00
		modulo fusion	20.813,000	8.000,00	20.813,00	5.866,00	19.680,00
		sonda lineare 15 MHz	4.960,000	3.000,00	3.738,00	1.759,00	4.960,00
		TOTALE	107.741,000	51.240,00		46.339,00	
	Ribasso %	51,427		52,733		50,120	
	30,00			27,131		30,000	
	100,00			87,877		96,236	

LOTTO 5 - Ecografo di alta fascia per applicazioni in ostetricia ginecologia	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	Valutazioni individuali	ESAO TE SPA	Valutazioni individuali	PHILIPS spa	Valutazioni individuali	SIEMENS Healthcare
ECOGRAFO			MY LAB CLASS C					
c.1 qualità imaging 2D	6,7	Q2	DOTT. BISALDI	2,00		10,00		0,00
			DOTT. PODESTA'	2,000		12,00		0,00
			DOTT.SSA CAVIGLIA	2,000		12,00		0,00
			Media coefficienti	2,000		11,33		0,00
			Ripetibilità a 1	0,176		1,000		0,000
c.2 mezzo di contrasto, cospicuità, nitidezza dell'enhancement, durata cfr registrabile	1,1	Q2	Punteggio	1,182		6,700		0,000
			DOTT. BISALDI	1,00		6,00		1,00
			DOTT. PODESTA'	1,00		8,00		1,00
			DOTT.SSA CAVIGLIA	1,00		7,33		1,00
			Media coefficienti	1,00		7,33		1,00
c.3 Color Doppler, Doppler	2,22	Q2	Ripetibilità a 1	0,14		1,00		0,14
			Punteggio	0,150		1,100		0,150
			DOTT. BISALDI	2,00		10,00		0,00
			DOTT. PODESTA'	2,00		12,00		0,00
			DOTT.SSA CAVIGLIA	2,00		11,00		0,00
c.4 Sonda convex: maneggevolezza; campo di vista; eventuale wireless	1,1	Q2	Media coefficienti	2,00		11,00		0,00
			Ripetibilità a 1	0,18		1,00		0,00
			Punteggio	0,404		2,220		0,000
			DOTT. BISALDI	2,00		11,00		0,00
			DOTT. PODESTA'	0,00		11,00		2,00
c.5 Sonda endocavitaria: maneggevolezza; campo di vista; eventuale wireless	2,22	Q2	DOTT.SSA CAVIGLIA	0,00		11,00		2,00
			Media coefficienti	0,67		11,00		1,33
			Ripetibilità a 1	0,06		1,00		0,12
			Punteggio	0,067		1,100		0,133
			DOTT. BISALDI	0,00		9,00		2,00
c.6 Ergonomia: facilità installazione sonda; facilità di comunicazione tra sonde collegate; velocità di comunicazione tra diverse modalità (es. da imaging a color doppler, o doppler pulsato)	1,1	Q2	DOTT. PODESTA'	0,00		12,00		2,00
			DOTT.SSA CAVIGLIA	0,00		10,00		2,00
			Media coefficienti	0,67		10,33		2,00
			Ripetibilità a 1	0,00		1,00		0,19
			Punteggio	0,000		2,220		0,430
c.7 Elastoscronografia	2,22	Q2	DOTT. BISALDI	7,00		0,00		0,00
			DOTT. PODESTA'	6,00		2,00		0,00
			DOTT.SSA CAVIGLIA	7,00		0,00		0,00
			Media coefficienti	6,67		0,67		0,00
			Ripetibilità a 1	1,00		0,10		0,00
c.10 Modulo 3D/4D: qualità imaging; praticità; sonda 3D; velocità di acquisizione, ampiezza del campo, qualità di immagine sul piano coronale (ricostruito)	3,34	Q2	Punteggio	1,100		0,110		0,000
			DOTT. BISALDI	2,00		2,00		2,00
			DOTT. PODESTA'	2,00		2,00		2,00
			DOTT.SSA CAVIGLIA	2,00		2,00		2,00
			Media coefficienti	2,00		2,00		2,00
Totale punteggio di qualità prova pratica	20,00	Q2	Ripetibilità a 1	1,00		1,00		1,00
			Punteggio	2,220		2,220		2,220
			DOTT. BISALDI	0,000		9,000		2,000
			DOTT. PODESTA'	1,000		12,000		1,000
			DOTT.SSA CAVIGLIA	3,000		9,000		0,000
Totale punteggio di qualità riparametrato	3,34	Q2	Media coefficienti	1,33		10,00		1,00
			Ripetibilità a 1	0,13		1,00		0,10
			Punteggio	0,445		3,340		0,334
			DOTT. BISALDI	0,000		9,000		2,000
			DOTT. PODESTA'	1,000		12,000		1,000
Punteggio di qualità ereditato	20,00	Q2	DOTT.SSA CAVIGLIA	3,000		9,000		0,000
			Media coefficienti	1,33		10,00		1,00
			Ripetibilità a 1	0,13		1,00		0,10
			Punteggio	0,445		3,340		0,334
			DOTT. BISALDI	0,000		9,000		2,000
Totale PUNTEGGIO DI QUALITA'	20,00	Q2	DOTT. PODESTA'	1,000		12,000		1,000
			DOTT.SSA CAVIGLIA	3,000		9,000		0,000
			Media coefficienti	1,33		10,00		1,00
			Ripetibilità a 1	0,13		1,00		0,10
			Punteggio	0,445		3,340		0,334
ECOGRAFO	55.000,00	BASE GARA	DOTT. BISALDI	25.000,00		45.320,00		55.000,00
			DOTT. PODESTA'	25.000,00		58.000,00		55.000,00
			DOTT.SSA CAVIGLIA	500,00		490,00		470,00
			Media coefficienti	500,00		490,00		470,00
			Ripetibilità a 1	67.500,00		58.490,00		55.000,00
Rilasso %	30,00	31,577	DOTT. BISALDI	62,687		13,433		18,612
			DOTT. PODESTA'	30,000		11,486		15,914
			DOTT.SSA CAVIGLIA	69,962		81,486		53,842
			Media coefficienti	30,000		11,486		15,914
			Ripetibilità a 1	69,962		81,486		53,842

[Handwritten signature and initials]