

Centrale Regionale di Acquisto

Dirigente responsabile: dott. ssa Silvia SIMONETTI  
 Funzionario referente: dott. ssa Paola BURLANDO  
 Estensore del documento: Sig. Roberto BORETTI

Prot. gen. n. 1854 del 22/12/2011

## Deliberazione n. 84 del 22/12/2011

**Oggetto:** procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di "Sistemi antidecubito" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre – Lotti n. 5 Importo previsto di spesa per la pubblicazione dell'aggiudicazione di gara €. 1.500,00 (IVA inclusa).

**Aggiudicazione definitiva.**

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge della Regione Liguria 03/04/2007 n. 14 che ha previsto l'istituzione, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, di una Centrale Regionale di Acquisto;

Vista altresì la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 805 del 04/07/2008 con la quale la Centrale è stata costituita in forma di Consorzio tra gli Enti sanitari liguri, approvandone contestualmente lo statuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2602 e ss. C.C.;

Richiamata la deliberazione della Centrale n° 59 del 13/10/2010 con la quale si è provveduto all'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di "Sistemi antidecubito" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre, con il criterio di aggiudicazione di cui all' art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 (offerta economicamente più vantaggiosa) ed alla contestuale approvazione del Capitolato Tecnico e delle norme di partecipazione;

Considerato che con deliberazione n. 67 del 18/11/2010 è stato fissato alle ore 12,00 del giorno 13/12/2010 il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e che sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

Ditta	Indirizzo	Estremi di arrivo documentazione di gara
RICORDINI PIETRO di Ricordini Mauro & C. S.r.l	V. Vernazza 32, Genova, 16131 (GE)	Prot. 1227 del 13/12/2010
T.S.S. S.r.l	V. Casilina sud km. 77.100, 03013 Ferentino (FR)	Prot. 1228 del 13/12/2010
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	C. so Potenza, 71/A, 10149 Torino (TO)	Prot. 1229 del 13/12/2010
SANITARIA SCALIGERA S.r.l	V. SS. Trinità n. 4, 38100 (TN)	Prot. 1231 del 13/12/2010
REHA - Istituto Tecnico Ortopedico	V. della Repubblica 59, 50053 Empoli (FI)	Prot. 1232 del 13/12/2010
ATI KCI Medical S.r.l Vivisol	V. A. Meucci 1, 20090 Assago (MI)	Prot. 1236 del 13/12/2010
Hill-Rom S.p.A.	V. Ambrosoli 6, 20090 Rodano (MI)	Prot. 1237 del 13/12/2010

Medic Air S.r.l.	V. Mattei 3c, 20010 Pogliano Milanese (MI)	Prot. 1240 del 13/12/2010
------------------	--	---------------------------

Preso atto che in data 14 Dicembre 2010 si è riunito il seggio di gara in seduta pubblica, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare di gara, per lo svolgimento delle operazioni relative all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa per la verifica dei documenti richiesti e che in tale seduta si è stabilito di ammettere tutte le ditte che hanno presentato offerta così come indicato nel verbale prot. n. 1252 del 14/12/2010 (**allegato n. 1**);

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 26/01/2011 con la quale si è provveduto, di concerto con la Agenzia Sanitaria Regionale, a nominare la Commissione giudicatrice della gara in oggetto;

Preso atto che la Commissione giudicatrice, si è riunita in diverse sedute per la verifica della documentazione tecnica ai fini per la assegnazione dei punteggi di qualità e della campionatura dei prodotti offerti, come risulta dal verbale prot. n.1446 del 12/10/2011 (**allegato n. 2**);

Dato atto che, successivamente alla pubblicazione del verbale del 12/10/2011, sono pervenute delle richieste di chiarimenti da alcune ditte e che la Commissione giudicatrice si è nuovamente riunita e ha stabilito in alcuni casi di accogliere le richieste di modifica dei punteggi e in altri ha ribadito le motivazioni alla base dei punteggi precedentemente assegnati, così come indicato nei verbali prot. n. 1591 del 07/11/2011 e prot. n. 1761 del 07/12/2011 (**allegati 3 e 4**).

Atteso che i risultati delle suddette operazioni di valutazione tecnica e di successiva revisione sono riepilogati nel seguente schema:

Ditte	Lotto 1		Lotto 2		Lotto 3		Lotto 4		Lotto 5	
	P.ti	Ammessa								
RICORDINI PIETRO DI RICORDINI MAURO & C. S.R.L.			27,42	SI	28,15	SI	24,88	NO		
T.S.S. S.R.L.			21,92	NO	21,10	NO				
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI				
ZUCCATO Hc Srl (ex SANITARIA SCALIGERA Srl)			31,63	SI	28,98	SI	28,78	SI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI
REHA – ISTITUTO TECNICO ORTOPEDICO			22,76	NO			22,45	NO		
ATI KCI MEDICAL S.R.L – VIVISOL			N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	44,70	SI	43,73	SI	46,50	SI
HILL- ROM S.P.A.	42,90	SI	38,26	SI	39,04	SI	38,55	SI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI
MEDIC AIR S.R.L.			N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI		

## Centrale Regionale di Acquisto

Preso atto del Verbale della seduta pubblica del seggio di gara di apertura delle offerte economiche tenutasi in data 07/12/2011 (prot. n. 1768 del 07/12/2011, **allegato n. 5**) il cui risultato è riepilogato nello schema seguente:

Nome Ditta		Ricordini Pietro di Ricordini Mauro & C. S.r.l.	Zuccato Hc -(ex Sanitaria Scaligera S.r.l.)	ATI Kci Medical S.r.l. - Vivisol	Hill- Rom S.p.a.
Lotto 1	Punteggio di qualità (A)				42,90
	Punteggio prezzo (B)				50
	Prezzo Offerto €.				13.667,70
	Totale Punteggio (A+B)				92,90
	Posizione in classifica				<b>AGGIUDICATARIA</b>
Lotto 2	Punteggio di qualità (A)	27,42	31,63		38,26
	Punteggio prezzo (B)	36,52	50		35,29
	Prezzo Offerto €.	855.092,70	624.476,79		884.706,30
	Totale Punteggio (A+B)	63,94	81,63		73,55
	Posizione in classifica	3 classif.	<b>AGGIUDICATARIA</b>		2 classif.
Lotto 3	Punteggio di qualità (A)	28,15	28,98	44,70	39,04
	Punteggio prezzo (B)	33,73	50	34,10	35,94
	Prezzo Offerto €.	599.735,00	404.542,00	593.224,50	562.801,50
	Totale Punteggio (A+B)	61,88	78,98	78,80	74,98
	Posizione in classifica	4 classif.	<b>AGGIUDICATARIA</b>	2 classif.	3 classif.
Lotto 4	Punteggio di qualità (A)		28,78	43,73	38,55
	Punteggio prezzo (B)		50	39,92	38,79
	Prezzo Offerto €.		433.978,70	543.588,60	559.448,80
	Totale Punteggio (A+B)		78,78	83,65	77,34
	Posizione in classifica		2 classif.	<b>AGGIUDICATARIA</b>	3 classif.
Lotto 5	Punteggio di qualità (A)			46,50	
	Punteggio prezzo (B)			50	
	Prezzo Offerto €.			84.175,00	
	Totale Punteggio (A+B)			96,50	
	Posizione in classifica			<b>AGGIUDICATARIA</b>	

Preso atto che gli Uffici della Centrale hanno provveduto ad acquisire nei tempi e secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di gara dai concorrenti risultati primi e secondi classificati la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria ex art. 48 D. Lgs. n. 163/2006;

Considerato che la documentazione probatoria fornita dalle Società di cui al punto precedente risulta conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente e dalla lex specialis della gara e pertanto idonea a confermare il possesso dei requisiti dichiarati;

Preso altresì atto che la Ditta Hill Rom e l'ATI Kci-Vivisol, risultate prime classificate per i lotti 1 e 5, hanno presentato con nota del 12/12/2011 (ns. prot. n. 1798 del 14/12/2011) e nota del 15/12/2011 (ns. prot. n. 1826 del 19/12/2011), le motivazioni di giustificazione ex artt. 86-88 D. Lgs. n. 163/2006 e che la Centrale ha ritenuto le medesime idonee a confermare la validità dell'offerta;

Rilevato che non esistono per la fornitura in oggetto convenzioni nazionali CONSIP, né prezzi massimi di riferimento ministeriale (ai sensi art. 1 comma 796 lettera v Legge n. 296/2006) e ritenuto pertanto di poter sciogliere la riserva di non aggiudicazione ex punto 8) del disciplinare di gara in quanto non ricorrono nel caso di specie i presupposti richiesti dalla normativa vigente;

Ritenuto di procedere alla aggiudicazione definitiva della fornitura de qua, in conformità al verbale di aggiudicazione provvisoria allegato alla presente deliberazione;

Su proposta del Dirigente responsabile;

### DELIBERA:

- 1) Di approvare i verbali di gara allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto come in premessa specificato, relativi all'aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di "Sistemi antidecubito" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre, con il criterio di aggiudicazione di cui all' art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 (offerta economicamente più vantaggiosa) – lotti 5;
- 2) Di dare atto che i prodotti aggiudicati e i relativi prezzi sono riepilogati nel prospetto che segue:

Lotti	Ditta aggiudicataria	Denominazione prodotto	Prezzo unitario (IVA esclusa) in €.		Quantitativo triennale (n. giornate)		Importo complessivo triennale (IVA esclusa) in €.
			Noleggio a chiamata	Noleggio continuativo	Noleggio a chiamata	Noleggio continuativo	
1	Hill Rom	P330	€ 3,95	€ 2,75	3.126	480	€ 13.667,70
2	Zuccato Hc (ex Sanitaria Scaligera)	PULSAIR CHOICE (MR)	€ 3,43	€ 3,15	148.068	37.017	€ 624.476,79
3	Zuccato Hc (ex Sanitaria Scaligera)	QUATTRO PLUS	€ 4,40	€ 4,10	65.105	28.800	€ 118.080,00
4	ATI: Kci-Vivisol	INNOVA EXTRA MRS	€ 7,80	€ 5,90	59.915	12.924	€ 543.588,60
5	ATI: Kci-Vivisol	THERAKAIR VISIO	€ 12,95		6.500		€ 84.175,00

## 3) Di dare atto:

- che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace successivamente all'espletamento dei controlli previsti dalla normativa antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, alla prestazione della garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006, alla presentazione del DURC;
- che il termine dilatorio per la stipulazione della convenzione dei lotti della gara ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (art. 79 comma 5-ter) è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data di trasmissione dell'informativa di aggiudicazione definitiva effettuata agli aggiudicatari e ai non aggiudicatari della gara;

## 4) Di dare altresì atto che la garanzia fidejussoria da prestare da parte dell'aggiudicatario è determinata nel seguente importo con diritto, in caso di possesso del certificato di Qualità CE, alla riduzione del 50% :

Lotto	Ditta aggiudicataria	Prezzo offerto unitario (IVA esclusa)		Importo totale presunto della fornitura (IVA esclusa)	Importo garanzia fidejussoria	Importo garanzia fidejussoria ridotto del 50% con certificazione di Qualità CE
		Noleggìo a chiamata	Noleggìo continuativo			
1	Hill Rom	€ 3,95	€ 2,75	€ 13.667,70	€ 1.366,77	€ 683,39
2	Zuccato Hc (ex Sanitaria Scaligera)	€ 3,43	€ 3,15	€ 624.476,79	€ 87.648,20	€ 43.824,10
3	Zuccato Hc (ex Sanitaria Scaligera)	€ 4,40	€ 4,10	€ 118.080,00	€ 57.196,92	€ 28.598,46
4	ATI: Kci-Vivisol	€ 7,80	€ 5,90	€ 543.588,60	€ 55.672,78	€ 27.836,39
5	ATI: Kci-Vivisol	€ 12,95		€ 84.175,00	€ 8.417,50	€ 4.208,75

- 5) Di dare atto che sia la convenzione quadro da sottoscrivere con la Ditta aggiudicataria, sia gli ordinativi di fornitura da sottoscrivere a cura di ciascuna Azienda, saranno redatti in base allo schema tipo approvato con la deliberazione di indizione;
- 6) Di provvedere alla notifica per estratto del presente atto a tutte le ditte concorrenti;
- 7) Di disporre la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara in argomento nelle forme di legge, sulle seguenti testate e siti informatici, alle condizioni previste nella deliberazione n. 18/2011:

- in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
- per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- su due quotidiani nazionali, due quotidiani regionali
- sui siti informatici:  
 Servizio appalti Regione Liguria  
 Sito Ministero Infrastrutture e dei Trasporti  
 Sito: [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it)

- 8) Di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento quantificati in € 1.500,00 (IVA inclusa) sono compresi nello stanziamento della voce B7 del Bilancio Economico di Previsione anno 2011;
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 6 (sei) pagine, oltre agli allegati.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Giorgio SACCO



Allegati:  
1-5 Verbali  
6 Offerte Economiche

SS/PB/rb

## **ALLEGATO N. 1**

ALLA DELIBERAZIONE N. 84 DEL 22/12/2011

### **Verbale, seduta pubblica, per la verifica della documentazione amministrativa**


**Seduta del 14/12/2010**



Centrale Regionale di Acquisto

Dirigente Responsabile: Dott. Ssa Silvia SIMONETTI tel. 010/4102214  
e-mail: [silvia.simonetti@villascassi.it](mailto:silvia.simonetti@villascassi.it)  
Funzionario referente: Dott.ssa Paola BURLANDO tel. 010/4102577  
e-mail: [paola.burlando@villascassi.it](mailto:paola.burlando@villascassi.it)

REGIONE LIGURIA Consortio Centrale Regionale di Acquisto
REGISTRO UNIFICATO
Protocollo n. 1252 del 14/12/2010



Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di "Sistemi antidecubito" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre - Lotti n. 5.

### PRIMA SEDUTA PUBBLICA Verbale di verifica della documentazione amministrativa

Il giorno quattordici del mese di Dicembre dell'anno duemiladieci, alle ore 10,00 presso la Sala riunioni dell'Ospedale Villa Scassi (Palazzina Uffici Amministrativi), si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara della Centrale Regionale di Acquisto per la verifica della sussistenza della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla "Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di Sistemi antidecubito occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre".

Sono presenti in rappresentanza della Centrale Regionale di Acquisto i Signori:

- |             |                 |                              |                          |
|-------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| ➤ SIMONETTI | Dott.ssa Silvia | Dirigente Responsabile       | in qualità di Presidente |
| ➤ BURLANDO  | Dott.ssa Paola  | Collaboratore Amm vo Esperto | in qualità di Componente |
| ➤ BORETTI   | Roberto         | Assistente Amm.vo            | in qualità di Segretario |

In rappresentanza delle Ditte offerenti sono presenti i Signori:

Nominativo	Ditta
Ricordini Mauro	RICORDINI PIETRO di Ricordini Mauro & C. S.r.l
Assente	T.S.S. S.r.l
Assente	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO
Caielli Jesus James Joseph	SANITARIA SCALIGERA S.r.l
Assente	REHA - Istituto Tecnico Ortopedico
Delega Luca Fortini\Cantoni Giancarlo Giannone Raffaella	KCI Medical S.r.l\Visisol
Cerale Roberto	Hill- Rom S.p.A.
Zanoni Luca	Medic Air S.r.l

muniti delle necessarie deleghe/procure (presentate in originale o in copia autenticata) allegate in copia quali parti integranti e sostanziali del presente verbale.

Il seggio di gara dà preliminarmente atto che:

- con deliberazioni n. 59 del 13/10/2010 si è provveduto ad indire la gara in argomento ed all'approvazione del Capitolato speciale e delle norme di partecipazione;
- con successiva delibera n. 67 del 18/11/2010 il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 12,00 del giorno 13/12/2010;
- con la medesima delibera n. 67 si fissava alle ore 10,00 del giorno 14 Dicembre 2010 l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa.

Consortio Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Corso Scassi, 1 - 16149 Genova - C.F. n° P.F. 01829030996  
Tel +39 010 4102336 - Fax +39 010 4102417 - Site web [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it)

## Centrale Regionale di Acquisto

Il seggio di gara accerta che entro il termine delle ore 12,00 del 13/12/2010 sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

Ditta	Indirizzo	Estremi di arrivo documentazione di gara
RICORDINI PIETRO di Ricordini Mauro & C. S.r.l	V. Vernazza 32, Genova, 16131 (GE)	Prot. 1227 del 13/12/2010
T.S.S. S.r.l	V. Casilina sud km. 77.100, 03013 Ferentino (FR)	Prot. 1228 del 13/12/2010
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	C. so Potenza, 71/A, 10149 Torino (TO)	Prot. 1229 del 13/12/2010
SANITARIA SCALIGERA S.r.l	V. SS. Trinità n. 4, 38100 (TN)	Prot. 1231 del 13/12/2010
REHA - Istituto Tecnico Ortopedico	V. della Repubblica 59, 50053 Empoli (FI)	Prot. 1232 del 13/12/2010
ATI KCI Medical S.r.l Vivisol	V. A. Meucci 1, 20090 Assago (MI)	Prot. 1236 del 13/12/2010
Hill- Rom S.p.A.	V. Ambrosoli 6, 20090 Rodano (MI)	Prot. 1237 del 13/12/2010
Medic Air S.r.l	V. Mattei 3c, 20010 Pogliano Milanese (MI)	Prot. 1240 del 13/12/2010

Il seggio di gara, dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità dei plichi pervenuti, procede ad aprire gli stessi che, come prescritto dalle norme di partecipazione, risultano contenere le tre buste sigillate contenenti la documentazione amministrativa (**Busta 1**), l'offerta economica (**Busta 2**) e la documentazione tecnica (**Busta 3**)

Viene altresì accertato che per ciascuna Ditta sono state predisposte apposite schede, allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, riportanti un elenco della documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare di gara (**Busta n. 1**).

Si procederà al raffronto di tali schede con la documentazione presentata dalle Ditte.

Sulle schede predisposte la Centrale appunterà negli appositi spazi la conformità della documentazione inviata a quella richiesta dal Disciplinare di gara.

Il seggio di gara procede pertanto all'apertura delle sole buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare la sussistenza della documentazione presentata dalle Ditte partecipanti in accordo alle prescrizioni del Disciplinare di gara.

Dalla verifica della sussistenza della documentazione amministrativa è emerso quanto segue:

Ditta	Documentazione amministrativa	Lotti per i quali la Ditta presenta offerta	Ammissione fase di valutazione di idoneità tecnica
RICORDINI PIETRO di Ricordini Mauro & C. S.r.l	Idonea	2, 3, 4	Ammessa
T.S.S. S.r.l	Idonea	2,3	Ammessa
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	Idonea	1,2,3	Ammessa
SANITARIA SCALIGERA S.r.l	Idonea	2,3,4,5	Ammessa
REHA - Istituto Tecnico Ortopedico	Idonea	2,4	Ammessa
ATI KCI Medical S.r.l Vivisol	Idonea	2,3,4,5	Ammessa
Hill- Rom S.p.A.	Idonea	1,2,3,4,5	Ammessa
Medic Air S.r.l	Idonea	2,3,4	Ammessa

che tutte le Ditte concorrenti hanno presentato la documentazione richiesta.

Centrale Regionale di Acquisto

La verifica della sussistenza della documentazione amministrativa ha stabilito che la stessa è stata **regolarmente** confermata per tutti i sopraindicati offerenti che risultano pertanto tutti ammessi al prosieguo della gara.

Ai sensi dell'art. 48 - comma 1 - del D.Lgs 163/2006 si procede quindi al sorteggio fra le Ditte risultate ammesse al prosieguo della gara.

Il seggio di gara invita i rappresentanti delle Ditte ad individuare tra loro la persona che dovrà effettuare il sorteggio e la scelta cade sul Sig. Caielli Jesus James Joseph che sorteggia la Ditta Ricordini Pietro.

Il seggio di gara si impegna a comunicare ufficialmente al Rappresentante della Ditta estratta che, entro il termine previsto dal Disciplinare di gara (10 gg.: scadenza del termine ore 24 del 24 Dicembre p.v.), dovrà produrre, pena esclusione, la seguente documentazione comprovante la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dalla Ditta, attraverso la presentazione dell'estratto dei bilanci dal quale si evinca il fatturato degli esercizi 2007-2008-2009.

Le buste contenenti la documentazione tecnica saranno successivamente esaminate dalla Commissione giudicatrice che provvederà alla verifica, in seduta non pubblica, della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ai fini dell'idoneità delle Ditte al prosieguo delle fasi di gara.

Le buste contenenti le offerte economiche vengono raccolte in un unico plico opportunamente chiuso e vistato sui lembi di chiusura dalla Centrale e dai rappresentanti delle Ditte. Detto plico sarà riposto per la conservazione in armadio con serratura collocato in luogo chiuso.


La seduta è tolta alle ore 11,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:

SIMONETTI

Dott.ssa Silvia



Componente:

BURLANDO


Dott.ssa Paola



Segretario:

BORETTI

Roberto



Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di "Sistemi antidecubito" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre – Lotti n. 5 .

### Verifica documentazione amministrativa

**DITTA:** RICORDINI PIETRO di Ricordini Mauro & C. S.r.l

**a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (All. F1).**

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive.

OK

**b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto del Lotto.**

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

OK

**c) Certificazione di qualità** conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

Lotto	Importo della garanzia 2% (punto b) €	Importo della garanzia 1% (punto c) €
<del>LOTTO 1</del>	<del>276,96</del>	<del>138,48</del>
LOTTO 2	20.877,59	10.438,79
LOTTO 3	12.642,40	6.821,2
LOTTO 4	12.413,12	6.206,562
<del>LOTTO 5</del>	<del>1.690,00</del>	<del>845,00</del>

OK

R2

SS

PM

- d) **Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria** per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).

OK

- e) **Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti** dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

<del>Lotto n. 1 – CIG 0553102235</del>	<del>€. 0,00</del>
Lotto n. 2 – CIG 0553107654	€. 70,00
Lotto n. 3 – CIG 0553108727	€. 40,00
Lotto n. 4 – CIG 0553115CEC	€. 40,00
<del>Lotto n. 5 – CIG 0553116DBF</del>	<del>€. 0,00</del>

OK

- ⇒ nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- ⇒ nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- ⇒ solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

- f) **Dichiarazione (Allegato E1)**, debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale.

OK

- g) **Dichiarazione (Allegato E2)** di aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico di fornitura (Allegato sez. A), del Capitolato Speciale (Allegato sez. B), della Convenzione di fornitura tra la Centrale di Acquisto e l'aggiudicatario (Allegato sez. C) e dei relativi allegati - scaricabili dal sito internet [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) - accettando incondizionatamente gli stessi in ogni loro parte.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per accettazione:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.

OK

## h) Elenco dei lotti per i quali viene presentata offerta

LOTTO 2
LOTTO 3
LOTTO 4

04

## i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata

04

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a), b), d), e), f), g), h), i) sarà motivo di esclusione dalla gara. Per quanto riguarda il punto e), oltre alla mancanza di tale attestazione, anche l'inesattezza dell'importo versato e/o del CIG indicato è motivo di esclusione dalla gara.

R2

98

M

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di "Sistemi antidecubito" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre – Lotti n. 5.

### Verifica documentazione amministrativa

DITTA: T.S.S. S.r.l

**a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (All. F1).**

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive.

OK

**b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto del Lotto.**

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

OK

**c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:**

Lotto	Importo della garanzia 2% (punto b) €	Importo della garanzia 1% (punto c) €
<del>LOTTO 1</del>	<del>276,96</del>	<del>138,48</del>
LOTTO 2	20.877,59	10.438,79
LOTTO 3	13.642,40	6.821,2
<del>LOTTO 4</del>	<del>12.413,12</del>	<del>6.206,562</del>
LOTTO 5	1.690,00	845,00

OK

OK

OK

OK

- d) **Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia** fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).

OH

- e) **Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti** dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

<del>Lotto n. 1 - CIG 0553102235</del>	<del>€ 0,00</del>
Lotto n. 2 - CIG 0553107654	€ 70,00
Lotto n. 3 - CIG 0553108727	€ 40,00
<del>Lotto n. 4 - CIG 0553115CEC</del>	<del>€ 40,00</del>
<del>Lotto n. 5 - CIG 0553116DBF</del>	<del>€ 0,00</del>

OH

- ⇒ nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- ⇒ nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- ⇒ solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

- f) **Dichiarazione (Allegato E1)**, debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissioni sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale.

OH

- g) **Dichiarazione (Allegato E2)** di aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico di fornitura (Allegato sez. A), del Capitolato Speciale (Allegato sez. B), della Convenzione di fornitura tra la Centrale di Acquisto e l'aggiudicatario (Allegato sez. C) e dei relativi allegati - scaricabili dal sito internet [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) - accettando incondizionatamente gli stessi in ogni loro parte.

OH

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per accettazione:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.

OH

OH

OH

h) Elenco dei lotti per i quali viene presentata offerta

LOTTO 2
LOTTO 3

OL

i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.

OL

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a), b), d), e), f), g), h), i) sarà motivo di esclusione dalla gara. Per quanto riguarda il punto e), oltre alla mancanza di tale attestazione, anche l'inesattezza dell'importo versato e/o del CIG indicato è motivo di esclusione dalla gara.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di "Sistemi antidecubito" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre – Lotti n. 5.

### Verifica documentazione amministrativa

**DITTA:** OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO

**a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (All. F1).**

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive.

OK

**b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto del Lotto.**

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

OK

**c) Certificazione di qualità** conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

Lotto	Importo della garanzia 2% (punto b) €	Importo della garanzia 1% (punto c) €
LOTTO 1	276,96	138,48
LOTTO 2	20.877,59	10.438,79
LOTTO 3	13.642,40	6.821,2
LOTTO 4	12.413,12	6.206,562
LOTTO 5	1.690,00	845,00

OK

OK

OK

Contratto Regionale di Acquisto

- d) **Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria** per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).

04

- e) **Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti** dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto n. 1 – CIG 0553102235	€ 0,00
Lotto n. 2 – CIG 0553107654	€ 70,00
Lotto n. 3 – CIG 0553108727	€ 40,00
<del>Lotto n. 4 – CIG 0553115CEG</del>	<del>€ 40,00</del>
<del>Lotto n. 5 – CIG 0553116DBE</del>	<del>€ 0,00</del>

04

- ⇒ nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- ⇒ nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- ⇒ solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

- f) **Dichiarazione (Allegato E1)**, debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale.

04

- g) **Dichiarazione (Allegato E2)** di aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico di fornitura (Allegato sez. A), del Capitolato Speciale (Allegato sez. B), della Convenzione di fornitura tra la Centrale di Acquisto e l'aggiudicatario (Allegato sez. C) e dei relativi allegati - scaricabili dal sito internet [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) - accettando incondizionatamente gli stessi in ogni loro parte.

04

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per accettazione:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.

Consorzio Centrale Regionale di Acquisto

## h) Elenco dei lotti per i quali viene presentata offerta

LOTTO 1
LOTTO 2
LOTTO 3

OM

## i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.

04

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a), b), d), e), f), g), h), i) sarà motivo di esclusione dalla gara. Per quanto riguarda il punto e), oltre alla mancanza di tale attestazione, anche l'inesattezza dell'importo versato e/o del CIG indicato è motivo di esclusione dalla gara.



Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di "Sistemi antidecubito" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre - Lotti n. 5.

### Verifica documentazione amministrativa

**DITTA: SANITARIA SCALIGERA S.r.l**

**a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (All. F1).**

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive.

OM

**b) Garanzia a corredo dell'offerta**, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto del Lotto.

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

OL

**c) Certificazione di qualità** conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

NON

NECESSARIA

Lotto	Importo della garanzia 2% (punto b) €	Importo della garanzia 1% (punto c) €
LOTTO 1	276,96	138,48
LOTTO 2	20.877,59	10.438,79
LOTTO 3	13.642,40	6.821,2
LOTTO 4	12.413,12	6.206,562
LOTTO 5	1.690,00	845,00

RS

SS  
MY

- d) **Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia** fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).

OK

- e) **Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti** dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

<del>Lotto n. 1 - CIG 0553102235</del>	<del>€. 0,00</del>
Lotto n. 2 - CIG 0553107654	€. 70,00
Lotto n. 3 - CIG 0553108727	€. 40,00
Lotto n. 4 - CIG 0553115CEC	€. 40,00
Lotto n. 5 - CIG 0553116DBF	€. 0,00

OK

- ⇒ nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- ⇒ nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- ⇒ solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

- f) **Dichiarazione (Allegato E1)**, debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale.

OK

- g) **Dichiarazione (Allegato E2)** di aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico di fornitura (Allegato sez. A), del Capitolato Speciale (Allegato sez. B), della Convenzione di fornitura tra la Centrale di Acquisto e l'aggiudicatario (Allegato sez. C) e dei relativi allegati - scaricabili dal sito internet [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) - accettando incondizionatamente gli stessi in ogni loro parte.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per accettazione:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.

OK

PB

SS

PB

## h) Elenco dei lotti per i quali viene presentata offerta


LOTTO 2
LOTTO 3
LOTTO 4
LOTTO 5

04

## i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.

04

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a), b), d), e), f), g), h), i) sarà motivo di esclusione dalla gara. Per quanto riguarda il punto e), oltre alla mancanza di tale attestazione, anche l'inesattezza dell'importo versato e/o del CIG indicato è motivo di esclusione dalla gara.


Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di "Sistemi antidecubito" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre – Lotti n. 5.

### Verifica documentazione amministrativa

**DITTA: REHA – Istituto Tecnico Ortopedico**

**a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (All. F1).**

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive.

OK

**b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto del Lotto.**

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

OK

**c) Certificazione di qualità** conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

OK

Lotto	Importo della garanzia 2% (punto b) €	Importo della garanzia 1% (punto c) €
<del>LOTTO 1</del>	<del>276,98</del>	<del>138,48</del>
LOTTO 2	20.877,59	10.438,79
<del>LOTTO 3</del>	<del>13.642,40</del>	<del>6.821,2</del>
LOTTO 4	12.413,12	6.206,562
<del>LOTTO 5</del>	<del>1.690,00</del>	<del>845,00</del>

RS

SS

MA

## Centrale Regionale di Acquisto

- d) **Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia** fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).

OK

- e) **Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti** dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

<del>Lotto n. 1 - CIG 0553102235</del>	<del>€. 0,00</del>
<del>Lotto n. 2 - CIG 0553107654</del>	<del>€. 70,00</del>
<del>Lotto n. 3 - CIG 0553108727</del>	<del>€. 40,00</del>
<del>Lotto n. 4 - CIG 0553115CEC</del>	<del>€. 40,00</del>
<del>Lotto n. 5 - CIG 0553116DBF</del>	<del>€. 0,00</del>

OK

- ⇒ nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- ⇒ nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- ⇒ solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

- f) **Dichiarazione (Allegato E1)**, debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale.

OK

- g) **Dichiarazione (Allegato E2)** di aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico di fornitura (Allegato sez. A), del Capitolato Speciale (Allegato sez. B), della Convenzione di fornitura tra la Centrale di Acquisto e l'aggiudicatario (Allegato sez. C) e dei relativi allegati - scaricabili dal sito internet [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) - accettando incondizionatamente gli stessi in ogni loro parte.

OK

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per accettazione:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.

RS

SS

MA

Consorzio Centrale Regionale di Acquisto

h) Elenco dei lotti per i quali viene presentata offerta

LOTTO 2
LOTTO 4

OU

i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.

OU

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a), b), d), e), f), g), h), i) sarà motivo di esclusione dalla gara. Per quanto riguarda il punto e), oltre alla mancanza di tale attestazione, anche l'inesattezza dell'importo versato e/o del CIG indicato è motivo di esclusione dalla gara.

RS

SS

MA

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di "Sistemi antidecubito" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre – Lotti n. 5.

### Verifica documentazione amministrativa

DITTA: KCI Medical S.r.l

**a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (All. F1).**

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive.

OK

**b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto del Lotto.**

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

OK

**c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:**

NON  
RICHIEDO

Lotto	Importo della garanzia 2% (punto b) €	Importo della garanzia 1% (punto c) €
LOTTO 1	276,96	138,48
LOTTO 2	20.877,59	10.438,79
LOTTO 3	13.642,40	6.821,2
LOTTO 4	12.413,12	6.206,562
LOTTO 5	1.690,00	845,00

OK

OK

OK

## Centrale Regionale di Acquisto

- d) **Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria** per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).

OK

- e) **Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti** dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

<b>Lotto n. 1 – CIG 0553102235</b>	<b>€. 0,00</b>
<b>Lotto n. 2 – CIG 0553107654</b>	<b>€. 70,00</b>
<b>Lotto n. 3 – CIG 0553108727</b>	<b>€. 40,00</b>
<b>Lotto n. 4 – CIG 0553115CEC</b>	<b>€. 40,00</b>
<b>Lotto n. 5 – CIG 0553116DBF</b>	<b>€. 0,00</b>

OK

- nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

- f) **Dichiarazione (Allegato E1)**, debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale.

OK

- g) **Dichiarazione (Allegato E2)** di aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico di fornitura (Allegato sez. A), del Capitolato Speciale (Allegato sez. B), della Convenzione di fornitura tra la Centrale di Acquisto e l'aggiudicatario (Allegato sez. C) e dei relativi allegati - scaricabili dal sito internet [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) - accettando incondizionatamente gli stessi in ogni loro parte.

OK

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per accettazione:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.

PB

SS

PM

Consorzio Regionale di Acquisti

h) Elenco dei lotti per i quali viene presentata offerta

LOTTO	2
LOTTO	3
LOTTO	4
LOTTO	5

04

i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.

04

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a), b), d), e), f), g), h), i) sarà motivo di esclusione dalla gara. Per quanto riguarda il punto e), oltre alla mancanza di tale attestazione, anche l'inesattezza dell'importo versato e/o del CIG indicato è motivo di esclusione dalla gara.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di "Sistemi antidecubito" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre – Lotti n. 5 .

### Verifica documentazione amministrativa

DITTA: Hill- Rom S.p.A.

**a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (All. F1).**

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive.

OK

**b) Garanzia a corredo dell'offerta**, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto del Lotto.

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

OK

**c) Certificazione di qualità** conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:

OK

Lotto	Importo della garanzia 2% (punto b) €	Importo della garanzia 1% (punto c) €
LOTTO 1	276,96	138,48
LOTTO 2	20.877,59	10.438,79
LOTTO 3	13.642,40	6.821,2
LOTTO 4	12.413,12	6.206,562
LOTTO 5	1.690,00	845,00

OK

OK

OK

## Centrale Regionale di Acquisto

- d) **Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia** fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).

OK

- e) **Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti** dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto n. 1 – CIG 0553102235	€. 0,00
Lotto n. 2 – CIG 0553107654	€. 70,00
Lotto n. 3 – CIG 0553108727	€. 40,00
Lotto n. 4 – CIG 0553115CEC	€. 40,00
Lotto n. 5 – CIG 0553116DBF	€. 0,00

OK

- ⇒ nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- ⇒ nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- ⇒ solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

- f) **Dichiarazione (Allegato E1)**, debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale.

OK

- g) **Dichiarazione (Allegato E2)** di aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico di fornitura (Allegato sez. A), del Capitolato Speciale (Allegato sez. B), della Convenzione di fornitura tra la Centrale di Acquisto e l'aggiudicatario (Allegato sez. C) e dei relativi allegati - scaricabili dal sito internet [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) - accettando incondizionatamente gli stessi in ogni loro parte.

OK

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per accettazione:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.

OK

SS  
MY

Centrale Regionale di Acquisto

h) Elenco dei lotti per i quali viene presentata offerta


LOTTO 1
LOTTO 2
LOTTO 3
LOTTO 4
LOTTO 5

OK

i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.

OK

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a), b), d), e), f), g), h), i) sarà motivo di esclusione dalla gara. Per quanto riguarda il punto e), oltre alla mancanza di tale attestazione, anche l'inesattezza dell'importo versato e/o del CIG indicato è motivo di esclusione dalla gara.





Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di "Sistemi antidecubito" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre - Lotti n. 5.

### Verifica documentazione amministrativa

DITTA: **Medic Air S.r.l**

**a) Istanza di partecipazione a gara, come da modello allegato (All. F1).**

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata, pena esclusione, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive.

OK

**b) Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e quantificata nella misura del 2% (due per cento) dell'importo presunto del Lotto.**

La garanzia deve prevedere, pena nullità, quanto dettato dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, comma 4.

La garanzia sarà restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione, ed all'aggiudicatario, dopo che avrà presentato il deposito cauzionale definitivo.

OK

**c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme all'originale di detta certificazione, ovvero dichiarazione di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta come di seguito specificato:**

Lotto	Importo della garanzia 2% (punto b) €	Importo della garanzia 1% (punto c) €
LOTTO 1	<del>276,86</del>	<del>138,48</del>
LOTTO 2	20.877,59	10.438,79
LOTTO 3	13.642,40	6.821,2
LOTTO 4	12.413,12	6.206,562
LOTTO 5	1.690,00	845,00

OK

OK

OK

OK

Centro Regionale di Acquisto

- d) **Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria** per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).

OK

- e) **Attestazione comprovante il versamento del contributo sugli appalti** dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto n. 1 – CIG 0553102235	€ 0,00
Lotto n. 2 – CIG 0553107654	€ 70,00
Lotto n. 3 – CIG 0553108727	€ 40,00
Lotto n. 4 – CIG 0553115CEC	€ 40,00
Lotto n. 5 – CIG 0553146DBF	€ 0,00

OK

- ⇒ nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;
- ⇒ nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
- ⇒ solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

- f) **Dichiarazione (Allegato E1)**, debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti, previo parere favorevole della Centrale.

OK

- g) **Dichiarazione (Allegato E2)** di aver preso visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico di fornitura (Allegato sez. A), del Capitolato Speciale (Allegato sez. B), della Convenzione di fornitura tra la Centrale di Acquisto e l'aggiudicatario (Allegato sez. C) e dei relativi allegati - scaricabili dal sito internet [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) - accettando incondizionatamente gli stessi in ogni loro parte.

OK

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per accettazione:

- in caso di partecipazione singola: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;
- in caso di partecipazione in ATI già costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa Capogruppo;
- in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri di ciascuna Impresa offerente.

OK

OK

OK

Centrale Regionale di Acquisto

**h) Elenco dei lotti per i quali viene presentata offerta**

LOTTO 2
LOTTO 3
LOTTO 4

*OK*

**i) Scheda fornitore (Allegato F3) debitamente compilata e firmata.**

*OK*

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a), b), d), e), f), g), h), i) sarà motivo di esclusione dalla gara. Per quanto riguarda il punto e), oltre alla mancanza di tale attestazione, anche l'inesattezza dell'importo versato e/o del CIG indicato è motivo di esclusione dalla gara.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## **ALLEGATO N. 2**

ALLA DELIBERAZIONE N. 84 DEL 22/12/2011

### **Verbale per la verifica della documentazione tecnica e della campionatura ai fini della assegnazione dei punteggi del 12/10/2011**

# CRA

Consorzio Regionale di Acquisti

Dirigente Responsabile: Dott. Ssa Silvia SIMONETTI tel. 010/4102214

e-mail: [silvia\\_simonetti@villasgassi.it](mailto:silvia_simonetti@villasgassi.it)

Funzionario referente: Dott.ssa Paola BURLANDO tel. 010/4102577


e-mail: [paola\\_burlando@villasgassi.it](mailto:paola_burlando@villasgassi.it)

REGIONE LIGURIA  
Consorzio  
Centrale Regionale Acquisti

REGISTRO UFFICIALE

Protocollo n. 1446

del 12/10/2011



Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di "Sistemi antidecubito" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre - Lotti n. 5.

Verbale delle sedute svoltesi il 16/02/2011, 02/03/2011, 21/03/2011, 07/04/2011 e del 12/10/2011 per la verifica della documentazione presentata ai fini della assegnazione dei punteggi relativamente al parametro qualità e delle sedute del 14/06/2011 e del 26/07/2011 per la campionatura dei prodotti offerti.

I giorni 16/02/2011, 02/03/2011, 21/03/2011, 07/04/2011 e 12/10/2011 si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con deliberazione n. 12 del 20/01/2011 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la verifica della documentazione presentata dalle Ditte concorrenti ai fini dell'accertamento dei requisiti minimi essenziali e per l'assegnazione dei punteggi relativamente ai parametri della qualità. Sono stati presenti i Signori:

- **Dott. Antonino MASSONE** - Direttore dell'Unità Spinale dell' Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ASL 2 Savonese – **Presidente**;
- **Dott. Giovanni A. CHECCHIA** - Direttore S.C. RRF Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ASL 2 Savonese – **Componente**;
- **Sig.ra Deborah GRANARA** – Infermiere Specializzato in Wound Care N.O. Lesioni Cutanee, ASL 3 Genovese – **Componente**;

Erano presenti altresì la dr.ssa Silvia Simonetti, dirigente della Centrale e la dr.ssa Paola Burlando, funzionario della Centrale, con funzioni alternativemente di segretario della Commissione e il Sig. Roberto Boretti, Assistente Amm.vo della Centrale.

Le sedute non sono state pubbliche.

La Commissione Giudicatrice ha dato preliminarmente atto

- che il 14/12/2010, alle ore 10.00 presso la Sala riunioni dell'Ospedale Villa Scassi (Palazzina Uffici Amministrativi), si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara della Centrale Regionale di Acquisti composto dalla Dott.ssa Silvia Simonetti, Dirigente Responsabile della Centrale, in qualità di Presidente, dalla Dott.ssa Paola Burlando in qualità di Componente e dal sig. Roberto Boretti in qualità di Segretario, per la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti;
- che sono state ammesse al prosieguo della procedura tutte le ditte concorrenti, così come indicato nel verbale redatto nella suddetta seduta del 14/12/2010, prot. n. 1252;
- che la Ditta Ricordini Pietro, sorteggiata ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e informata con nota prot. n. 1247 del 14/12/2010 dell'esito del sorteggio, ha prodotto la documentazione richiesta pena esclusione dal disciplinare di gara, acquisita agli atti con prot. n. 1289 del 23/12/2010 e cioè:
  - estratto dei bilanci dal quale si evinca il fatturato degli esercizi 2007-2008-2009;
  - documentazione probatoria relativa alle principali forniture eseguite negli ultimi tre anni 2007-2008-2009

In considerazione del positivo assolvimento degli adempimenti amministrativi la Commissione ha deciso di passare all'esame della documentazione tecnica.

Per comodità di procedura il Segretario ha riassunto ai Commissari lo stato delle offerte pervenute, lotto per lotto, così come esse risultano dalle istanze di partecipazione e come riassunto nella tabella seguente.

SS

Ditta	Lotti per i quali la Ditta presenta offerta
RICORDINI PIETRO di Ricordini Mauro & C. S.r.l.	2, 3, 4
T.S.S. S.r.l.	2, 3
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	1, 2, 3
SANITARIA SCALIGERA S.r.l.	2, 3, 4, 5
REHA - Istituto Tecnico Ortopedico	2, 4
ATI KCI Medical S.r.l. Vivisol	2, 3, 4, 5
Hill- Rom S.p.A.	1, 2, 3, 4, 5
Medic Air S.r.l.	2, 3, 4

La Commissione ha preso atto che il Disciplinare di gara e relativi allegati (Capitolato tecnico e Capitolato Speciale) prevedevano che la procedura venisse esperita con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponderando perciò l'elemento prezzo con i parametri di qualità definiti in sede di capitolato tecnico e che ai parametri di qualità sono assegnati in ogni lotto **50 punti**.

La Commissione ha stabilito la procedura da seguire all'apertura dei plichi sigillati

- il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità dei plichi pervenuti procederà ad aprire gli stessi;
- verrà accertato che in tutti i plichi (**Busta 3**) sia presente la documentazione indispensabile, pena esclusione, richiesta nel Disciplinare di Gara. In mancanza di tale documentazione non si procederà alla valutazione degli item di punteggio e alla campionatura;
- verrà verificata la presenza di tutti i requisiti tecnici minimi pena esclusione. In assenza anche di uno solo dei requisiti minimi non si procederà alla valutazione degli item di punteggio e alla campionatura;
- si passerà quindi ad esaminare la documentazione tecnica presentata da ciascuna ditta (**Busta 3**) concorrente per ciascun lotto al fine di attribuire il punteggio qualitativo;
- si procederà alla campionatura dei prodotti offerti da ciascuna Ditta mediante l'allestimento dei sistemi presso dall'Unità Spinale dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure;
- verrà determinato, alla fine della valutazione tecnica della documentazione di ogni lotto, il punteggio ottenuto da ciascuna mediante la sommatoria dei punti attribuiti per singolo item qualitativo.

La Commissione nella data del **16/02/2011** ha proceduto preliminarmente all'esame della documentazione indispensabile prevista dal Disciplinare di gara, le cui risultanze sono riepilogate nell'**Allegato 1** al presente verbale.

Nella data del **02/03/2011** la Commissione ha proceduto alla verifica dei requisiti tecnici minimi pena esclusione dalla quale ed è emerso che sono escluse le offerte delle seguenti ditte per i lotti indicati con le allegate motivazioni.

Lotto	Ditta	Motivazione
Lotto 1	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	a) Altezza del materasso inferiore ai 15 cm richiesti b) Non è provata la capacità del presidio di adeguare in modo automatico le pressioni da contatto in base al peso e alla postura del paziente.
Lotto 2	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	a) Il certificato secondo la classe 1 rispetto alla resistenza al fuoco presentato non include la certificazione 1 IM, l'unica certificazione prodotta riguarda solo la cover. Suddetta certificazione è dichiarata dalla ditta ma non supportata da idonea certificazione b) Assenza della dichiarazione che i sistemi siano in regola coi DM Min. Sal. 20/02/2007 e del 21/12/2009 c) Assenza della dichiarazione di conformità alle norme CEI 62-5 (II-III edizione). d) Assenza della dichiarazione del basso consumo energetico.

Lotto 3	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	<p>a) Il certificato secondo la classe 1 rispetto alla resistenza al fuoco presentato non include la certificazione 1 IM, l'unica certificazione prodotta riguarda solo la cover. Suddetta certificazione è dichiarata dalla ditta ma non supportata da idonea certificazione.</p> <p>b) Assenza della dichiarazione che i sistemi siano in regola col DM. Min. Sal. 20/02/2007 e del 21/12/2009.</p> <p>c) Assenza della dichiarazione di conformità alle norme CEI 62-5 (II-III edizione).</p> <p>d) Assenza della dichiarazione del basso consumo energetico.</p>
	MEDIC AIR S.R.L.	Il presidio offerto non risponde alla caratteristica richiesta per il lotto 3 "Bassa pressione alternata/fluttuazione dinamica".
Lotto 4	MEDIC AIR S.R.L.	Non si evince dalla documentazione tecnica fornita la possibilità, in modo adeguato, di gestire la macerazione cutanea in pazienti ad altissimo rischio.
Lotto 5	SANITARIA SCALIGERA S.R.L.	Il prodotto offerto non risponde ai requisiti minimi richiesti, non è un "reale cessione d'aria".
	HILL- ROM S.P.A.	Il prodotto offerto non risponde ai requisiti minimi richiesti, non è un "reale cessione d'aria".

La Commissione nelle date del **21/03/2011** e del **07/04/2011** ha proceduto ad esaminare la documentazione tecnica presentata da ciascuna Ditta (Busta 3) concorrente per ciascun lotto al fine di attribuire il punteggio qualitativo.

Nella data del **14/06/2011**, presso i locali appositamente predisposti dall'Unità Spinale dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, la Commissione Giudicatrice, coadiuvata dalla dr.ssa Silvia Simonetti, dirigente della Centrale, che svolgeva le funzioni di segretario e dal Sig. Roberto Boretti Assistente Amm.vo della Centrale, ha convocato le Ditte SANITARIA SCALIGERA S.R.L. ATI, KCI MEDICAL S.r.l. - VIVISOL (ATI) e RICORDINI PIETRO di Ricordini Mauro & C. S.r.l. ed ha proceduto alle prove pratiche dei campioni dei prodotti che hanno superato positivamente la verifica dei requisiti minimi pena esclusione.

Successivamente la stazione appaltante, nell'espletamento dei suoi poteri di verifica e controllo, ha constatato l'assenza di un requisito minimo pena esclusione per l'offerta della Ditta Medic Air S.r.l. nello specifico a pg. 31 del progetto è indicata una cadenza di sanificazione dei materassi a noleggio quadrimestrale, mentre il capitolato prevedeva come requisito minimo pena esclusione una sanificazione a cadenza trimestrale.

La Commissione Giudicatrice, preso atto della segnalazione della Stazione Appaltante, stabilisce di escludere la Ditta Medic Air S.r.l. dal prosieguo della gara e pertanto di non procedere alla prevista campionatura.

Nella data del **26/07/2011** presso i locali appositamente predisposti dall'Unità Spinale dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e la Commissione Giudicatrice, coadiuvata dalla dr.ssa Silvia Simonetti, dirigente della Centrale, che svolgeva le funzioni di segretario e dal Sig. Roberto Boretti Assistente Amm.vo della Centrale, ha convocato le Ditte T.S.S. S.r.l., REHA - Istituto Tecnico Ortopedico e HILL- ROM S.p.A. e ha proceduto alle prove pratiche dei campioni dei prodotti che hanno superato positivamente la verifica dei requisiti minimi pena esclusione.

Sono state inoltre riconvocate le Ditte SANITARIA SCALIGERA S.R.L. ATI, KCI MEDICAL S.r.l. - VIVISOL (ATI) e RICORDINI PIETRO di Ricordini Mauro & C. S.r.l. per un'ulteriore verifica tecnica sul Lotto 4.

In data **29/09/2011** il Dr. Massone e il Dr. Checchia si sono incontrati presso la Centrale Regionale di acquisto al fine di effettuare un'ulteriore verifica della documentazione tecnica di gara. Le risultanze della suddetta verifica verranno sottoposte alla Commissione del 12/10/2011 per la disamina e l'approvazione.

In data **12/10/2011** la Commissione al completo si è riunita presso l'Unità Spinale di Santa Corona per una revisione globale della documentazione tecnica analizzata e dei risultati delle prove effettuate nelle precedenti sedute. Alla fine dei lavori, concordemente ha stilato la tabella di cui agli **allegati 2 e 3** contenenti rispettivamente i punteggi assegnati a ciascuna Ditta per il servizio e i punteggi assegnati per ciascun lotto offerto.

Le risultanze dell'attribuzione del punteggio di qualità sono riepilogate nella tabella che segue:

Ditte	Lotto 1		Lotto 2		Lotto 3		Lotto 4		Lotto 5	
	P.ti	Ammissa								
RICORDINI PIETRO DI RICORDINI MAURO & C. S.R.L.			27,42	SI	28,15	SI	24,48	NO	/	/
T.S.S. S.R.L.			21,92	NO	21,10	NO	/	/	/	/
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	/	/	/	/
SANITARIA SCALIGERA S.R.L.			31,63	SI	28,98	SI	28,78	SI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI
REHA - ISTITUTO TECNICO ORTOPEDICO			22,76	NO	/	/	22,45	NO	/	/
ATI KCI MEDICAL S.R.L. - VIVISOL			37,22	SI	44,70	SI	43,73	SI	46,50	SI
HILL- ROM S.P.A.	42,90	SI	38,26	SI	39,04	SI	38,55	SI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI
MEDIC AIR S.R.L.			N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	/	/

La Commissione ha stabilito di convocare la seduta per l'apertura delle offerte economiche per il giorno 02/11/2011 e ha dato mandato agli uffici della Centrale Acquisti di darne formale comunicazione alle ditte offerenti.

Letto, confermato e sottoscritto:

• **Presidente:**

Dott. Antonino MASSONE

• **Componenti:**

Dott. Giovanni A. CHECCHIA






Sig.ra Deborah GRANARA

• **Segretario per le sedute del 16/02/11, 02/03/11, 21/03/11, 07/04/11, 12/10/11:**

Dott.ssa Paola BURLANDO

• **Segretario per le sedute del 14/06/11 e del 26/07/11:**

Dott.ssa Silvia SIMONETTI

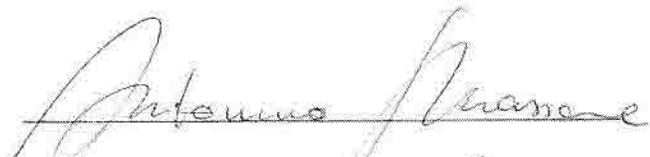
  
  
  
  


## Allegato 1

Schede di rilevazione della documentazione tecnica  
prevista dal Disciplinare di gara




  
Sede operativa

SS

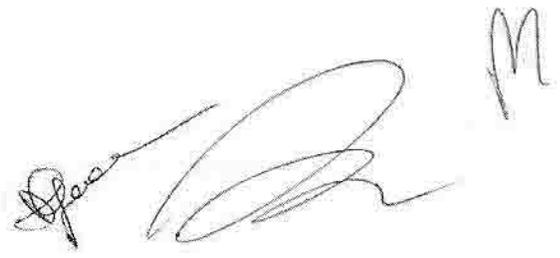 M


Ditta: RICORDINI PIETRO DI RICORDINI MAURO &amp; C. S.R.L


Nome prodotto	Alpha Response	Auto Logic	Nimbus 3
<i>Requisiti minimi di ammissione</i>	<i>Lotto 2</i>	<i>Lotto 3</i>	<i>Lotto 4</i>
<b>scheda informativa</b> in lingua italiana dei prodotti offerti con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della ditta. La scheda andrà redatta sulla base del fac-simile previsto all'allegato F4 la scheda dovrà riportare, pena esclusione, il nome del prodotto, i codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 relativo alle "Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art. 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi"	OK	OK	OK
<b>scheda tecnica del produttore/commercializzatore, catalogo illustrato</b> , senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, dépliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara. Il punteggio di qualità sarà attribuito in base alle informazioni riportate nella scheda informativa e nella documentazione tecnica di cui al presente punto.	OK	OK	OK
<b>copia della certificazione CE</b> relativamente ai sistemi antidecubito (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42;	OK	OK	OK
<b>dichiarazione di impegno</b> a prestare assistenza tecnica, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati nel Capitolato Speciale sez. B;	OK	OK	OK
<b>modalità di manutenzione</b> correttiva ordinaria e straordinaria;	OK	OK	OK
<b>dichiarazione di presa visione dei DUVRI</b> delle Aziende pubblicati sul sito;	OK	OK	OK
<b>dichiarazione</b> , se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono <b>segreti tecnici o commerciali</b> , pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;	assente	assente	assente

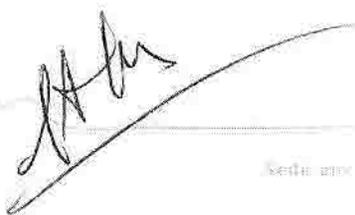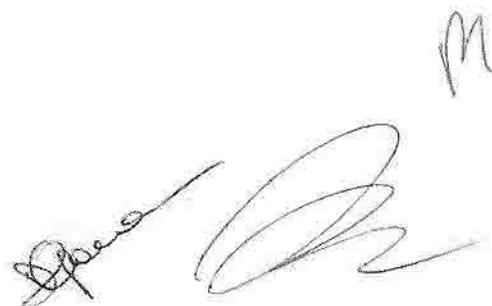Ditta: T.S.S. SRL


Nome prodotto	Sistema Dual/Revo Lotto 2	Sistema Dual Lotto 3
<b>Requisiti minimi di ammissione</b>		
<b>scheda informativa</b> in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della ditta. La scheda andrà redatta sulla base del fac-simile previsto all'allegato F4; la scheda dovrà riportare, pena esclusione, il nome del prodotto, i codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 relativo alle "Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi"	OK	OK
<b>scheda tecnica del produttore/commercializzatore, catalogo illustrato</b> , senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, dépliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara. Il punteggio di qualità sarà attribuito in base alle informazioni riportate nella scheda informativa e nella documentazione tecnica di cui al presente punto.	OK	OK
<b>copia della certificazione CE</b> relativamente ai sistemi antidecubito(qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42;	OK	OK
<b>dichiarazione di impegno</b> a prestare assistenza tecnica, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati nel Capitolato Speciale sez. B;	OK	OK
<b>modalità di manutenzione</b> correttiva ordinaria e straordinaria;	OK	OK
<b>dichiarazione di presa visione</b> dei DUVRI delle Aziende pubblicati sul sito;	OK	OK
<b>dichiarazione</b> , se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono <b>segreti tecnici o commerciali</b> , pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;	assente	assente




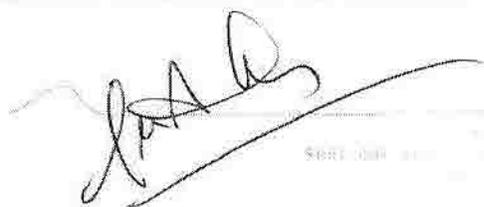

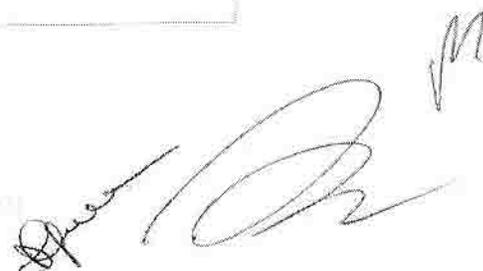Ditta: OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO


Nome prodotto	KM20	DEVICARE K10	DEVICARE K20
<i>Requisiti minimi di ammissione</i>	<i>Lotto 1</i>	<i>Lotto 2</i>	<i>Lotto 3</i>
<b>scheda informativa</b> in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della ditta. La scheda andrà redatta sulla base del fac-simile previsto all'allegato F4; la scheda dovrà riportare, pena esclusione, il nome del prodotto, i codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 relativo alle "Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi"	OK	OK	OK
<b>scheda tecnica del produttore/commercializzatore, catalogo illustrato</b> , senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, dépliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara. Il punteggio di qualità sarà attribuito in base alle informazioni riportate nella scheda informativa e nella documentazione tecnica di cui al presente punto.	OK	OK	OK
<b>copia della certificazione CE</b> relativamente ai sistemi antidecubito (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42;	OK	OK	OK
<b>dichiarazione di impegno</b> a prestare assistenza tecnica, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati nel Capitolato Speciale sez. B;	OK	OK	OK
<b>modalità di manutenzione</b> correttiva ordinaria e straordinaria;	OK	OK	OK
<b>dichiarazione di presa visione dei DUVRI</b> delle Aziende pubblicati sul sito;	OK	OK	OK
<b>dichiarazione</b> , se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono <b>segreti tecnici o commerciali</b> , pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;	OK	OK	OK

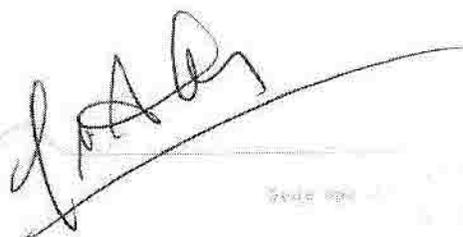

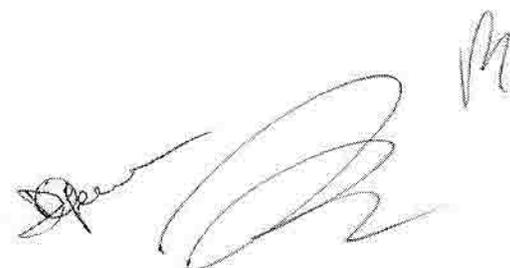

Ditta: **SANITARIA SCALIGERA S.R.L.**

Nome prodotto	PULSAR CHOICE MR	QUATTRO PLUS	QUATTRO ACUTE	SOFTECH 3000 NOKT
<i>Requisiti minimi di ammissione</i>	<i>Lotto 2</i>	<i>Lotto 3</i>	<i>Lotto 4</i>	<i>Lotto 5</i>
<b>scheda informativa</b> in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della ditta. La scheda andrà redatta sulla base del fac-simile previsto all'allegato F4; la scheda dovrà riportare, pena esclusione, il nome del prodotto, i codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 relativo alle " Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi "	OK	OK	OK	OK
<b>scheda tecnica del produttore/commercializzatore, catalogo illustrato</b> , senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, dépliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara. Il punteggio di qualità sarà attribuito in base alle informazioni riportate nella scheda informativa e nella documentazione tecnica di cui al presente punto.	OK	OK	OK	OK
<b>copia della certificazione CE</b> relativamente ai sistemi antidecubito(qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42;	OK	OK	OK	no CE Presentata Dichiarazione
<b>dichiarazione di impegno</b> a prestare assistenza tecnica, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati nel Capitolato Speciale sez. B;	OK	OK	OK	OK
<b>modalità di manutenzione</b> correttiva ordinaria e straordinaria;	OK	OK	OK	OK
<b>dichiarazione di presa visione dei DUVRI</b> delle Aziende pubblicati sul sito;	OK	OK	OK	OK
<b>dichiarazione</b> , se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono <b>segreti tecnici o commerciali</b> , pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;	OK	OK	OK	OK


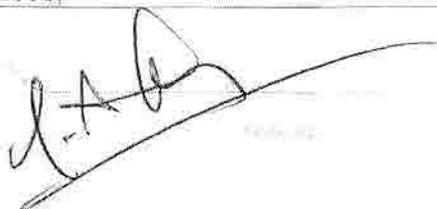





Ditta: RHEA – ISTITUTO TECNICO ORTOPEDICO

Nome prodotto	AIR EXPRESS P280DF	AUTO SURE FLOAT
<b>Requisiti minimi di ammissione</b>	Lotto 2	Lotto 4
<b>scheda informativa</b> in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della ditta. La scheda andrà redatta sulla base del fac-simile previsto all'allegato F4; la scheda dovrà riportare, pena esclusione, il nome del prodotto, i codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 relativo alle " Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi"	OK	OK
<b>scheda tecnica del produttore/commercializzatore, catalogo illustrato</b> , senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara dépliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara. Il punteggio di qualità sarà attribuito in base alle informazioni riportate nella scheda informativa e nella documentazione tecnica di cui al presente punto.	OK	OK
<b>copia della certificazione CE</b> relativamente ai sistemi antidecubito (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42.	no CE Presentata Dichiarazione	no CE Presentata Dichiarazione
<b>dichiarazione di impegno</b> a prestare assistenza tecnica in caso di aggiudicazione, nei termini indicati nel Capitolato Speciale sez. B.	OK	OK
<b>modalità di manutenzione</b> correttiva ordinaria e straordinaria;	OK	OK
<b>dichiarazione di presa visione dei DUVRI</b> delle Aziende pubblicati sul sito;	OK	OK
<b>dichiarazione</b> , se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono <b>segreti tecnici o commerciali</b> , pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;	no	no

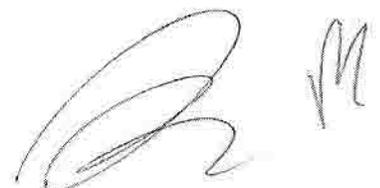


Ditta (ATI): KCI MEDICAL S.R.L. – VIVISOL

Nome prodotto	AIRWORKS II	INNOVA EXTRA O.L.	INNOVA EXTRA MRS	THERAKAIR VISIO
<i>Requisiti minimi di ammissione</i>	<i>Lotto 2</i>	<i>Lotto 3</i>	<i>Lotto 4</i>	<i>Lotto 5</i>
<b>scheda informativa</b> in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della ditta. La scheda andrà redatta sulla base del fac-simile previsto all'allegato F4; la scheda dovrà riportare, pena esclusione, il nome del prodotto, i codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 relativo alle " Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi "	OK	OK	OK	OK
<b>scheda tecnica del produttore/commercializzatore, catalogo illustrato</b> , senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, dépliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara. Il punteggio di qualità sarà attribuito in base alle informazioni riportate nella scheda informativa e nella documentazione tecnica di cui al presente punto.	OK	OK	OK	OK
<b>copia della certificazione CE</b> relativamente ai sistemi antidecubito(qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42;	OK	OK	OK	OK
<b>dichiarazione di impegno</b> a prestare assistenza tecnica, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati nel Capitolato Speciale sez. B;	OK	OK	OK	OK
<b>modalità di manutenzione</b> correttiva ordinaria e straordinaria;	OK	OK	OK	OK
<b>dichiarazione di presa visione</b> dei DUVRI delle Aziende pubblicati sul sito.	OK	OK	OK	OK
<b>dichiarazione</b> , se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono <b>segreti tecnici o commerciali</b> , pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D Lgs n. 163/2006.	OK	OK	OK	OK



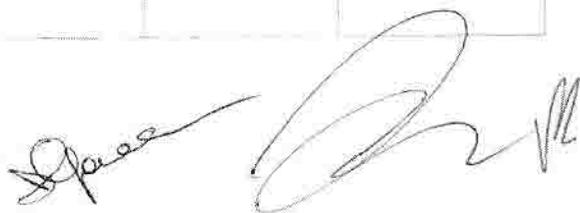

Ditta: HILL – ROM S.P.A.

Nome prodotto	P330 WOUND SURFACE	PRIMO	CLIN ACTIV PLUS	CLIN ACTIV PLUS MCM	CLIN ACTIV PLUS MCM
<i>Requisiti minimi di ammissione</i>	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5
<b>scheda informativa</b> in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della ditta. La scheda andrà redatta sulla base del fac-simile previsto all'allegato F4; la scheda dovrà riportare pena esclusione, il nome del prodotto, i codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 relativo alle "Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi"	OK	OK	OK	OK	OK
<b>scheda tecnica del produttore/commercializzatore, catalogo illustrato</b> , senza alcuna indicazione dei prezzi, dettagliato ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, dépliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara. Il punteggio di qualità sarà attribuito in base alle informazioni riportate nella scheda informativa e nella documentazione tecnica di cui al presente punto	OK	OK	OK	OK	OK
<b>copia della certificazione CE</b> relativamente ai sistemi antidecubito(qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42;	OK	OK	OK	OK	OK
<b>dichiarazione di impegno</b> a prestare assistenza tecnica, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati nel Capitolato Speciale sez. B;	OK	OK	OK	OK	OK
<b>modalità di manutenzione</b> correttiva ordinaria e straordinaria;	OK	OK	OK	OK	OK
<b>dichiarazione di presa visione dei DUVRI</b> delle Aziende pubblicati sul sito;	OK	OK	OK	OK	OK
<b>dichiarazione</b> , se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono <b>segreti tecnici o commerciali</b> , pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;	OK	OK	OK	OK	OK

Ditta **MEDIC AIR S.R.L.**


Nome prodotto	AIR SISTEM PRO III + COMPRESSORE AIR LOGIC	EURO GENIUS	EURO GENIUS
<i>Requisiti minimi di ammissione</i>	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4
<b>scheda informativa</b> in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro identificativo della ditta. La scheda andrà redatta sulla base del fac-simile previsto all'allegato F4; la scheda dovrà riportare: pena esclusione, il nome del prodotto, i codici di repertorio e CND ai sensi del decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007 relativo alle " Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art 13 del decreto 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. e per la registrazione nonché iscrizione nel "repertorio dei dispositivi "	OK	OK	OK
<b>scheda tecnica del produttore/commercializzatore, catalogo illustrato</b> , senza alcuna indicazione dei prezzi dettagliati ed aggiornato dei prodotti oggetto della gara, dépliant, copia della letteratura, documentazione scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni utili alla descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara. Il punteggio di qualità sarà attribuito in base alle informazioni riportate nella scheda informativa e nella documentazione tecnica di cui al presente punto	OK	OK	OK
<b>copia della certificazione CE</b> relativamente ai sistemi antidecubito(qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42;	no CE Presentata Dichiarazione	no CE Presentata Dichiarazione	no CE Presentata Dichiarazione
<b>dichiarazione di impegno</b> a prestare assistenza tecnica, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati nel Capitolato Speciale sez. B;	OK	OK	OK
<b>modalità di manutenzione</b> correttiva ordinaria e straordinaria;	OK	OK	OK
<b>dichiarazione di presa visione dei DUVRI</b> delle Aziende pubblicati sul sito;	OK	OK	OK
<b>dichiarazione</b> , se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono <b>segreti tecnici o commerciali</b> , pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;	OK	OK	OK






## Allegato 2

Schede di valutazione del servizio

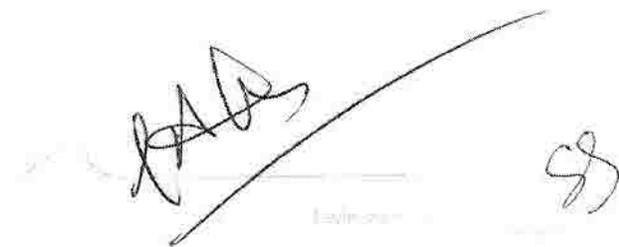

Handwritten signature and initials. The signature is written in black ink and appears to be 'AAS'. Below it is a horizontal line. To the right of the line are the initials 'SS'.

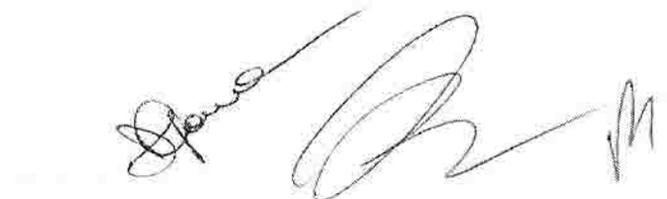

Handwritten signature and initials. The signature is written in black ink and appears to be 'G. P.'. To the right of the signature are the initials 'M'.

All. 2 Scheda riepilogativa valutazione servizio

Sub parametri	Punteggio max	RICORDINI	TSS	SANITARIA SCALIGERA	RHEA	ATI: KCI-VIVISOL	HILL ROM
		punteggio attribuito					
Sede/Distributore							
n° automezzi							
n° personale: funzione e tempo dedicato							
locazione centri di sanificazione							
aggiornamento personale n° ore							
n° verde	6,00	2,00	1,50	2,00	2,00	5,50	3,50
progetto di servizio ospedaliero							
possesso di certificazioni di qualità							
modalità sanificazione	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,50
presenza protocollo di sanificazione	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO (max punti 3)	3,00	1,50	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
MIGLIORIE (max punti 2)	2,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,00	1,90
<b>TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO</b>	<b>15,00</b>	<b>4,50</b>	<b>2,50</b>	<b>6,50</b>	<b>3,00</b>	<b>14,50</b>	<b>11,90</b>

Struttura organizzativa RICORDINI	Dati rilevati	NOTE	Punti max	Punteggio assegnato
Sede/Distributore n° automezzi	Genova 2 fiat Doblo	previsione aumento se vincono appalto, manca indicazione divisione sporco/pulito		5,00
n° personale, funzione e tempo dedicato, locazione centri di sanificazione	3 persone dedicate Liguria centro sanificazione stocaggio Genova non meno di 16/anno 2 corsi teorico pratici con modalità da concordarsi con D.S. e Uff. inf affiancamento durante installazione	numero inadeguato, previsione aumento se vincono appalto, manca indicazione contenuti		2,00
aggiornamento personale n° ore	interno osped	manca indicazione contenuti; manca il numero delle ore previsto per l'aggiornamento.		
n° verde	modalità richiesta tempistica consegna installazione collaudo tempistica dismissione	in attivazione con copertura ore ufficio		5,00
progetto di servizio ospedaliero	fax/web 12h sempre 8 per intensive 24h fax 24/24	il documento fa riferimento alla procedura n° 7 non presente agli atti il documento fa riferimento alla procedura n° 8 non presente agli atti		3,00
possesso di certificazioni di qualità	si	il progetto presenta incongruenza tra quanto indicato al punto 6-rap personale e quanto indicato nel paragrafo assistenza full risk il n° di celli 348/7607062 nel primo documento risulta attivo dalle 7 alle 24 nel secondo 24/24 riferisce assistenza entro 24h e non 8 nei gg festivi come invece richiesto dal capitolato		1,00
ASPETTI IGIENICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONI E SANITIZZAZIONE (max punti 4)	modalità sanificazione presentia protocollo di sanificazione	dall'analisi dei percorsi nello schema non è indicato il locale dove vengono collocati i sistemi, inoltre l'ingresso dello sporco e del pulito non sembrano diversificati; mancano i documenti di sanificazione. In sede di campionatura si è confermata la mancanza dei documenti di sanificazione e la commissione non ha potuto visionarli	3,00	1,00
INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO (max punti 3)	progetto di informatizzazione	La commissione non ha elementi di valutaz Non sono indicate neppure le eventuali maschere che possono consentire la valutazione del sistema, applicaz pratica e contenuti reportistica	3,00	1,50
MIGLIORIE (max punti 2)	studio prevalenza	Non è uno studio di prevalenza ma un audit effettuato da personale sanitario interno e non dalla ditta	2,00	-
<b>Totale punti</b>			<b>15,00</b>	<b>4,50</b>

Struttura organizzativa T.S.S.		Dati rilevati		NOTE	Punti max	Punteggio assegnato
Sede/Distributore	Ferentino (FR)					
n° personale: funzione e tempo dedicato	3 - distinzione sporco/pulito non dichiarato			numero inadeguato solo esplicitate mansioni per qualifica ma non il numero del personale		
locazione centri di sanificazione	Serravalle (Rep. San Marino)			indicazione generica di idoneità alle mansioni		
aggiornamento personale n° ore	non specificato 3 tipologie di addestramento: 3 ore illustrazione prodotto e servizio; 2 ore illustrazione utilizzo					
n° verde	SI					
progetto di servizio ospedaliero	telefonata e conferma con fax conforme al capitolato					6,00
possessione di certificazioni di qualità	6 ore migliorativi rispetto al capitolato			non si fa menzione del certificato di sanificazione e di sicurezza elettrica; controllo della sicurezza elettrica solo nel caso in cui vengono sostituite delle parti		1,50
modalità assistenza	telefonata e conferma con fax					
modalità sanificazione	SI			Dalla documentaz. non si evince un percorso ben dettagliato sporco-pulito. Mancano la planimetria dei percorsi e degli ambienti (non si comprende posizionam. griglie aspiratura etc.). Il procedim. descritto presenta le seguenti contraddizioni: relativi agli operatori sembra che mantengano gli stessi guanti per tutto il procedimento; non si capisce se ci sono operatori dedicati ad ogni parte del processo o se seguano il materasso. Per quanto riguarda la sanific. delle superfici di appoggio sembra che venga effettuata a fine giornata e non a fine di ciascun processo. La sanificaz. degli attrezzi avviene settimanali. I cuscini interni del materasso sembrano essere lavati solo a freddo e non in lavatrice; non si comprende come vengano trattati i panni non monouso. Non viene menzionata la pulizia delle parti interne del materasso (cuscini, sensori, etc.); le cover passano prima in asciugatore estrinseco e successivamente in zona di ventilazione naturale; non si ne comprende il motivo. Per questi motivi la commissione ha ritenuto che il processo di sanificaz. non dia sufficienti garanzie di igiene.		3,00
presenza protocollo di sanificazione	SI					1,00
progetto di informatizzazione				La commissione non ha elementi di valutaz. del software che pare non sia stato ancora predisposto. Nel documento si parla di demo solo dopo aggiudicazione. Non sono indicate neppure le eventuali mascherine che possono consentire la valutazione del sistema applicaz. pratica e contenuti reportistica		3,00
studio prevalenza	no			Non presente		2,00
<b>Totale punti</b>					<b>15,00</b>	<b>2,50</b>

*[Handwritten signature]*

Struttura organizzativa SANITARIA SCALIGERA	Dati rilevati	NOTE	Punti max	Punteggio assegnato
Sede/Distributore	Verona (sede centrale) 18 su territorio nazionale: presenza divisione, sporto pulito	il dato risale al 10/1/2005 non si conosce la dotazione attuale		
n° automezzi	20 su territorio nazionale	non si evince il n° di personale dedicato al servizio in Liguria. Si dichiara la qualifica OSA per tutto il personale addetto alla consegna/ritiro dei presidi ma all'allegato E si fa esplicito divieto movimentazione pazienti al personale no OSA.		
n° personale: funzione e tempo dedicato	Verona (sede centrale) Chiesina Uzzanese Savona Roma, Torino, San Marino, Palermo. Centri operativi autorizzati (Genova Caserta e Perugia)	Chiesina Uzzanese dovrebbe servire l'area Levante, Savona l'area Ponente i due centri hanno magazzino autonomo e personale dedicato (non si specifica numero personale e automezzi). Non sono chiare le condizioni di funzionamento dei Centri operativi autorizzati. Se la certificazione presentata riguarda anche il loro funzionamento		
aggiornamento personale n° ore	interno	non esplicitato		
n° verde	ospedaliero	a richiesta sul presidio aggiudicato si, 24/24	non indicato numero ore/docenti/programma	6,00
modalità richiesta	modalità richiesta	n° verde, fax, web per richiesta, dismissione installazione, ritiro e manutenzione	sistema GPRS per contatto personale. Centro di smistamento che individua il soggetto più vicino. Sistema computerizzato per ordini ecc.	
tempistica consegna, installazione, collaudo	tempistica consegna, installazione, collaudo	12h sempre 8 per intensive	conforme a capitolato <u>Contrario alla normativa su privacy: apposizione su nastro adesivo attaccato al presidio di NOME E COGNOME DEL PZ</u> conforme a capitolato.	
tempistica dismissione	tempistica dismissione	24h	conforme a capitolato.	
modalità assistenza	modalità assistenza	n° verde, fax, web per richiesta, dismissione installazione, ritiro e manutenzione	ampie modalità di richiesta tempistica conforme a capitolato.	
possesso di certificazioni di qualità	SI			
ASPETTI TECNICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONE E SANITIZZAZIONE (max punti 4)	modalità sanificazione	Il protocollo presenta diversi aspetti contraddittori: 1) i presidi vengono divisi in due categorie infetti (sacco rosso) e non (sacco giallo) e vengono trattati in modo differente i presidi a giudizio della commissione, devono essere trattati tutti allo stesso modo perché non sempre è dichiarata l'infezione. 2) mancano i criteri in base ai quali l'operatore decide se sanificare a caldo o a freddo. 3) non si evince come venga effettuata la prova di funzionamento del presidio, non si evince se il titolare che segue un processo di sanificazione differente e viene imbustato, venga assemblato al presidio e in che fase del processo. 4) alla mappa dei percorsi, sembra non essere la separazione sporco/pulito in fase di entrata/uscita per fine lavorazione. 5) manca il controllo/collaudo sulla parte elettrica a fine sanificazione. Tuttavia nel corso della prova pratica tale controllo risulta effettuato e comprovato da idonea documentazione. Per questi motivi la commissione ha ritenuto che il processo di sanificar non dia sufficienti garanzie di igiene.	3,00	
INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO (max punti 3)	presenza protocollo di sanificazione progetto di informatizzazione	SI	sistema GPRS per contatto personale. Centro di smistamento che individua il soggetto più vicino. Sistema computerizzato per ordini ecc.	3,00
MIGLIORIE (max punti 2)	studio prevalenza	SI	Il documento presentato non è un studio di prevalenza. Il documento presentato presenta le seguenti criticità: 1) nera elezione di dati che il programma può rilevare. 2) manca la parte progettuale e la metodica di rilevazione dei dati. 3) alcuni dati risultano non utilizzabili nella forma prevista dal progetto.	2,00
<b>Totale punti</b>				<b>15,00</b>
				<b>6,50</b>

1/15

Struttura organizzativa RHEA	Dati rilevati	NOTE	Punti max	Punteggio assegnato
Sede/Distributore	Mignanego (Ge) 21 su tutto il territorio nazionale 12 ivoce daily 7 ford transit, 1 opel movano, 1 fiat scudo, presenza divisione sporco pulito	non si evince quanti mezzi mettono a disposizione per appalto regione Liguria previsione aumento se vincono appalto	6,00	2,00
n° automezzi	18 per la Liguria?	non si evince se il personale segnalato è dedicato solo per il progetto Liguria		
n° personale: funzione e tempo dedicato	Attivole (TV) e Empoli (FI)	disponibilità in caso di aggiudicazione ad attrezzare la sede di Mignanego (GE) come quella di Attivole (TV)		
locazione centri di sanificazione	interno	non quantificato, non indicate ore formazione		
aggiornamento personale n° ore	osped	8 ore, 3 livelli formazione, corsi di 4 ore (su corrette indicazioni ai presidi); corsi 2 ore (illustrazione prodotto e gestione del servizio); corso 1 ora (addestramento continuo su utilizzo dei sistemi); corsi 1 ora semestrali su sistema informatico e funzionalità prodotti		
n° verde	SI: 24/24	manca indicazione programma dettagliato corsi (generica)		
STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI (max punti 6)	modalità richiesta	non previste altre forme alternative al web il servizio di assistenza del sistema informatico è attivo solo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19 ESSENDO UNICO SISTEMA PER ACCEDERE AI SERVIZI DOVREBBE ESSERE ATTIVO 24/24 per 365 gg/anno.		
progetto di servizio ospedaliero	tempistica consegna: installazione, collaudi	non prevista consegna certificato sanificazione ed elettrico tempi leggermente migliorativi rispetto al capitolato		
tempistica manutenzione	tempistica manutenzione	tempistica migliorativa rispetto al capitolato		
modalità assistenza	web/telefonico	tempistica migliorativa rispetto al capitolato		
possesso di certificazioni di qualità	SI	il materasso viene sballato direttamente sul furgone e disinfectato su di esso per evitare che materiale contaminato entri in officina	2,00	1,50
ASPETTI IGIENICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONE E SANITIZZAZIONE (max punti 4)	modalità sanificazione	viene presentato l'elenco dei prodotti utilizzati per la disinfezione e lo studio di efficacia degli stessi		
presenza protocollo di sanificazione	SI	suffic. garanzie di igiene	1,00	1,00
INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO (max punti 3)	Informatizzazione del servizio	il servizio di assistenza del sistema informatico è attivo solo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19 ESSENDO UNICO SISTEMA PER ACCEDERE AI SERVIZI DOVREBBE ESSERE ATTIVO 24/24 per 365 gg/anno. Il procedimento informatico seguito non risulta di facile utilizzo per personale sanitario	3,00	
MIGLIORIE (max punti 2)	studio prevalenza	assente in quanto le ipotesi formulate non sono uno studio di prevalenza	2,00	15,00
<b>Totale punti</b>			<b>15,00</b>	<b>3,00</b>

Struttura organizzativa KCI - Vivisol		NOTE		Punti max	Punteggio da riempire
Dati rilevati					
Sede/Distributore	Genova - 380 m2 di superficie dedicata per la Liguria				
n° automezzi	13 dedicati per la Liguria - accessi separati (pulito/sporcio), deiezione-disinfezione-sanificazione per ogni tipo di trasporto, ogni 2 anni vengono cambiati				
n° personale: funzione e tempo dedicato	25 tecnici dedicati per la Liguria (di cui 13 solo per le consegne); 6 tecnici sanificatori KCI				
localizzazione centri di sanificazione	Assago (Milano), Torino, Firenze				
aggiornamento personale n° ore	previsti corsi di formazione dedicati, in base al ruolo ricoperto. Almeno 2 aggiorn. annui per un totale di 16 ore				
n verde	si - 24/24				
progetto di servizio ospedaliero	fax-mail-n. verde (presidiali 24/24 ore); software 6 ore solari con ricevimento 24 ore 24 ore - mattina al capistaffa				
modalità richiesta: tempistica consegna installazione collaudo tempistica distruzione	fax-mail-n. verde (presidiali 24/24 ore); software				
modalità assistenza	fax-mail-n. verde (presidiali 24/24 ore); software				
possesso di certificazioni di qualità	si (KCI-Vivisol)				
ASPETTI IGIENICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONI E SANITIZZAZIONE (max punti 4)	modalità sanificazione presenza protocollo di sanificazione	altamente dettagliata per tutti i tipi di superficie (allegato 10).	sanificazione (certificata) e percorso di sanificazione (certificata) aggiornamento della certificazione 02/12/2010	3,00	3,00
INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO (max punti 3)	progetto di informatizzazione	si	manca la cartina del percorso di sanificazione ma è stata fornita descrizione dettagliata delle aree di sanificazione (area di arrivo-aree cleaning-aree lavanderia area piegatura e test- area manutenzione- area rent)	1,00	1,00
MIGLIORIE (max punti 2)	studio prevalenza	si	il personale tecnico è dotato di sistema portatile (PDA). l'aggiornamento delle movimentazioni avviene ogni 15 minuti. Consiglia reportistica mensilmente, possibilità di visualizzazione direttamente tramite sistema informatico	3,00	3,00
				2,00	2,00
<b>Totale punti</b>				<b>15,00</b>	<b>14,50</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*


Struttura organizzativa Hill- Rom	Dati rilevati	NOTE	Punti max	Punteggio assegnato
Sede/Distributore n° automezzi n° personale funzione e tempo dedicato	Ditta ERO Sac di Genova 36 furgoni allestiti per tutta Italia (Hill Rom) 7 tecnici dedicati (Ditta ERO)	non si evince se i mezzi hanno la divisione sporco/pulito		
locazione centri di sanificazione	sede centrale di Milano/possibilità di sanificazione a Genova- Ditta ERO	sanificazione presso Milano con servizio navetta (mancano le specifiche per il servizio navetta) possibilità di sanificazione dei presidi presso la Ditta ERO di Genova training e test on line (livello Basic o Advance), manca il dettaglio dei programmi di aggiornamento, non si evince quale percorso formativo viene proposto ai tecnici della Ditta ERO di Genova il personale verrà formato al momento dell'installazione del presidio da personale incaricato. E' presente un programma di massima per gli operatori (Safe Skin). Manca un programma specifico di formazione (in ore, argomenti trattati )	6,00	3,50
aggiornamento personale n° ore	40 ore (5 giorni annui)			
n° verde	8 ore (1 o più giorni da concordare)			
modalità richiesta	no Call Center 24/24 ore per 365 giorni-on line 24/24 ore per 365 giorni			
tempistica consegna installazione	installazione entro le 8 ore- intensiva entro le 6 ore	leggermente migliorativo		
collaudo	18 ore	leggermente migliorativo		
tempistica dismissione		mancano i certifi di sanificazione e di sicurezza elettrica al momento della consegna del presidio, la bolla di accompagnamento verrà trasmessa tramite fax successivamente alla consegna del presidio (non si evince se i documenti di certificazione per la sanificazione e per la sicurezza elettrica siano parte integrante della bolla di		
progetto di servizio ospedaliero	Call Center 24/24 ore per 365 giorni-on line 24/24 ore per 365 giorni			
modalità assistenza	si			
possesso di certificazioni di qualità				
ASPETTI IGIENICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONI E SANITIZZAZIONE (max punti 4)	presenza di una check list (in lingua inglese) presentato percorso di sanificazione con evidenziazione del percorso sporco/pulito	Non si evince come vengano trattate le spugne poltose dopo l'utilizzo. Visto che la documentazione indica anche la ditta Hero come possibile sanificatore manca la planina dell'locale di sanificaz Hero e per quanto riguarda le procedure e presente una checklist di Hill rom che Hero utilizza le sue stesse procedure di sanific nelle istruz di lavoro (non è ben chiaro quali prodotti vengano utilizzati per la sanificaz)	3,00	2,50
presenza protocollo di sanificazione	si			
progetto di informatizzazione	si (Therapy online)			
studio prevalenza	si	Il software sembra avere ottime potenzialità, dalla documentazione presentata si evince la possibilità di avere uno buon studio di prevalenza su scala regionale con completezza di dati	2,00	1,90
<b>INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO max punti 3</b>			3,00	3,00
<b>MIGLIORIE max punti 2</b>			2,00	1,90
<b>Totale punti</b>			<b>15,00</b>	<b>11,90</b>

# Allegato 3

## Scheda di valutazione tecnica dei lotti



A handwritten signature, possibly 'M. P.', is written over a horizontal line. To the right of the line, the initials 'SP' are written.

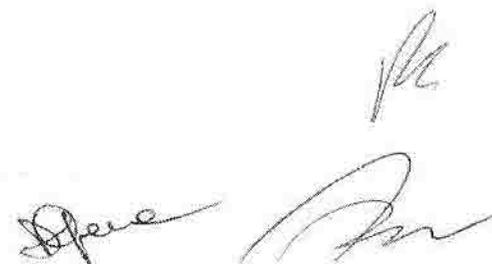

Two handwritten signatures are present. The one on the left is 'Spere', and the one on the right is 'P. M.'. Above the 'Spere' signature, the initials 'PC' are written.

Scheda valutazione Lotto 1

Sistemi antidecubito a riduzione pressoria continua senza elettrocompressore per la prevenzione e/o il trattamento delle lesioni fino al Il stadio;

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Dati rilevati - Lotto 1 Hill Rom P330 Wound Surface	Punti max	Punteggio assegnato - Lotto 1 Hill Rom P330 Wound Surface
Struttura organizzativa personale e mezzi impiegati	Sede/Distributore;			
	Numero automezzi			
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione	Numero personale; funzione e tempo dedicato		6	3,50
	Localazione centri di sanificazione			
	Aggiornamento personale; numero ore			
	Numero verde			
Informaticizzazione del servizio	Possesso di certificazioni di qualità	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	3	2,50
	Progetto di servizio ospedaliero			
Migliorie	Modalità di lavaggio, sanificazione e asciugatura del sistema (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, ecc.)		1	1,00
	Progetto di studio di prevalenza inerente le lesioni da pressione		3	3,00
Principio di funzionamento	Progetto di informatizzazione del servizio (richieste, dismissioni, informazioni e reportistica delle attività di)		2	1,90
	Progetto di studio di prevalenza inerente le lesioni da pressione			
Comfort paziente	Presenza di modalità di scarico dinamico delle pressioni di contatto	SI	5	5,00
	Scarico delle pressioni in relazione alle difformi zone corporee (anche con modalità differenti)	testare soluzione scario coste feltri	5	4,00
	Portata terapeutica in kg (> 120 kg) (a maggior portata corrisponderà maggior punteggio)	60 kg in più del richiesto	5	5,00
	Praticità d'uso (pesi, materiali, telo di copertura, maneggevolezza del sistema, versatilità dimensioni)	La CPR è strappo corto può rimanere incastrata durante il rifacimento del telo.	5	3,00
Comfort operatore	Possibilità di pagamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio	buon pagamento e funzione terapeutica materia	4	4,00
	Stabilità e mantenimento della postura (prova del fondo)	non si apre il fondo a 90°	4	4,00
Comfort operatore	Facilità ad eseguire le manovre di nursing	SI	4	4,00
	Facilità di sanificazione della cover (a maggior semplicità/praticità di sanificazione d'urgenza della cover corrisponderà maggior punteggio)	cover spessa	3	2,00
<b>TOTALE PUNTI</b>			<b>50</b>	<b>42,90</b>
<b>AMMESSO</b>				<b>SI</b>

1/6

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

Scheda valutazione Lotto 2  
 Sistemi a bassa pressione continua/ alternata per la prevenzione delle lesioni da pressione nei pazienti a medio rischio:

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Data Lotti Lotti 2				Punteggi attribuiti Lotti 2				Punti max	PUNTI		
		Alfa Ricerca	Beta TSS	Gamma Ricerca	Delta Ricerca	Alfa Ricerca	Beta TSS	Gamma Ricerca	Delta Ricerca				
Struttura organizzativa personale e mezzi impiegati	Spazio laboratorio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Struttura albergo	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Business personale: Anziano e tempo	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Struttura albergo	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanificazione	Località: tipo di certificazione	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Assegnamento personale, numero ore	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Numero ore	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Processo di certificazione di qualità	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Informazioni del servizio	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Migliore	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Sicurezza	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Risposta cliente	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Basi metodologiche	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Risultati e miglioramento della pratica	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Prodotto di servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Scheda valutazione Lotto 2  
 Sistemi a bassa pressione continua/alternata per la prevenzione delle lesioni da pressione nei pazienti a medio rischio

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Dati generali Lotto 2				Punteggi attribuiti Lotto 2				Punti	Rischio	HSE Points	
		Modello	Y&S	Spigolati	Altri V&S (severità)	Qualità	Qualità	Qualità	Qualità				
Comfort paziente	<p>Possibilità di preparazione, per uso su letti articolati, senza aprire le funzioni preparatorie del materasso.</p> <p>Facilità di lettura del materasso del sistema (funzionamento e posizione).</p> <p>Facilità di sostituzione della cover (il sistema).</p> <p>Facilità di leggere le manovre di nursing.</p>	<p>Modello: Alpha Flexo V1</p> <p>Y&amp;S: Colpo Pieno</p> <p>Spigolati: Puntali Cricchi MFC</p> <p>Altri V&amp;S (severità): Altri V&amp;S (severità)</p>	<p>1.80</p> <p>1.80</p> <p>1.80</p> <p>1.80</p>	<p>1.80</p> <p>1.80</p> <p>1.80</p> <p>1.80</p>	<p>1.80</p> <p>1.80</p> <p>1.80</p> <p>1.80</p>								
Comfort operatore	<p>Facilità di lettura del materasso del sistema (funzionamento e posizione).</p> <p>Facilità di sostituzione della cover (il sistema).</p> <p>Facilità di leggere le manovre di nursing.</p>	<p>Modello: Alpha Flexo V1</p> <p>Y&amp;S: Colpo Pieno</p> <p>Spigolati: Puntali Cricchi MFC</p> <p>Altri V&amp;S (severità): Altri V&amp;S (severità)</p>	<p>1.80</p> <p>1.80</p> <p>1.80</p> <p>1.80</p>	<p>1.80</p> <p>1.80</p> <p>1.80</p> <p>1.80</p>	<p>1.80</p> <p>1.80</p> <p>1.80</p> <p>1.80</p>								
<p><b>TOTALE PUNTI</b></p> <p><b>ARMESSO</b></p>											<p>50</p> <p>27.42</p> <p>21.92</p> <p>31.63</p> <p>22.76</p> <p>37.22</p> <p>38.26</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	

*[Handwritten signatures and initials]*

Scheda valutazione Lotto 3

Sistemi a pressione alternata / fluttuazione dinamica per la prevenzione delle lesioni da pressione in pazienti ad alto rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione in un'area di studio.

14/09/2013  
 [Signature]  
 [Signature]

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Punteggi attribuiti Lotto 3						Punti Max					
		Ricordarsi Autocoscienza	TSS Sistema Dual	Scaligera Quattro Plus	ATI-KC-Viasse Innovo Extra O.L.	Hilf Rentl Cor. Active Plus	Ricordarsi Autocoscienza		TSS Sistema Dual	Scaligera Quattro Plus	ATI-KC-Viasse Innovo Extra O.L.	Hilf Rentl Cor. Active Plus	
Struttura organizzativa personale e mezzi impiegati	Scopi/Distribuzione Numero automezzi Numero personale funzione e tempo dedicato Localizzazione centri di sanificazione Aggiornamento personale numero ore Numero verde Possesso di certificazioni di qualità Progetto di servizio ospedaliero							6	2,00	1,50	2,00	5,50	3,50
	Modalità di lavaggio, sanificazione e asciugatura del sistema (materasso, letto, lenzuola, materassi, tubi di collegamento, ecc.)	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	3	0,00	0,00	0,00	3,00	2,50					
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanizzazione	Possesso di certificazioni di qualità del processo di sanificazione						1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Informazioni del servizio	Qualità del servizio						2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modalità di erogazione						2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Principio di funzionamento	Presenza di modalità di scarico						2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Accessibilità e facilità di utilizzo della versione CDP						2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Praticità d'uso	Qualità costruttiva e ingegneristica dell'atto di accensione						1	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
	Praticità d'uso						0,5	0,41	0,35	0,37	0,50	0,22	





Scheda valutazione Lotto 4

Sistemi per la prevenzione dei pazienti ad altissimo rischio e/o il trattamento delle lesioni al IV stadio di varia tecnologia in grado di gestire la macerazione cutanea.

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Dati Rilevati Lotto 4				Punti max	Punteggi attribuiti Lotto 4										
		Ricorda	Scoperta	ATI KCH (voto)	ATI KCH (voto)		Ricorda	Scoperta	ATI KCH (voto)	ATI KCH (voto)							
		Numero 3	Quarto Alito	Abito Suro Final	Abito Suro Final	Class Active Plus KCH	Numero 3	Quarto Alito	Abito Suro Final	Abito Suro Final	Class Active Plus KCH	Numero 3	Quarto Alito	Abito Suro Final	Abito Suro Final	Class Active Plus KCH	
		1176	12678	6832	12544	19396	0,79	0,69	1,00	1,00	0,70	0,45					
		20	15	39	30	35	0,75	1,00	0,47	0,80	0,43						
		<p>si sente parzialmente il fondo a 90°</p> <p>buon pigiamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialmente alterata</p> <p>si sente parzialmente il fondo a 90°</p> <p>buon pigiamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialmente alterata</p> <p>si sente parzialmente il fondo a 90°</p> <p>buon pigiamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialmente alterata</p>															
Comfort paziente	Stabilità e mantenimento della postura (previa riduzione)	<p>la funzione del traspirante non è facilmente attivabile in grado da regolare nel materiale e nei imbottiture. La differenziazione della zona gelata è ottenuta mediante fasce elastiche che allungano lo spostamento forzato (fornitura alternativa)</p> <p>non si riesce a trovare un pigiamento a funzione terapeutica, il dotto è difficile impermeabilizzare, la fascia va il blocco e il supporto che per altri non viene apprezzato da pazienti alterati</p> <p>buon pigiamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialmente alterata</p> <p>si sente parzialmente il fondo a 90°</p> <p>buon pigiamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialmente alterata</p>															
Comfort operatore	Facilità di utilizzo del sistema e dei componenti (tecnologia e posizione)	<p>facilità di partecipazione nella zona di maggior mobilità/attività di sanificazione, il supporto è comodo e comodo per il maggior confort</p> <p>buon pigiamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialmente alterata</p> <p>si sente parzialmente il fondo a 90°</p> <p>buon pigiamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialmente alterata</p>															
		<p>TOTALE PUNTI AMMESSO</p>															
		50	24,48	28,78	22,45	43,73	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no

Handwritten signatures and initials, including "KCH" and "99".

Scheda valutazione lotto 5  
 Sistemi a reale cessione d'aria per la prevenzione dei pazienti ad altissimo rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al IV stadio per terapia intensiva.

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Parametri rilevati, Lotto 5 ATT-KG-Vision Theia-Kair-Vision	Punti max	Punti attribuiti, Lotto 5 ATT-KG-Vision Theia-Kair-Vision
Struttura organizzativa personalata e mezzi impiegati	Scelta/Operatore: Numero personale (funzione e tempo dedicato) Localizzazione centri di sanificazione Aggiornamento personale (numero ore) Numero verde Possesso di certificazioni di qualità Progetto di servizio ospedaliero		6	5,50
	Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanizzazione	Modalità di lavaggio, sanificazione e asciugatura del sistema (materasso, telo, lenzuola, tubi di collegamento, ecc.) Possesso di certificazioni di qualità del percorso di sanificazione Progetto di informatizzazione del servizio (richieste, distinzioni, informazioni e recapistica, date attività di noleggio) Progetto di studio di prevenzione in merito ai lesioni da pressione	3 1 3 2	3,00 1,00 3,00 2,00
Informatizzazione del servizio	Migliore	Presenza di modalità di scambio dinamico delle pressioni di contatto Scambio delle pressioni in relazione alle affezioni (come possono anche con frequenza differenzi)	2 3	2,00 2,00
	Principio di funzionamento	Funzione trasparente in di tutto il processo di cura commensurata a maggior paritetico Infilata biapertibile in 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285, 300, 315, 330, 345, 360, 375, 390, 405, 420, 435, 450, 465, 480, 495, 510, 525, 540, 555, 570, 585, 600, 615, 630, 645, 660, 675, 690, 705, 720, 735, 750, 765, 780, 795, 810, 825, 840, 855, 870, 885, 900, 915, 930, 945, 960, 975, 990, 1005, 1020, 1035, 1050, 1065, 1080, 1095, 1110, 1125, 1140, 1155, 1170, 1185, 1200, 1215, 1230, 1245, 1260, 1275, 1290, 1305, 1320, 1335, 1350, 1365, 1380, 1395, 1410, 1425, 1440, 1455, 1470, 1485, 1500, 1515, 1530, 1545, 1560, 1575, 1590, 1605, 1620, 1635, 1650, 1665, 1680, 1695, 1710, 1725, 1740, 1755, 1770, 1785, 1800, 1815, 1830, 1845, 1860, 1875, 1890, 1905, 1920, 1935, 1950, 1965, 1980, 1995, 2010, 2025, 2040, 2055, 2070, 2085, 2100, 2115, 2130, 2145, 2160, 2175, 2190, 2205, 2220, 2235, 2250, 2265, 2280, 2295, 2310, 2325, 2340, 2355, 2370, 2385, 2400, 2415, 2430, 2445, 2460, 2475, 2490, 2505, 2520, 2535, 2550, 2565, 2580, 2595, 2610, 2625, 2640, 2655, 2670, 2685, 2700, 2715, 2730, 2745, 2760, 2775, 2790, 2805, 2820, 2835, 2850, 2865, 2880, 2895, 2910, 2925, 2940, 2955, 2970, 2985, 3000, 3015, 3030, 3045, 3060, 3075, 3090, 3105, 3120, 3135, 3150, 3165, 3180, 3195, 3210, 3225, 3240, 3255, 3270, 3285, 3300, 3315, 3330, 3345, 3360, 3375, 3390, 3405, 3420, 3435, 3450, 3465, 3480, 3495, 3510, 3525, 3540, 3555, 3570, 3585, 3600, 3615, 3630, 3645, 3660, 3675, 3690, 3705, 3720, 3735, 3750, 3765, 3780, 3795, 3810, 3825, 3840, 3855, 3870, 3885, 3900, 3915, 3930, 3945, 3960, 3975, 3990, 4005, 4020, 4035, 4050, 4065, 4080, 4095, 4110, 4125, 4140, 4155, 4170, 4185, 4200, 4215, 4230, 4245, 4260, 4275, 4290, 4305, 4320, 4335, 4350, 4365, 4380, 4395, 4410, 4425, 4440, 4455, 4470, 4485, 4500, 4515, 4530, 4545, 4560, 4575, 4590, 4605, 4620, 4635, 4650, 4665, 4680, 4695, 4710, 4725, 4740, 4755, 4770, 4785, 4800, 4815, 4830, 4845, 4860, 4875, 4890, 4905, 4920, 4935, 4950, 4965, 4980, 4995, 5010, 5025, 5040, 5055, 5070, 5085, 5100, 5115, 5130, 5145, 5160, 5175, 5190, 5205, 5220, 5235, 5250, 5265, 5280, 5295, 5310, 5325, 5340, 5355, 5370, 5385, 5400, 5415, 5430, 5445, 5460, 5475, 5490, 5505, 5520, 5535, 5550, 5565, 5580, 5595, 5610, 5625, 5640, 5655, 5670, 5685, 5700, 5715, 5730, 5745, 5760, 5775, 5790, 5805, 5820, 5835, 5850, 5865, 5880, 5895, 5910, 5925, 5940, 5955, 5970, 5985, 6000, 6015, 6030, 6045, 6060, 6075, 6090, 6105, 6120, 6135, 6150, 6165, 6180, 6195, 6210, 6225, 6240, 6255, 6270, 6285, 6300, 6315, 6330, 6345, 6360, 6375, 6390, 6405, 6420, 6435, 6450, 6465, 6480, 6495, 6510, 6525, 6540, 6555, 6570, 6585, 6600, 6615, 6630, 6645, 6660, 6675, 6690, 6705, 6720, 6735, 6750, 6765, 6780, 6795, 6810, 6825, 6840, 6855, 6870, 6885, 6900, 6915, 6930, 6945, 6960, 6975, 6990, 7005, 7020, 7035, 7050, 7065, 7080, 7095, 7110, 7125, 7140, 7155, 7170, 7185, 7200, 7215, 7230, 7245, 7260, 7275, 7290, 7305, 7320, 7335, 7350, 7365, 7380, 7395, 7410, 7425, 7440, 7455, 7470, 7485, 7500, 7515, 7530, 7545, 7560, 7575, 7590, 7605, 7620, 7635, 7650, 7665, 7680, 7695, 7710, 7725, 7740, 7755, 7770, 7785, 7800, 7815, 7830, 7845, 7860, 7875, 7890, 7905, 7920, 7935, 7950, 7965, 7980, 7995, 8010, 8025, 8040, 8055, 8070, 8085, 8100, 8115, 8130, 8145, 8160, 8175, 8190, 8205, 8220, 8235, 8250, 8265, 8280, 8295, 8310, 8325, 8340, 8355, 8370, 8385, 8400, 8415, 8430, 8445, 8460, 8475, 8490, 8505, 8520, 8535, 8550, 8565, 8580, 8595, 8610, 8625, 8640, 8655, 8670, 8685, 8700, 8715, 8730, 8745, 8760, 8775, 8790, 8805, 8820, 8835, 8850, 8865, 8880, 8895, 8910, 8925, 8940, 8955, 8970, 8985, 9000, 9015, 9030, 9045, 9060, 9075, 9090, 9105, 9120, 9135, 9150, 9165, 9180, 9195, 9210, 9225, 9240, 9255, 9270, 9285, 9300, 9315, 9330, 9345, 9360, 9375, 9390, 9405, 9420, 9435, 9450, 9465, 9480, 9495, 9510, 9525, 9540, 9555, 9570, 9585, 9600, 9615, 9630, 9645, 9660, 9675, 9690, 9705, 9720, 9735, 9750, 9765, 9780, 9795, 9810, 9825, 9840, 9855, 9870, 9885, 9900, 9915, 9930, 9945, 9960, 9975, 9990, 10005, 10020, 10035, 10050, 10065, 10080, 10095, 10110, 10125, 10140, 10155, 10170, 10185, 10200, 10215, 10230, 10245, 10260, 10275, 10290, 10305, 10320, 10335, 10350, 10365, 10380, 10395, 10410, 10425, 10440, 10455, 10470, 10485, 10500, 10515, 10530, 10545, 10560, 10575, 10590, 10605, 10620, 10635, 10650, 10665, 10680, 10695, 10710, 10725, 10740, 10755, 10770, 10785, 10800, 10815, 10830, 10845, 10860, 10875, 10890, 10905, 10920, 10935, 10950, 10965, 10980, 10995, 11010, 11025, 11040, 11055, 11070, 11085, 11100, 11115, 11130, 11145, 11160, 11175, 11190, 11205, 11220, 11235, 11250, 11265, 11280, 11295, 11310, 11325, 11340, 11355, 11370, 11385, 11400, 11415, 11430, 11445, 11460, 11475, 11490, 11505, 11520, 11535, 11550, 11565, 11580, 11595, 11610, 11625, 11640, 11655, 11670, 11685, 11700, 11715, 11730, 11745, 11760, 11775, 11790, 11805, 11820, 11835, 11850, 11865, 11880, 11895, 11910, 11925, 11940, 11955, 11970, 11985, 12000, 12015, 12030, 12045, 12060, 12075, 12090, 12105, 12120, 12135, 12150, 12165, 12180, 12195, 12210, 12225, 12240, 12255, 12270, 12285, 12300, 12315, 12330, 12345, 12360, 12375, 12390, 12405, 12420, 12435, 12450, 12465, 12480, 12495, 12510, 12525, 12540, 12555, 12570, 12585, 12600, 12615, 12630, 12645, 12660, 12675, 12690, 12705, 12720, 12735, 12750, 12765, 12780, 12795, 12810, 12825, 12840, 12855, 12870, 12885, 12900, 12915, 12930, 12945, 12960, 12975, 12990, 13005, 13020, 13035, 13050, 13065, 13080, 13095, 13110, 13125, 13140, 13155, 13170, 13185, 13200, 13215, 13230, 13245, 13260, 13275, 13290, 13305, 13320, 13335, 13350, 13365, 13380, 13395, 13410, 13425, 13440, 13455, 13470, 13485, 13500, 13515, 13530, 13545, 13560, 13575, 13590, 13605, 13620, 13635, 13650, 13665, 13680, 13695, 13710, 13725, 13740, 13755, 13770, 13785, 13800, 13815, 13830, 13845, 13860, 13875, 13890, 13905, 13920, 13935, 13950, 13965, 13980, 13995, 14010, 14025, 14040, 14055, 14070, 14085, 14100, 14115, 14130, 14145, 14160, 14175, 14190, 14205, 14220, 14235, 14250, 14265, 14280, 14295, 14310, 14325, 14340, 14355, 14370, 14385, 14400, 14415, 14430, 14445, 14460, 14475, 14490, 14505, 14520, 14535, 14550, 14565, 14580, 14595, 14610, 14625, 14640, 14655, 14670, 14685, 14700, 14715, 14730, 14745, 14760, 14775, 14790, 14805, 14820, 14835, 14850, 14865, 14880, 14895, 14910, 14925, 14940, 14955, 14970, 14985, 15000, 15015, 15030, 15045, 15060, 15075, 15090, 15105, 15120, 15135, 15150, 15165, 15180, 15195, 15210, 15225, 15240, 15255, 15270, 15285, 15300, 15315, 15330, 15345, 15360, 15375, 15390, 15405, 15420, 15435, 15450, 15465, 15480, 15495, 15510, 15525, 15540, 15555, 15570, 15585, 15600, 15615, 15630, 15645, 15660, 15675, 15690, 15705, 15720, 15735, 15750, 15765, 15780, 15795, 15810, 15825, 15840, 15855, 15870, 15885, 15900, 15915, 15930, 15945, 15960, 15975, 15990, 16005, 16020, 16035, 16050, 16065, 16080, 16095, 16110, 16125, 16140, 16155, 16170, 16185, 16200, 16215, 16230, 16245, 16260, 16275, 16290, 16305, 16320, 16335, 16350, 16365, 16380, 16395, 16410, 16425, 16440, 16455, 16470, 16485, 16500, 16515, 16530, 16545, 16560, 16575, 16590, 16605, 16620, 16635, 16650, 16665, 16680, 16695, 16710, 16725, 16740, 16755, 16770, 16785, 16800, 16815, 16830, 16845, 16860, 16875, 16890, 16905, 16920, 16935, 16950, 16965, 16980, 16995, 17010, 17025, 17040, 17055, 17070, 17085, 17100, 17115, 17130, 17145, 17160, 17175, 17190, 17205, 17220, 17235, 17250, 17265, 17280, 17295, 17310, 17325, 17340, 17355, 17370, 17385, 17400, 17415, 17430, 17445, 17460, 17475, 17490, 17505, 17520, 17535, 17550, 17565, 17580, 17595, 17610, 17625, 17640, 17655, 17670, 17685, 17700, 17715, 17730, 17745, 17760, 17775, 17790, 17805, 17820, 17835, 17850, 17865, 17880, 17895, 17910, 17925, 17940, 17955, 17970, 17985, 18000, 18015, 18030, 18045, 18060, 18075, 18090, 18105, 18120, 18135, 18150, 18165, 18180, 18195, 18210, 18225, 18240, 18255, 18270, 18285, 18300, 18315, 18330, 18345, 18360, 18375, 18390, 18405, 18420, 18435, 18450, 18465, 18480, 18495, 18510, 18525, 18540, 18555, 18570, 18585, 18600, 18615, 18630, 18645, 18660, 18675, 18690, 18705, 18720, 18735, 18750, 18765, 18780, 18795, 18810, 18825, 18840, 18855, 18870, 18885, 18900, 18915, 18930, 18945, 18960, 18975, 18990, 19005, 19020, 19035, 19050, 19065, 19080, 19095, 19110, 19125, 19140, 19155, 19170, 19185, 19200, 19215, 19230, 19245, 19260, 19275, 19290, 19305, 19320, 19335, 19350, 19365, 19380, 19395, 19410, 19425, 19440, 19455, 19470, 19485, 19500, 19515, 19530, 19545, 19560, 19575, 19590, 19605, 19620, 19635, 19650, 19665, 19680, 19695, 19710, 19725, 19740, 19755, 19770, 19785, 19800, 19815, 19830, 19845, 19860, 19875, 19890, 19905, 19920, 19935, 19950, 19965, 19980, 19995, 20010, 20025, 20040, 20055, 20070, 20085, 20100, 20115, 20130, 20145, 20160, 20175, 20190, 20205, 20220, 20235, 20250, 20265, 20280, 20295, 20310, 20325, 20340, 20355, 20370, 20385, 20400, 20415, 20430, 20445, 20460, 20475, 20490, 20505, 20520, 20535, 20550, 20565, 20580, 20595, 20610, 20625, 20640, 20655, 20670, 20685, 20700, 20715, 20730, 20745, 20760, 20775, 20790, 20805, 20820, 20835, 20850, 20865, 20880, 20895, 20910, 20925, 20940, 20955, 20970, 20985, 21000, 21015, 21030, 21045, 21060, 21075, 21090, 21105, 21120, 21135, 21150, 21165, 21180, 21195, 21210, 21225, 21240, 21255, 21270, 21285, 21300, 21315, 21330, 21345, 21360, 21375, 21390, 21405, 21420, 21435, 21450, 21465, 21480, 21495, 21510, 21525, 21540, 21555, 21570, 21585, 21600, 21615, 21630, 21645, 21660, 21675, 21690, 21705, 21720, 21735, 21750, 21765, 21780, 21795, 21810, 21825, 21840, 21855, 21870, 21885, 21900, 21915, 21930, 21945, 21960, 21975, 21990, 22005, 22020, 22035, 22050, 22065, 22080, 22095, 22110, 22125, 22140, 22155, 22170, 22185, 22200, 22215, 22230, 22245, 22260, 22275, 22290, 22305, 22320, 22335, 22350, 22365, 22380, 22395, 22410, 22425, 22440, 22455, 22470, 22485, 22500, 22515, 22530, 22545, 22560, 22575, 22590, 22605, 22620, 22635, 22650, 22665, 22680, 22695, 22710, 22725, 22740, 22755, 22770, 22785, 22800, 22815, 22830, 22845, 22860, 22875, 22890, 22905, 22920, 22935, 22950, 22965, 22980, 22995, 23010, 23025, 23040, 23055, 23070, 23085, 23100, 23115, 23130, 23145, 23160, 23175, 23190, 23205, 23220, 23235, 23250, 23265, 23280, 23295, 23310, 23325, 23340, 23355, 23370, 23385, 23400, 23415, 23430, 23445, 23460, 23475, 23490, 23505, 23520, 23535, 23550, 23565, 23580, 23595, 23610, 23625, 23640, 23655, 23670, 23685, 23700, 23715, 23730, 23745, 23760, 23775, 23790, 23805, 23820, 23835, 23850, 23865, 23880, 23895, 23910, 23925, 23940, 23955, 23970, 23985, 24000, 24015, 24030, 24045, 24060, 24075, 24090, 24105, 24120, 24135, 24150, 24165, 24180, 24195, 24210, 24225, 24240, 24255, 24270, 24285, 24300, 24315, 24330, 24345, 24360, 24375, 24390, 24405, 24420, 24435, 24450, 24465, 24480, 24495, 24510, 24525, 24540, 24555, 24570, 24585, 24600, 24615, 24630, 24645, 24660, 24675, 24690, 24705, 24720, 24735, 24750, 24765, 24780, 24795, 24810, 24825, 24840, 24855, 24870, 24885, 24900, 24915, 24930, 24945, 24960, 24975, 24990, 25005, 25020, 25035, 25050, 25065, 25080, 25095, 25110, 25125, 25140, 25155, 25170, 25185, 25200, 25215, 25230, 25245, 25260, 25275, 25290, 25305, 25320, 25335, 25350, 25365, 25380, 25395, 25410, 25425, 25440, 25455, 25470, 25485, 25500, 25515, 25530, 25545, 25560, 25575, 25590, 25605, 25620, 25635, 25650, 25665, 25680, 25695, 25710, 25725, 25740, 25755, 25770, 25785, 25800, 25815, 25830, 25845, 25860, 25875, 25890, 25905, 25920, 25935, 25950, 25965, 25980, 25995, 26010, 26025, 26040, 26055, 26070, 26085, 26100, 26115, 26130, 26145, 26160, 26175, 26190, 26205, 26220, 26235, 26250, 26265, 26280, 26295, 26310, 26325, 26340, 26355, 26370, 26385, 26400, 26415, 26430, 26445, 26460, 26475, 26490, 26505, 26520, 26535, 26550, 26565, 26580, 26595, 26610, 26625, 26640, 26655, 26670, 26685, 26700, 26715, 26730, 26745, 267		

## **ALLEGATO N. 3**

ALLA DELIBERAZIONE N. 84 DEL 22/12/2011

**Verbale per la rinnovazione delle operazioni di verifica della documentazione tecnica presentata ai fini dell'assegnazione dei punteggi relativamente al parametro di qualità**

**Sedute del 07/11/2011**

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di "Sistemi antidecubito" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre - Lotti n. 5.

Seduta del 07/11/2011

**Rinnovazione delle operazioni di verifica della documentazione tecnica presentata ai fini della assegnazione dei punteggi relativamente al parametro qualità**

Il giorno 7 novembre 2011, presso gli uffici della Centrale Regionale di Acquisto siti in corso Scassi 1, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con deliberazione n. 12 del 26/01/2011 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la rinnovazione della verifica della documentazione presentata dalle Ditte concorrenti ai fini dell'accertamento dei requisiti minimi essenziali e per l'assegnazione dei punteggi relativamente ai parametri della qualità. Sono presenti i Signori:

- **Dott. Antonino MASSONE** - Direttore dell'Unità Spinale dell' Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ASL 2 Savonese – **Presidente**;
- **Dott. Giovanni A. CHECCHIA** - Direttore S.C. RRF Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ASL 2 Savonese – **Componente**;
- **Sig.ra Deborah GRANARA** – Infermiere Specializzato in Wound Care N.O. Lesioni Cutanee, ASL 3 Genovese – **Componente**;

Sono presenti la dr.ssa Silvia Simonetti, Dirigente della Centrale, la dr.ssa Paola Burlando, funzionario della Centrale, con funzioni di segretario della Commissione, e il Sig. Roberto Boretti Assistente Amm.vo della Centrale.

La seduta non è pubblica.

La Commissione Giudicatrice da preliminarmente atto:

- che il giorno 13/10/2011 è stato pubblicato sul sito informatico della Centrale il verbale relativo alla valutazione della documentazione tecnica e della campionatura ai fini dell'assegnazione del punteggio di qualità;
- che in data 21/10/2011, tramite fax, è pervenuta agli uffici della Centrale la nota ns. prot. n. 1522 della Ditta Hill-Rom, con la quale vengono fatte alcune contestazioni in merito alle valutazioni indicate nel suddetto verbale e viene richiesta una rivalutazione del punteggio assegnato alla stessa Hill-Rom;
- che il giorno 02/11/2011 è pervenuta la nota del 31/10/2011 della Ditta Zuccato HC (ns. prot. 1568 del 02/11/2011) con la quale vengono formulate delle osservazioni in merito al punteggio assegnato alla stessa;
- che gli uffici della Centrale hanno prontamente inviato tramite e-mail suddette note alla Commissione Giudicatrice;
- che la Commissione Giudicatrice, in accordo con la Centrale, ha stabilito di rinviare la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche prevista per il giorno 2 novembre 2011 (dando mandato alla Centrale di darne comunicazione ufficiale alle ditte) e di riunirsi in seduta non pubblica per poter analizzare quanto contestato dalle suddette Ditte.

La Commissione Giudicatrice passa quindi ad esaminare le contestazioni fatte dalla Ditta Hill-Rom e di seguito si riportano i rilievi fatti e relativa valutazione della Commissione:



## I- ILLEGITTIMA PERMANENZA IN GARA DEI PRODOTTI KCI

### **LOTTO 2 - "Sistemi a bassa pressione continua/ alternata per la prevenzione delle lesioni da pressione Ilei pazienti a medio rischio".**

Tra le caratteristiche definite "minime" risulta (pag. 8 del capitolato tecnico) il "controllo delle pressioni di contatto in base al peso ed alla postura del paziente in automatico".

Per il lotto 2, KCI ha presentato il prodotto "AIR WORKS II", il quale è privo di sensore automatico di regolazione della pressione del presidio antidecubito, di tal che è necessario regolare la stessa manualmente in base al peso del paziente. Tale manovra, peraltro, in assenza di congegno automatico, va effettuata ogni volta che il paziente cambia posizione.

A conferma di ciò lo stesso manuale d'uso del prodotto in questione parla inequivocabilmente di "regolare il valore della pressione dell'aria sull'unità di comando" dopo aver posizionato il paziente (pag. 8, punto 6 del manuale d'uso).

Viene, inoltre, ribadito che la funzione manuale di "regolazione del comfort" consente di adeguare il materasso al peso del paziente (pag. 7 del manuale d'uso), mentre in altro punto viene chiaramente segnalata la necessità di effettuare svariati controlli fisici posizionando una mano sotto il paziente all'altezza delle spalle, del sacro e dei talloni, per verificare la corretta pressione dell'aria ad uso terapeutico (pag. 9 del manuale d'uso).

Dalla suesposta disamina appare' chiaro che il prodotto in questione risulta sprovvisto del requisito minimo del "controllo automatico della pressione", requisito fondamentale e particolarmente importante anche per gli effetti sul paziente. L'offerta andava, pertanto, esclusa.

La Commissione rileva che la documentazione fornita in sede di gara (all. F4, relazione tecnica, scheda prodotto) dalla Ditta KCI evidenzia la presenza sia dello scarico dinamico delle pressioni (attraverso la pressione alternata con quattro cicli di alternanza) sia del sensore di regolazione. Peraltro la Ditta Hill-Rom nella sua contestazione cita delle caratteristiche dedotte dal Manuale d'uso del materasso, manuale che non era stato richiesto tra la documentazione da fornire in sede di gara.

Altro requisito essenziale negli specifici termini di cui alla premessa è l'idoneità del presidio offerto a sostituirsi integralmente al materasso ospedaliero. Lo si evince dal chiarimento rilasciato con nota prot. N. 1141 del 22.11.2010: al quesito se "il sistema richiesto in offerta, che come richiesto al vostro punto 2 non deve avere un'altezza dell'intera superficie inferiore a 10 cm, se rispondente a quanto di minima richiesto" sia "inteso come sostitutivo del materasso ospedaliero", la risposta è stata: "il sistema deve essere interamente sostitutivo del materasso ospedaliero".

In altro chiarimento, poi, veniva ulteriormente ribadito che "il SISTEMA deve essere sostitutivo del materasso in BLOCCO UNICO" (nota prot. N. 1193 del 01.12.2010, risposta al quesito n. 21).

Risulta chiaro e pacifico che codesta Amministrazione intende riferirsi ad un materasso completo e come tale interamente sostitutivo di quello ospedaliero e quindi dotato di tutte le caratteristiche tipiche di presidi di questo genere.

L'AIR WORKS II è un sovra materasso e nasce come tale, per cui solo se si aggiunge una base in schiuma può diventare completamente sostitutivo. Ma quand'anche integrato con base in schiuma, il presidio offerto non garantirebbe adeguate condizioni di sicurezza per il paziente e per l'operatore, mancando di un vero e proprio sistema di fissaggio della base al materasso ad aria.


A corroborare tale considerazione soccorre la valutazione che la stessa Commissione ha operato nel verbale in riferimento alla maneggevolezza del presidio KCI, laddove ha osservato che "il sistema è suddiviso in due parti da assemblare, quindi risulta non maneggevole per l'operatore, sia nella fase di predisposizione, sia in quella di stoccaggio".

In realtà, lungi dal dover essere una valutazione in termini di mero punteggio, l'evidenza dei fatti dovrebbe direttamente condurre all'esclusione dell'offerta della concorrente KCI: il constare di due pezzi è assolutamente incompatibile con il requisito minimo richiesto del "sistema sostitutivo del materasso IN BLOCCO UNICO".

Volendo argomentare diversamente si concreterebbe, una palese violazione della par condicio: se, infatti, HR fosse stata a conoscenza dell'ammissibilità di sovra materassi quale offerta relativa al lotto 2, sicuramente avrebbe valutato l'opportunità/opzione di offrire non un prodotto qualificabile come "materasso", e quindi notoriamente dal prezzo più elevato, ma un semplice sovra materasso con una conseguente offerta prezzo più contenuta.

Della suddetta opportunità, invece, si potrà - indebitamente - giovare la concorrente KCI, se non esclusa tempestivamente.

La Commissione conferma che il sistema offerto da KCI per il Lotto 2 è composto da due parti distinte (sovra materasso e spessore in poliuretano), come peraltro già rilevato in sede di valutazione tecnica e di campionatura. Sebbene la funzione terapeutica del sistema non risulti alterata e pertanto l'offerta di KCI sarebbe potenzialmente ammissibile per il trattamento delle lesioni oggetto del lotto, la Commissione rileva




di non aver tenuto conto del succitato chiarimento n.21 e pertanto **stabilisce l'esclusione dell'offerta** presentata dalla ditta KCI per il lotto 2 in quanto assente il requisito minimo essenziale "sistema sostitutivo del materasso in blocco unico".

**LOTTO 3** - "Sistemi a pressione alternata / fluttuazione dinamica per la prevenzione delle lesioni da pressione in pazienti ad alto rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al III stadio".

In questo caso è *a fortiori* da escludersi la proponibilità di un sovra materasso: se per pazienti a rischio medio di lesioni si escludeva il sovra materasso (lotto 2) a maggior ragione andrà escluso il sovra materasso per pazienti ad alto rischio di lesioni (lotto 3).

Il prodotto offerto dalla concorrente KCI per il lotto 3 - INNOVA EXTRA OL - è anch'esso un sovra materasso e valgono, per esso, le medesime considerazioni esplicate per l'offerta relativa al lotto 2, con la conseguenza che anche in questo caso l'offerta in questione andava assolutamente esclusa.

La Commissione rileva che, sebbene il sistema offerto da KCI per il Lotto 3 sia effettivamente composto da una componente superiore in celle d'aria e da una base in poliuretano, i due elementi sono perfettamente integrati nella cover e quindi costituiscono un sistema in BLOCCO UNICO. Peraltro il chiarimento n.21 con il quale si richiedeva il requisito del " sistema sostitutivo del materasso in blocco unico" era riferito al Lotto 2 e non ad altri lotti **Pertanto l'offerta presentata da KCI per il lotto 3 è da ritenersi valida**.

Ulteriore considerazione che avvalorata la necessità che la suddetta offerta dovesse essere esclusa si trova nella *lex specialis* di gara.

Nel capitolato tecnico, infatti, è richiesto come requisito minimo la "*possibilità di differenziare [la pressione del materasso rispetto ad] alcune zone corporee in base alle esigenze del paziente, per una migliore distribuzione dei pesi in prevenzione e/o trattamento delle lesioni*".

Il prodotto offerto dalla concorrente ATI KCI per il lotto 3 - come quello offerto dalla stessa concorrente per il lotto 2 - *non è provvisto di zone anatomiche differenziate/differenziabili*, ma soltanto della possibilità di sgonfiare totalmente singole celle allo scopo di toglierle per un' eventuale riparazione/sostituzione.

Risulta evidente che nelle intenzioni di Codesta Amministrazione la caratteristica doveva avere ben altri connotati terapeutici.

L'ipotetica possibilità di sgonfiare del tutto singole celle espone il paziente al grave rischio di appoggiare la parte del corpo interessata direttamente sulla base del letto o comunque su una parte in schiuma di poliuretano assolutamente non adatta alla prevenzione delle lesioni.

Del resto, una zona anatomica come per esempio la regione sacrale o i talloni, non può essere scaricata con il semplice sgonfiaggio di una singola cella in quanto del tutto insufficiente nel caso del sacro e soggetta a cambiamenti di posizione del paziente, nel caso dei talloni.

Queste due situazioni di fatto rendono inutile se non controproducente la possibilità di sgonfiare singole celle, e di conseguenza ovviamente risulta molto rischiosa l'ipotesi di sgonfiare 2 celle adiacenti in quanto il paziente rischierebbe di sprofondare.

Per questo motivo il prodotto non corrisponde a quanto richiesto in capitolato né assolve ad alcuna funzione equivalente in termini di funzionalità e, pertanto, doveva essere escluso.

La Commissione rileva che la documentazione fornita dalla Ditta KCI evidenzia la presenza della differenziazione delle pressioni nella zona talloni tramite la deselezionazione delle celle (al max 3 celle), mentre il bottoming è chiaramente escluso dalla caratteristica delle celle e dal loro posizionamento e struttura.

Inoltre la presenza del poliuretano non è finalizzata alla prevenzione di lesioni, ma semplicemente per il sostegno del paziente in caso di emergenza.

**Pertanto l'offerta presentata da KCI per il lotto 3 è da ritenersi valida**

Altro requisito minimo previsto per il lotto 3, alla medesima stregua che per il lotto 2, è la possibilità di "*equilibrare in modo automatico le pressioni da contatto in base al peso del paziente*".

La scrivente è a conoscenza del fatto che esistono almeno 2 versioni del Manuale d'Uso del prodotto INNOVA EXTRA. In una di queste versioni in nostro possesso, appare assolutamente chiaro che il prodotto descritto non possiede la caratteristica richiesta di "equilibrare in modo automatico le pressioni ... in base al peso del paziente". Si presume quindi che il prodotto sia stato nel frattempo modificato introducendo una sorta di automatismo, ma dal momento che il prodotto appare comunque invariato, sarebbe almeno necessario verificare che il meccanismo descritto sia realmente quello ricercato dalla CRA.

La Commissione evidenzia che, come già detto in precedenza, tra la documentazione da presentare in sede di gara non sono stati richiesti i manuali d'uso. Si precisa comunque che dalle schede tecniche fornite dalla Ditta emerge la presenza di un sensore elettronico per la regolazione delle pressioni da contatto.

**Pertanto l'offerta presentata da KCI per il lotto 3 è da ritenersi valida**

**LOTTO 4** - "Sistemi per la prevenzione dei pazienti ad altissimo rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al IV stadio di varia tecnologia in grado di gestire la macerazione cutanea".

Con riferimento a quest'ultimo lotto l'offerta dell'ATI KCI va, infine, esclusa per mancanza di due requisiti minimi essenziali.

In primo luogo il requisito della idoneità del prodotto offerto a "gestire la macerazione cutanea".

Sotto tale profilo codesta spett.le Amministrazione ha avuto modo di precisare anche le modalità con le quali si accerta la sussistenza del requisito in questione. Si afferma, infatti, nel chiarimento rilasciato con nota prot. N. 1120 del 17.11.2010 (risposta al quesito n. 5 relativo al lotto 4) che *"per valutare la gestione della macerazione cutanea di norma viene utilizzato un quantitativo prestabilito di H2O da versare sulla cover del materasso a cessione d'aria e si annota il tempo di evaporazione"*.

Si osserva a riguardo che il prodotto offerto dalla concorrente ATI KCI -INNOVA EXTRA MRS - per il lotto in questione non presenta tale caratteristica, essendo un materasso a pressione alternata.

Tuttavia - cosa ancor più grave - il requisito dell' idoneità alla "gestione della macerazione cutanea" per i singoli presidi offerti al lotto 4, non risulta presente tra gli elementi valutati nel verbale tecnico nella scheda riferita al lotto 4, voce "principio di funzionamento", laddove, invece, tale valutazione viene effettuata per i presidi offerti al lotto 5 (dotati, diversamente da quelli offerti nel lotto 4, del requisito in questione).

La Commissione rileva che dalle caratteristiche tecniche fornite da KCI si evince la possibilità per il telo di copertura di *"contrastare efficacemente i fattori di rischio come: frizione, forze di taglio e macerazione..."*.

**Pertanto l'offerta presentata da KCI per il lotto 4 è da ritenersi valida**

La Commissione precisa inoltre che il requisito della gestione della macerazione non risulta tra gli elementi valutati nel verbale tecnico, poiché lo stesso non è un elemento soggetto a punteggio (a differenza di quanto indicato nel lotto 5 dove per lo stesso parametro vengono attribuiti 3 punti max), bensì una caratteristica descrittiva del lotto.

In secondo luogo, altro requisito minimo richiesto dal capitolato tecnico per prodotti di cui al lotto 4 è la *"possibilità di differenziare alcune zone corporee in base alle esigenze del paziente, per una migliore distribuzione dei pesi in prevenzione e/o trattamento delle lesioni"*.

Ebbene, non esiste alcuna indicazione all' interno del sito internet, del Dépliant illustrativo e del Manuale d'Uso del prodotto KCI circa la possibilità di differenziare la pressione dell'aria all'interno del materasso rispetto ad alcune zone corporee così come richiesto. Questo perché di fatto il prodotto non è provvisto di zone anatomiche differenziate/differenziabili, ma soltanto della possibilità di sgonfiare totalmente singole celle allo scopo di toglierle per un'eventuale riparazione sostituzione (così come argomentato in precedenza). Vale anche in questo caso quanto già precedentemente ribadito: il semplice sgonfiaggio di una singola cella non può essere idoneo a scaricare la pressione del materasso, per esempio, a livello della regione sacrale o dei talloni, in quanto del tutto insufficiente nel caso del sacro e soggetta a cambiamenti di posizione del paziente, nel caso dei talloni.

Anche l'offerta che la concorrente ATI KCI ha presentato per il lotto 4 andrà, pertanto, esclusa per mancanza di requisiti minimi.

La Commissione, anche in questo caso, rileva che la documentazione fornita dalla Ditta KCI conferma la presenza della differenziazione delle pressioni nella zona talloni tramite la selezione delle celle, mentre il bottoming è escluso grazie alla caratteristica delle celle e dal loro posizionamento e struttura.

**Pertanto l'offerta presentata da KCI per il lotto 4 è da ritenersi valida**

## **II - Degli errori di valutazione dell'offerta qualitativa Hill-Rom**

Con la presente, la scrivente intende altresì porre al vaglio di codesta spett.le Amministrazione ulteriori rilievi relativi a talune errate considerazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice rispetto ai prodotti offerti.

Dette valutazioni emergono dalla lettura del verbale di valutazione tecnica ed attengono, in particolare, il profilo valutativo dell' "organizzazione del servizio".

All'interno del verbale, nella sezione "struttura organizzativa, personale e mezzi impiegati" è prevista l'attribuzione di un punteggio per la presenza di un **"numero verde"** attivo.

Nella casella corrispondente alla società HR compare la valutazione "NO", significante inequivocabilmente l'assenza di un tale servizio.

L'affermazione valutativa non corrisponde al vero, come sarà agilmente possibile verificare. Nel "Progetto organizzativo per l'erogazione del servizio" (allegato alla documentazione di gara), a pag. 7, è chiaramente individuato il numero "02-8811" della centrale operativa, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. In tal senso la valutazione espressa dalla Commissione andrà senz'altro riformata nel senso di indicare "SI" nella casella in questione.

La Commissione segnala che è universalmente condiviso che per numero verde si intenda un numero GRATUITO per chi telefona, iniziante con 800. Dalla documentazione fornita il numero attivo 24 ore su 24 è quello della centrale operativa iniziante con "02".

**La Commissione pertanto ritiene di non dover variare la propria valutazione.**

Ancora viene indicato per la HR, in corrispondenza della voce "Progetto di servizio ospedaliero", la seguente annotazione/valutazione: *"mancano i certificati di sanificazione e sicurezza elettrica al momento della consegna del presidio..."*

Anche tale circostanza non corrisponde al vero.

I certificati di cui la Commissione rileva l'assenza sono stati, invero, esaminati ed esplicitati alla Commissione durante la dimostrazione dei prodotti e sono chiaramente contenuti e spiegati nella documentazione di gara, in particolare nel "MANUALE PROCEDURE SANIFICAZIONE"; test sicurezza elettrica (pag. 12), documentazione di qualità allegata ai materassi P330 - PRIMO - CLINACTIV + (pag. 28), sigillo di qualità e riepilogo processo (pag. 29), registrazioni e documentazione di sanificazione e collaudo (pag. 30).

Quindi, per la voce "struttura organizzativa, personale e mezzi impiegati", per la quale è prevista l'attribuzione di un massimo di 6 punti, e rispetto alla quale la HR si è visti attribuire solo 3,50 punti, sarà necessario rideterminare il punteggio rettificando le predette incongruenze giacché immediatamente apprezzabili (esistenza o no di numero verde attivo, esistenza o no dei certificati).

La Commissione segnala che suddetta annotazione fa riferimento alla mancata presentazione dei certificati in fase di campionatura, ma che gli stessi erano già stati rilevati all'interno della documentazione tecnica presentata.

Il punteggio di 3,50 attribuito alla struttura organizzativa non è influenzato dalle rilevazioni in merito alle certificazioni di sanificazione, bensì dalle caratteristiche insufficienti nell'allestimento dei furgoni (divisione sporco/pulito), dalla mancata indicazione del numero di furgoni dedicati in esclusiva per la Regione Liguria, dalla carenza descrittiva dei programmi di aggiornamento.

**La Commissione pertanto ritiene di non dover variare la propria valutazione.**

Infine, sempre in tema di errata valutazione di elemento qualitativo afferente la struttura organizzativa della scrivente, si rileva come, in corrispondenza della voce "sanificazione", alla sotto-voce "modalità sanificazione", compaia l'annotazione " *... nelle istruzioni non è ben chiaro quali prodotti vengano utilizzati per la sanificazione*",

Codesta spett.le Amministrazione, nel valutare come "non chiara" l'individuazione dei detti prodotti, non ha tenuto conto di un elemento essenziale ed incontrovertibile: gli stessi prodotti per la sanificazione sono infatti elencati dettagliatamente nel "MANUALE PROCEDURE SANIFICAZIONE" (pagg. 31 e 32, sezione "prodotti utilizzati durante il processo di sanificazione"), allegato alla documentazione di gara. Nello stesso, poi, non figura un mero elenco di prodotti impiegati nella sanificazione, ma gli stessi sono accompagnati dalle "schede di sicurezza relative ai disinfettanti utilizzati".

Vale come per gli altri dati sopra evidenziati che il rilievo d'incongruenza fra quanto rilevato e valutato dalla Commissione nel verbale è nella disponibilità di chiunque, trattandosi di dati empiricamente apprezzabili.

Pertanto andrà altresì rivalutato *in melius* il punteggio attribuito alla scrivente HR per la sanificazione, corrispondente attualmente a 2,50 punti valutativi su di un massimo di 3 punti attribuibili.

La Commissione segnala che l'annotazione " *... nelle istruzioni non è ben chiaro quali prodotti vengano utilizzati per la sanificazione*" sta ad indicare, non l'assenza dei prodotti (di cui sono state visionate le schede di sicurezza), bensì la mancata indicazione di dove, all'interno del processo di sanificazione, siano utilizzati i prodotti di cui si allegano le schede.

Inoltre si rileva che il punteggio di 2,50 è stato attribuito a seguito di altri elementi poco chiari quali: la mancata indicazione del trattamento delle spugne poliuro e la poca chiarezza sui percorsi di sanificazione, sui locali e sulle procedure della Ditta. ERO in Regione Liguria.

**La Commissione pertanto ritiene di non dover variare la propria valutazione.**

La Commissione passa quindi ad esaminare le osservazioni fatte dalla Ditta Zuccato HC e di seguito si riportano i rilievi fatti e relativa valutazione della Commissione:

A) Relativamente alla valutazione della macroarea "STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI" (max 6 punti) si osserva che la commissione, nella propria valutazione, non ha tenuto in considerazione la dichiarazione contenuta nel progetto presentato in gara dalla scrivente azienda relativamente alla **qualifica OSA del personale addetto alla consegna/ritiro dei presidi** e ciò in quanto, come si legge nell'allegato 2 alla voce "note", ha ritenuto la dichiarazione in contrasto con quanto riportato nell'allegato E al progetto medesimo.

A tale proposito si precisa che l'allegato E è documento redatto ai fini della certificazione ISO ed è inevitabilmente ed appositamente formulato in modo generico, tale da poter ricomprendere tutte le possibili alternative ivi compresa quella che alcuni addetti alla consegna e ritiro dei presidi noi siano soggetti qualificati alla movimentazione dei pazienti.

Posto quanto sopra, per una corretta valutazione del servizio offerto, la commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione quanto dichiarato nel progetto presentato dalla scrivente da cui si evince che il personale attualmente in forza è dotato di qualifica OSA.

Si osserva altresì che la scrivente azienda ha appositamente scelto di non limitare il numero di dipendenti dedicati al servizio nella regione Liguria (come invece indicato da altre aziende che la commissione ha valutato con maggior favore) ritenendo in tal modo di garantire la migliore resa possibile del servizio e non precludendo la disponibilità di alcuna risorsa ad operare sul territorio (si pensi ad esempio a casi di neutra eccezionale o ad interventi urgenti).

Si precisa infatti che, contrariamente a quanto si evince nelle "note" redatte dalla commissione, la sottoscritta società ha indicato tutto il proprio personale a disposizione del servizio nella regione Liguria 24 ore su 24.

La Commissione rileva che il capitolato tecnico prevedeva, tra gli elementi di valutazione, il numero degli operatori da dedicare in esclusiva al servizio della Regione Liguria.

La Ditta Zuccato HC non ha indicato il numero di personale con il quale intende organizzare il servizio presso la Regione Liguria, bensì il personale complessivo sul territorio nazionale.

La natura di "progetto" richiedeva di indicare il numero di addetti dedicati al servizio, costituendo questo elemento un parametro necessario per valutare e mettere a confronto i diversi progetti.

L'indicazione che "tutto" il personale possa essere messo a disposizione per il servizio presupporrebbe che l'attività della Ditta fosse totalmente dedicata alla regione Liguria, cosa che è smentita dall'indicazione nella documentazione di gara di numerose forniture su tutto il territorio nazionale.

Inoltre si segnala che la qualifica di Osa non era richiesta dal capitolato e non è stata pertanto oggetto di valutazione.

**La Commissione pertanto ritiene di non dover variare la propria valutazione.**

Una ulteriore osservazione che merita di essere portata alla Vostra attenzione riguarda la valutazione dei **centri di sanificazione**; nelle note relative alla localizzazione dei centri infatti si legge che *"non sono chitate le condizioni di funzionamento dei centri operativi autorizzati. Se la certificazione presentata riguardi anche il loro funzionamento"*.

A tale proposito si evidenzia come, nonostante siano stati elencati complessivamente 10 centri operativi di cui quelli definiti "autorizzati" sono solo tre, la commissione nella assegnazione del punteggio ha ritenuto di soffermarsi sulla eventuale non conformità dei tre centri "autorizzati" rispetto agli altri per i quali la conformità alla certificazione è indiscutibile.

La Commissione rileva che il progetto presentato dalla Ditta Zuccato, nell'individuare le caratteristiche dei centri di sanificazione, definisce in modo difforme il Centro di Verona "centro di sanificazione e ricondizionamento dei presidi equipaggiato con sistemi allo stato dell'arte di lavanderia industriale o per l'esecuzione dei processi di sanificazione e decontaminazione...omissis" e le unità logistiche e operative, per i quali la dizione è "centri direttamente collegati con il centro logistico e abilitati a svolgere attività di consegna, ritiro, assistenza e di trattamento e sanificazione dei sistemi antidecubito", omettendo di indicarne le caratteristiche che sembrano essere proprie solo del centro di sanificazione di Verona.

**La Commissione pertanto ritiene di non dover variare la propria valutazione.**

Infine, quanto al **progetto di servizio ospedaliero**, nelle note la commissione ha rilevato che sarebbe "contrario alla normativa su privacy: apposizione su nastro adesivo attaccato al presidio di nome e cognome del pz".

Anzitutto la segnalazione della commissione lascia la scrivente alquanto stupita poiché non risulta da alcuno dei documenti presentati in gara una tale dichiarazione; ciò detto si precisa che, come si evince chiaramente dal

progetto, il servizio si svolge in maniera del tutto automatizzata attraverso un sofisticato sistema informatico sviluppato e realizzato appositamente per garantire la massima resa del servizio e la assoluta tutela della privacy del paziente.

La Commissione rileva che a pag. 5 dell'Allegato L "Noleggio" viene chiaramente indicato "l'addetto provvede in fase di consegna nominale, a contrassegnare l'apparecchiatura con nastro adesivo sul quale viene apposto il nominativo del paziente per il quale viene consegnato il presidio...omissis..."

**La Commissione pertanto ritiene di non dover variare la propria valutazione.**

B) Relativamente alla valutazione della macroarea "ASPETTI IGIENICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONE E SANITIZZAZIONE" la commissione nelle "note" ha evidenziato alcuni "aspetti contraddittori" sulla base dei quali ha ritenuto di assegnare zero punti alla scrivente società.

A tale proposito si fa constare quanto segue:

**punto 1):** leggendo attentamente la procedura di sanificazione (pagina 5 e 6 dell'allegato L al progetto presentato in gara) si evince che la modalità di sanificazione dei materassi è la medesima per i sacchi di colore giallo e di colore rosso/arancio e ciò si evince chiaramente dalla descrizione della procedura che di seguito si riporta (cfr pag. 6): *"Essendoci in ingresso due macro tipologie di confezioni gialla (identificante il prodotto normalmente sporco) e rosso/arancio (identificante il prodotto potenzialmente infetto), l'addetto organizza la propria attività iniziando dalla suddivisione delle due diverse tipologie menzionate e procede come segue.*

*1. Procede con la lavorazione dei presidi imballati nei sacchi di colore giallo come descritto al successivo punto 5.1.3.2.*

*2. Prowede al trattamento dei prodotti infetti (confezionati nei sacchi di colore rosso) dopo aver indossato gli adeguanti DPI (ulteriori guanti e mascherina) per il trattamento.*

*3. Confeziona il cover del presidio considerato potenzialmente infetto \* nel sacchetto bianco idrosolubile.*

*4. Pone il sacchetto idrosolubile nel cesto con gli altri cover, destinandoli alla zona gialla per la sanificazione a caldo."*

A tale proposito si precisa che l'unica differenza tra la manipolazione del sacco giallo e del sacco rosso/arancio è una ulteriore protezione per l'operatore che si trova a dover sanificare il presidio.

**punti 3) e 5):** si precisa che la prova di funzionamento del presidio e il controllo/collaudò della parte elettrica vengono effettuati, al termine di ogni noleggio, immediatamente dopo il trattamento del compressore ad aria come specificato nel punto 5.1.2 e 55. della procedura di sanificazione (allegato L pagò 6, 7 e 8). A tale proposito la stessa commissione, nel corso delle "prove pratiche", ha verificato che il controllo/collaudò sulla parte elettrica viene puntualmente eseguito e che ne viene rilasciata documentazione attestante. Si precisa altresì che la prova di funzionamento del presidio, come il controllo/collaudò, è procedura interna eseguita sulla base di specifiche tecniche di prodotto le quali, come è evidente, non possono essere compiutamente descritte in una procedura ISO.

Infine per quanto riguarda, l'assemblaggio del motore al materasso si precisa che, trattandosi di elementi diversi e autonomi di un medesimo presidio essi seguono differenti processi di sanificazione e riconfezionamento. Tuttavia, a parere della scrivente, indipendentemente da come e quando venga assemblato il presidio ai fini della valutazione del servizio ciò che importa è che venga consegnato un dispositivo completo e funzionante nei modi e nei tempi stabiliti e, pertanto, l'osservazione svolta dalla commissione non è chiara.

La Commissione, dall'esame della procedura ha evidenziato che non ci sono criteri attraverso i quali l'operatore debba scegliere il lavaggio a caldo o a freddo. Tale scelta deve essere indicata nella procedura, in modo che, l'operatore sappia a priori quale modalità deve usare.

Inoltre la Commissione ribadisce che i presidi debbono essere tutti considerati potenzialmente infetti. Non sempre, infatti, la presenza di infezioni è dichiarata o conoscibile.

**La Commissione pertanto ritiene di non dover variare la propria valutazione.**

**punto 4):** in merito alla "separazione sporco/pulito in fase di entrata/uscita per fine lavorazione" si precisa che la mappa presente a pagò 16 dell'allegato L al progetto di gara, la quale descrive l'iter della merce sporca, evidenzia che lo sporco viene trasportato dall'area coperta di carico e scarico dei furgoni all'interno dell'area di lavorazione (un unico verso della freccia) per essere sanificata. Al termine del procedimento la merce esce dall'area di lavorazione pulita e viene caricata sui furgoni.

La Commissione riprende in esame la piantina del sistema di sanificazione e ribadisce che, dall'esame della stessa, l'ingresso dello sporco e l'uscita del pulito non sono separati (come indicato a pag. 16 dell'allegato C).

**La Commissione pertanto ritiene di non dover variare la propria valutazione.**

Dalle considerazioni di cui sopra la Commissione stabilisce quindi di escludere l'offerta della ditta KCI per il lotto 2 e di non rivedere nessun altro dei punteggi in precedenza assegnati.

Le risultanze di attribuzione del punteggio di qualità sono riepilogate nella tabella che segue:

Ditte	Lotto 1		Lotto 2		Lotto 3		Lotto 4		Lotto 5	
	P.ti	Ammessa								
RICORDINI PIETRO DI RICORDINI MAURO & C. S.R.L.			27,42	SI	28,15	SI	24,48	NO		
T.S.S. S.R.L.			21,92	NO	21,10	NO				
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI				
SANITARIA SCALIGERA S.R.L.			31,63	SI	28,98	SI	28,78	SI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI
REHA – ISTITUTO TECNICO ORTOPEDICO			22,76	NO			22,45	NO		
ATI KCI MEDICAL S.R.L – VIVISOL			N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	44,70	SI	43,73	SI	46,50	SI
HILL- ROM S.P.A.	42,90	SI	38,26	SI	39,04	SI	38,55	SI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI
MEDIC AIR S.R.L.			N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI		

La Commissione stabilisce di convocare la seduta per l'apertura delle offerte economiche a data da destinarsi e da mandato agli uffici della Centrale Acquisti di darne formale comunicazione alle ditte offerenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

• **Presidente :**

Dott. Antonino MASSONE

• **Componenti:**

Dott. Giovanni A. CHECCHIA


Sig.ra Deborah GRANARA

• **Segretario :**

Dott.ssa Paola BURLANDO

## Allegato 2

### Schede di valutazione del servizio

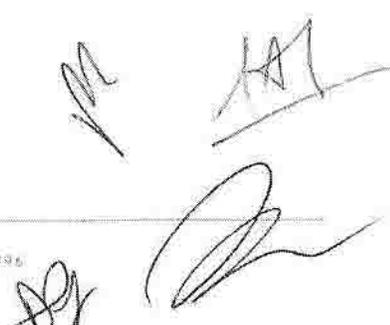

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large signature and several smaller initials.

All. 2 Scheda riepilogativa valutazione servizio


Sub parametri	Punteggio max	RICORDINI	TSS	SANTARIA SCALIGER A	RHEA	ATI KCL-VIVISOL	HILL ROMI
		punteggio attribuito					
Sede/Distributore							
n° automezzi							
n° personale; funzione e tempo dedicato							
locazione centri di sanificazione							
aggiornamento personale n° ore							
n° verde							
progetto di servizio ospedaliero	6,00	2,00	1,50	2,00	2,00	5,50	3,50
possesso di certificazioni di qualità							
ASPETTI IGIENICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONI E SANITIZZAZIONE (max punti 4)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,50
INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO (max punti 3)	3,00	1,50	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
MIGLIORIE (max punti 2)	2,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,00	1,90
<b>TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO</b>	<b>15,00</b>	<b>4,50</b>	<b>9,50</b>	<b>6,50</b>	<b>2,00</b>	<b>14,50</b>	<b>11,90</b>

Struttura organizzativa RICORDINI		Dati rilevati	NOTE	Punti max	Punteggio assegnato
Serie Distributore n° automezzi n° personale: funzione e tempo dedicato locazione centri di sanificazione aggiornamento personale n° ore n° verde	Genova 2 Fiat Doblo 3 persone dedicate Liguria centro sanificazione stocaggio Genova non meno di 15/anno 2 corsi teorico pratici con modalità da concordarsi con D.S. e Uff. inf affiancamento durante installazione NO fax/web	previsione aumento se vincono appalto: manca indicazione divisione sporcio/pulito numero inadeguato: previsione aumento: se vincono appalto manca indicazione contenuti manca indicazione contenuti: manca il numero delle ore previsto per l'aggiornamento. in attivazione con copertura ore ufficio	6,00	2,00	
progetto di servizio ospedaliero	12h sempre 8 per intensive 24h fax 24/24 2 celle 1 fisso, 1 celli h. 7/21, 1 celli e 1 fisso orario ufficio: lun ven h. 7,45/13 un indirizzo mail reperibilità 24/24	il documento fa riferimento alla procedura n° 7 non presente agli atti. il documento fa riferimento alla procedura n° 8 non presente agli atti	6,00	2,00	
possesso di certificazioni di qualità	sì	il progetto presenta incongruenza tra rinvio indicato al punto 5 rep. personale e quanto indicato nel paragrafo assistenza full risk il n° di celli 348/7607062 nel piano documento risulta attivo dalle 7 alle 21, nel secondo 24/24 riferisce assistenza entro 24h e non 8 nei gg festivi come invece richiesto da Capitolato.	3,00	-	
aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazioni e sanitizzazione (max punti 4)	modalità sanificazione presenza protocollo di sanificazione sì con certificazione	dall'analisi dei percorsi nello schema non è indicato il locale dove vengono collocati i sistemi inoltre l'ingresso dello sporco e del pulito non sembrano divisi l'isciamente, mancano i documenti di sanificazione, in sede di campionatura si è confermata la mancanza dei documenti di sanificazione e la commissione non ha potuto visionarli.	1,00	1,00	
informatizzazione del servizio (max punti 3)	sì	La commissione non ha elementi di valutaz. Non sono indicate neppure le eventuali maschere che possono consentire la valutazione del sistema, applicaz. pratica e contenuti reportistica	3,00	1,50	
MIGLIORIE (max punti 2)	no	Non è uno studio di prevalenza ma un audi effettuato da personale sanitario interno e non dalla ditta	2,00	-	

Struttura organizzativa T.S.S.	Dati rilevati	NOTE	Punti max	Punteggio assegnato
Sede/Distributore n° automezzi	Feretino (FR) 3 - distinzione sporco/pulito	numero inadeguato		
n° personale funzione e tempo dedicato	non dichiarato	solo esplicitate mansioni per qualifica ma non il numero del personale		
locazione centri di sanificazione	Serravalle (Rep. San Marino)	indicazione generica di idoneità alle mansioni		
aggiornamento personale n° ore	interno non specificato			
n° verde	3 tipologie di addestramento: 3 ore illustrazione prodotto e servizio; 2 ore illustrazione utilizzo			
progetto di servizio ospedaliero	modalità richiesta temporistica consegna, installazione, collaudi telefonata e conferma con fax si conforme al capitolato			
STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI (max punti: 6)	tempistica dismissione 5 ore migliorativi rispetto al capitolato			6,00
ASPETTI IGIENICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONE (max punti: 4)	modalità assistenza telefonata e conferma con fax	non si fa menzione del certificato di sanificazione e di sicurezza elettrica; controllo della sicurezza elettrica solo nel caso in cui vengono sostituite delle parti;		1,50
possessione di certificazioni di qualità	si			
modalità sanificazione		Dalla documentazione, non si evince un percorso ben dettagliato sporco-pulito. Manca la pianina dei percorsi e degli ambienti (non si comprende posizionam. griglie asciugatura etc). Il procedim. descritto presenta le seguenti contraddizioni/lacune: relativi ai guanti per tutto il procedimento, non si capisce se ci sono operatori dedicati ad ogni parte del processo o se seguano il materasso. Per quanto riguarda la sanific. delle superfici di appoggio sembra che venga effettuata a fine giornata e non a fine di ciascun processo. La sanificaz. degli attrezzi avviene settimanalim. I cuscinetti interni del materasso sembrano essere lavati solo a freddo e mai in lavatrice. non si comprende come vengano trattati i panni non monouso. Non viene menzionata la pulizia delle parti interne del materasso (connettori, sensori, etc.). le cover passano prima in asciugatore elettrico e successivamente in zona di ventilazione naturale, non se ne comprende il motivo. Per questi motivi la commissione ha ritenuto che il processo di sanificaz. non dia suffic. garanzie di igiene.		3,00
presenza protocollo di sanificazione	si			1,00

INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO (max punti: 3)	progetto di informatizzazione			La commissione non ha elementi di validità del software che pare non sia stato ancora predisposto. Nel documento si parla di demo solo dopo aggiudicazione. Non sono indicate neppure le eventuali maschere che possono consentire la valutazione del sistema, applicaz. pratica e contenuti reportistica.	3,00	-
MIGLIORIE (max punti: 2)	studio prevalenza		no	Non presente	2,00	-
<b>Totale punti</b>					<b>15,00</b>	<b>2,50</b>

W  

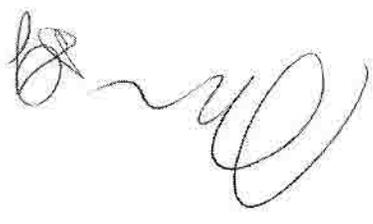Struttura organizzativa SANITARIA SCALIGERA	Dati rilevati		NOTE	Punti max	Punteggio assegnato
Sede/Distributore	Verona (sede centrale)	18 su territorio nazionale, presenza divisione sporco pulito	il dato isale al 10/1/2005 non si conosce la dotazione attuale.		
n° automezzi	20 su territorio nazionale	Verona (sede centrale)	non si evince il n° di personale dedicato al servizio in Liguria. Si dichiara la qualifica OSA per tutto il personale addetto alla consegnaritura dei presidi ma all'allegato E si fa esplicito divieto movimentazione pazienti al personale no OSA.		
n° personale: funzione e tempo dedicato	Chiesa Uzzanese Savona	Roma, Torino, San Marino, Palermo, Centri operativi autorizzati (Genova Caserta e Perugia)	Chiesa Uzzanese dovrebbe servire l'area Levante, Savona l'area Ponente i due centri hanno magazzino autonomo e personale dedicato (non si specifica numero personale e automezzi). Non sono chiare le condizioni di funzionamento dei Centri operativi autorizzati. Se la certificazione presentata riguarda anche il loro funzionamento		
aggiornamento personale n° ore	interno	non esplicitato			
n° verde	ospedaliero	a richiesta sul presidio aggiudicato	non indicato numero ore/docenti/programma	6,00	2,00
progetto di servizio ospedaliero	modalità richiesta	n° verde, fax, web per richiesta, dismissione, installazione, ritiro e manutenzione	sistema GPRS per contatto personale, Centro di smistamento che individua il soggetto più vicino. Sistema computerizzato per ordini ecc.		
progetto di servizio ospedaliero	tempistica consegna, installazione, collaudo	12h sempre 8 per intensive	conforme a capitolato. <u>Contrario alla normativa su privacy: apposizione su nastro adesivo attaccato al presidio di NOME E COGNOME DEL P.Z</u>		
possesto di certificazioni di qualità	tempistica dismissione	24h	conforme a capitolato		
sanificazione	modalità assistenza	n° verde, fax, web per richiesta, dismissione, installazione, ritiro e manutenzione	ampie modalità di richiesta tempistica conforme a capitolato		
ASPETTI IGIENICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONI E SANITIZZAZIONE (max punti 4)	modalità sanificazione	si	Il protocollo presenta diversi aspetti contraddittori: 1) i presidi vengono divisi in due categorie infetti (sacco rosso) e non (sacco giallo) e vengono trattati in modo differente. I presidi, a giudizio della commissione, devono essere trattati tutti allo stesso modo perché non sempre è dichiarata o conclamata l'infezione. 2) mancano i criteri in base ai quali l'operatore decide se sanificare a caldo o a freddo. 3) non si evince come venga effettuata la prova di funzionamento del presidio: non si evince se il motore, che segue un processo di sanificazione differente e viene imbrusato, venga assemblato al presidio e in che fase del processo. 4) alla mappa dei percorsi sembra non esistere la separazione sporco/pulito in fase di entrata/uscita per fine lavorazione. 5) manca il controllo/collaudo sulla parte elettrica a fine sanificazione, tuttavia nel corso della prova pratica tale controllo risulta effettuato e comprovato da idonea documentazione. Per questi motivi la commissione ha ritenuto che il processo di sanificaz. non dia sufficienti garanzie di igiene.	3,00	
INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO (max punti 3)	presenza protocollo di sanificazione progetto di Informatizzazione	si	sistema GPRS per contatto personale, Centro di smistamento che individua il soggetto più vicino. Sistema computerizzato per ordini ecc.	1,00	1,00
MIGLIORIE (max punti 2)	studio prevalenza	si	il documento presentato non è uno studio di prevalenza	3,00	3,00
			il documento presentato presenta le seguenti criticità: 1) mera elecazione di dati che il programma può rilevare 2) manca la parte progettuale e la metodica di rilevazione dei dati 3) alcuni dati risultano non utilizzabili nella forma prevista dal progetto.	2,00	0,50
			<b>Totale punti</b>	<b>15,00</b>	<b>6,50</b>

Struttura organizzativa RHEA	Dati rilevati	NOTE	Punti max	Punteggio assegnato
Sede/Distributore	Mignanego (Ge)			
n° automezzi	21 su tutto il territorio nazionale 12 iveco daily 7 ford transit, 1 opel movano, 1 fiat scudo, presenza divisione sporcio pulito	non si evince quanti mezzi mettono a disposizione per appalto regione Liguria previsione aumento se vincono appalto		
n° personale: funzione e tempo dedicato	18 per la Liguria?	non si evince se il personale segnalato è dedicato solo per il progetto Liguria		
localizzazione centri di sanificazione	Attivole (TV) e Empoli (FI)	disponibilità in caso di aggiudicazione ad attrezzare la sede di Mignanego (GE) come quella di Attivole (TV)		
aggiornamento personale n° ore	non quantificato, non indicate ore formazione			
n° verde	8 ore, 3 livelli formazione, corsi di 4 ore (su corrette indicazioni ai presidi), corsi 2 ore (illustrazione prodotto e gestione del servizio), corso 1 ora (addestramento continuo su utilizzo dei sistemi), corsi 1 ora semestrali su sistema informatico e funzionalità prodotti	manca indicazione programma dettagliato corsi (genetica)		
progetto di servizio ospedaliero	si, 24/24		6,00	2,00
possessione di certificazioni di qualità	modalità richiesta	sistema informatico		
	tempistica consegna, installazione, collaudo	tempistica consegna 10 ore da ricevimento richiesta.	non previste altre forme alternative al web il servizio di assistenza del sistema informatico è attivo solo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19. <b>ESSENDO UNICO SISTEMA PER ACCEDERE AI SERVIZI DOVREBBE ESSERE ATTIVO 24/24 per 365 gg/anno</b>	
	tempistica dismissione	entro 12 ore	tempistica migliorativa rispetto al capitolato	
	modalità assistenza	web/telefonico, tempistica riparazione, intervento entro 4 ore dalla comunicazione	tempistica migliorativa rispetto al capitolato	
ASPETTI IGIENICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONI E SANITIZZAZIONE (max punti 4)	si	il materasso viene sballato direttamente sul furgone e disinfettato su di esso per evitare che materiale contaminato entri in officina. Tale modalità non convince. Manca la piantina e progetto sanificazione, indicazione percorsi, sporcipulito. Per questi motivi la commissione ha ritenuto che il processo di sanificaz. non dia suffic. garanzie di igiene	3,00	
INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO (max punti 3)	si	il servizio di assistenza del sistema informatico è attivo solo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19. <b>ESSENDO UNICO SISTEMA PER ACCEDERE AI SERVIZI DOVREBBE ESSERE ATTIVO 24/24 per 365 gg/anno.</b> Il procedimento informatico seguito non risulta di facile utilizzo per personale sanitario	1,00	1,00
MIGLIORIE (max punti 2)	no	assente in quanto le ipotesi fornite non sono uno studio di prevalenza	2,00	


Struttura organizzativa KCI - Vivisol		Dati rilevati		NOTE	Punti max	Punteggio da riepilogo
Sede/Distributore		Genova - 380 m2 di superficie dedicata per la Liguria				
n° automezzi		13 dedicati per la Liguria - accessi separati (pulito/sporcio); deterzione-disinfezione-sanificazione per ogni tipo di trasporto; ogni 2 anni vengono cambiati				
n° personale: funzione e tempo dedicato		25 tecnici dedicati per la Liguria (di cui 13 solo per le consegne); 8 tecnici sanificatori KCI		previsto, in caso di aggiudicazione e al volume dell'attività, un aumento del personale dedicato (Vivisol)		
locazione centri di sanificazione		Assago (Milano), Torino, Firenze		per lo stoccaggio dedicato la sede è in Genova/ase necessario vengono utilizzati i centri di stoccaggio di Ivrea e di Milano; il servizio prevede un collegamento con navette)		
aggiornamento personale n° ore		interno	previsti corsi di formazione dedicati, in base al ruolo ricoperto. Almeno 2 aggiorn.annui per un totale di 16 ore			
n° verde		ospedaliero	minimo 5 ore per Presidio Ospedaliero + 8 ore di corsi dedicati a tutto il personale coinvolto (rif. Pag 34). Totale 13 ore	previsto per la fase di avvio del presidio e tutte le volte che viene richiesto; allegato 4 (documentazione tecnica) piano di formazione dettagliato	6,00	
		modalità richiesta	si -24/24			
		tempistica consegna	fax-mail-n. verde (presidiati 24/24 ore), software			
		installazione	6 ore solari con ricevimento 24 ore	manutenzione straordinaria ogni 3 mesi (nel continuativo); sostituzione ogni 6 mesi (nel continuativo).		5,50
		tempistica dismissione	24 ore - conforme al capitolato			
progetto di servizio ospedaliero		modalità assistenza	fax-mail-n. verde (presidiati 24/24 ore), software			
possesso di certificazioni di qualità			si (KCI-Vivisol)	sanificazione (certificata) e percorso di sanificazione (certificato) aggiornamento della certificazione 02/12/2010		
sanificazione		modalità sanificazione	altamente dettagliata per tutti i tipi di superficie (allegato 10);	manca la piantina del percorso di sanificazione, ma è stata fornita descrizione dettagliata delle aree di sanificazione: area di arrivo-area cleaning-area lavanderia-area piegatura e test-area manutenzione-area rent.	3,00	3,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI (max punti 6)

ASPETTI IGIENICI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONI E

Struttura organizzativa KCI - Vivisol	Dati rilevati		NOTE	Punti max	Punteggio da riepilogo
	presenza protocollo di sanificazione	si			
SANITIZZAZIONE (max punti 4)	progetto di informatizzazione	si	sanificazione (certificata) e percorso di sanificazione (certificato): aggiornamento della certificazione 02/12/2010	1,00	1,00
INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO (max punti 3)	studio prevalenza	si	il personale tecnico è dotato di sistema portatile (PDA); l'aggiornamento delle movimentazioni avviene ogni 15 minuti. Consegna reportistica mensilmente; possibilità di visualizzazione direttamente tramite sistema informatico	3,00	3,00
MIGLIORIE (max punti 2)			scheda raccolta dati completa (cartacea e informatica); progettazione completa ed esaustiva; non viene dichiarato chiaramente chi esegue nei reparti lo studio di prevalenza	2,00	2,00
<b>Totale punti</b>				<b>15,00</b>	<b>14,50</b>






Struttura organizzativa Hill- Rom		Dati rilevati		NOTE	Punti max	Punteggio assegnato
Seede/Distributore		Ditta ERO Snc di Genova				
n° automezzi		36 furgoni allestiti per tutta Italia (Hill Rom)		non si evince se i mezzi hanno la divisione sporco/pulito		
n° personale: funzione e tempo dedicato		7 tecnici dedicati (Ditta ERO)		sanificazione presso Milano con servizio navetta (mancano le specifiche per il servizio navetta); possibilità di sanificazione dei presidi presso la Ditta ERO di Genova		
locazione centri di sanificazione		sede centrale di Milano/possibilità di sanificazione a Genova- Ditta ERO		training e test on line (livello Basic o Advance); manca il dettaglio dei programmi di aggiornamento; non si evince quale percorso formativo viene proposto ai tecnici della Ditta ERO di Genova		
aggiornamento personale n° ore		40 ore (5 giorni annui)		il personale verrà formato al momento dell'installazione del presidio da personale incaricato. E' presente un programma di massima per gli operatori (Safe Skin). Manca un programma specifico di formazione ( n.ore, argomenti trattati...)		
n° verde		no			6,00	3,50
progetto di servizio ospedaliero	modalità richiesta	Call Center 24/24 ore per 365 giorni-on line 24/24 ore per 365 giorni				
	tempistica consegna, installazione	installazione entro le 8 ore- intensiva entro le 6 ore		leggermente migliorativo		
	tempistica dismissione	18 ore		leggermente migliorativo		
possesso di certificazioni di qualità	modalità assistenza	Call Center 24/24 ore per 365 giorni-on line 24/24 ore per 365 giorni		mancano i certif. di sanificazione e di sicurezza elettrica al momento della consegna del presidio; la bolla di accompagnamento verrà trasmessa tramite fax successivamente alla consegna del presidio (non si evince se i documenti di certificazione per la sanificazione e per la sicurezza elettrica siano parte integrante della bolla di		
	sanificazione	si		Non si evince come vengano trattate le spugne poliuro dopo l'utilizzo. Visto che la documentaz. Indica anche la ditta Hero come possibile sanificatore manca la piantina del locale di sanificaz. Hero e per quanto riguarda le procedure è presente una dichiraz. di Hill rom che Hero utilizza le sue stesse procedure di sanific. nelle istruz. di lavoro non è ben chiaro quali prodotti vengano utilizzati per la sanificaz.	3,00	2,50
INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO max punti 3	progetto di sanificazione	si			1,00	1,00
	Informattizzazione	si (Therapy online)			3,00	3,00
MIGLIORIE max punti 2	studio prevalenza	si		Il software sembra avere ottime potenzialità, dalla documentaz. presentata si evince la possibilità di avere uno buon studio di prevalenza su scala regionale con completezza di dati	2,00	1,90
				<b>Totale punti</b>	<b>15,00</b>	<b>11,90</b>

## Allegato 3

### Scheda di valutazione tecnica dei lotti



Scheda valutazione Lotto 1

Sistemi antidecubito a riduzione pressoria continua senza elettrocompressore per la prevenzione e/o il trattamento delle lesioni fino al II stadio;

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Dati rilevati - Lotto 1		Punteggio assegnato - Lotto 1
		Hill Rom	Punti max	
Struttura organizzativa personale e mezzi impiegati	Sede/Distributore: Numero automezzi Numero personale: funzione e tempo dedicato Localizzazione centri di sanificazione Aggiornamento personale: numero ore Numero verde Possesso di certificazioni di qualità Progetto di servizio ospedaliero	Hill Rom	6	Hill Rom P330 Wound Surface 3,50
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione	Modalità di lavaggio, sanificazione e asciugatura del sistema (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, ecc.) Possesso di certificazioni di qualità del percorso di sanificazione	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	3	2,50
Informattizzazione del servizio	Progetto di studio di prevalenza inerente le lesioni da pressione		1	1,00
Migliorie	Progetto di informatizzazione del servizio : richieste dismissioni, informazioni e reportistica delle attività di sanificazione		3	3,00
Principio di funzionamento	Presenza di modalità di scarico dinamico delle pressioni di contatto Scarico delle pressioni in relazione alle differenti zone corporee (anche con modalità differenti) Portata terapeutica in kg (> 120 kg): (a maggior portata corrisponderà maggior punteggio) Praticità d'uso (peso materasso, telo di copertura, maneggevolezza del sistema, versatilità dimensioni)	si testa e schiena sacrale cosce talloni 60 kg in più del richiesto La CPR a strappo corto può rimanere incastrata durante il rifacimento del letto	5	5,00 4,00 5,00 3,00
Comfort paziente	Possibilità di piegamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio Stabilità e mantenimento della postura (prova del fondo)	buon piegamento e funzione terapeutica materata non si sente il fondo a 90°	4	4,00 4,00
Comfort operatore	Facilità ad eseguire le manovre di nursing Facilità di sanificazione della cover (a maggior semplicità/praticità di sanificazione "d'urgenza" della cover corrisponderà maggior punteggio)	si cover spessa	4	4,00 2,00
<b>TOTALE PUNTI</b>			<b>50</b>	<b>42,90</b>
<b>AMMESSO</b>				<b>si</b>

Scheda valutazione Lotto 2  
 Sistemi a bassa pressione alternata per la prevenzione delle lesioni da pressione nei pazienti a medio rischio;

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Offri il servizio Lotto 2				Punteggi attribuiti Lotto 2				
		Risposta Alpha Response	TSS Dual/Revo	Scaricare Pulsar Choice MR	Pnea Air Express P280DF	Reparti Alpha Response	TSS Dual/Revo	Scaricare Pulsar Choice MR	Pnea Air Express P280DF	Hill Rom Pump
Struttura organizzativa personale e mezzi impiegati	<p>Selezione Distributore</p> <p>Numero personale, funzione, e tempo dedicato</p> <p>Localizzazione centri di sanificazione</p> <p>Aggiornamento personale, numero ore</p> <p>Processo di certificazioni di qualità</p> <p>Modalità di servizio ospedaliero</p>	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	2,00	1,50	2,00	2,00	3,50			
	<p>Modalità di servizio, sanificazione e asciugatura del sistema (materasso, letto, unità motora, tubi di collegamento, etc.)</p> <p>Fossesso di certificazioni di qualità del personale di sanificazione</p>	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50			
Informatizzazione del servizio	<p>Progetto di informatizzazione del servizio</p> <p>Software, hardware, informazioni e reperibilità delle attività di noleggio</p> <p>Progetto di studio di prevenzione infortuni da pressione</p>	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
	<p>Presenza di materiali di scarico dinamico delle pressioni di contatto</p>	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	1,50	0,00	3,00	0,00	3,00			
Migliorie	<p>Scambio delle pressioni in relazione alle differenti zone corporee (braccia con manopole differenti)</p>	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
	<p>Funzione trasorto (+ di 3 ore) la maggior durata corrisponda maggior punteggio)</p>	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	1,00	0,00	0,50	0,50	2,00			
Principio di funzionamento	<p>Portata (da 10 a 120 kg) la maggior portata corrisponda maggior punteggio)</p>	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	2,00	1,20	2,00	2,00	1,20			
	<p>Accessibilità e facilità di utilizzo della valvola CPR</p>	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	1,50	3,00	3,00	3,00	1,10			
Sicurezza	<p>Capacità di sopportare il peso del paziente</p>	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	1,00	0,10	0,50	0,10	1,00			
	<p>Praticità di uso in dimensioni di comodo</p>	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Impianto elettrico	<p>Praticità di installazione del caso elettrico in base alle esigenze del reparto (elettrico, idraulico, pneumatico)</p>	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25			
	<p>Praticità di compressione del motore a mazzetta, pulizia etc</p>	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	0,25	2,00	2,00	2,00	2,00			
Sicurezza	<p>Praticità di compressione del motore a mazzetta, pulizia etc</p>	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			
	<p>Peso unita motore in minor peso corrisponda maggior punteggio)</p>	Vedi all. 2 Scheda valutazione servizio	1,75	0,50	0,71	1,00	0,60			

*[Handwritten signature and initials]*

Scheda valutazione Lóto 2  
 Sistemi a bassa pressione continua/ alternata per la prevenzione delle lesioni da pressione nei pazienti a medio rischio;

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Dati rilevati Lóto 2				Punti max	Punteggi attribuiti Lóto 2					Totale
		Recordini Alpha Response	TSS Dual/Revo	Scaliera Pulsar, Clinica MR	Rieca Air Express P230DF		Hil Point Firmo	Riparandi Alpha Response	FSS Dual/Revo	Scaliera Pulsar Clinica MR	Rieca Air Express P230DF	
Unità motore	Estetica: Dimensioni (a magnifico estetico), a minor vibrazioni, a minori dimensioni (portabilità) maggior punteggiato	5304	7965	12879	10695	1	0,66	0,41	0,49	1,00		
	Rumorosità della pompa (certificazione su db*) (a minor rumorosità corrisponderà maggior punteggiato)	20	28	15	26	1	0,54	1,00	0,54	0,39		
Comfort paziente	Stabilità e mantenimento della postura (zona del letto)	si sente parzialmente il fondo a 90°	si sente parzialmente il fondo a 90°	si sente il fondo a 90°	si sente parzialmente il fondo a 90°	4	3,00	2,00	3,00	4,00		
	Possibilità di pigiamento per uso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio	buon pigiamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialmente alterata	buon pigiamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialmente alterata	buon pigiamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere alterata	buon pigiamento, ma funzione terapeutica potrebbe essere parzialmente alterata	2	1,80	1,50	1,80	2,00		
Comfort operatore	Facilità di utilizzo del sistema e dei comandi (teorologia e posizione)	display con poco contrasto/poco visibile	comandi in inglese con simbologia non di semplice interpretazione, blocco automatico della tastiera	poco pratico il blocco automatico della tastiera	comandi della regolazione del comfort a manipolo si espongono a rischio di errore, analogia considerazione vale per la presenza di pulsanti esterni e non di touch screen	2	0,20	1,50	0,20	2,00		
	Facilità di sanificazione della cover (a	si	si	si	si	1	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Facilità ad eseguire le manovre di nursing	tubo rigido ostacola manovre nursing	la CPR poco pratica nel riposizionamento in sede, tubo rigido, comandi in inglese con simbologia non di semplice interpretazione, blocco automatico della tastiera	tubo rigido voluminoso rende difficili manovre di nursing	compressione difficoltosa, sul motore è presente la dicitura CPR, ma altra stessa non corrisponde la vera applicazione, pulizia del motore non facile per presenza di elementi in rilievo	2	0,20	1,00	0,20	2,00		
	TOTALE PUNTI AMMESSO					50	27,42	31,92	27,98	33,26		

*Handwritten signatures and initials.*



Scheda valutazione Lotto 3

Sistemi a pressione alternata / fluttuazione dinamica per la prevenzione delle lesioni da pressione in pazienti ad alto rischio o/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al III° stadio.

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Dati nuovi Lotto 3				Punteggi attribuiti Lotto 3				Punti Max			
		Ricordi Autologic	TSS	Scaligera	ATI KOI-Vivoli Innova Extra O.L.	H&Rom Car Active Plus	Ricordi Autologic	TSS	Scaligera		ATI KOI-Vivoli Innova Extra O.L.	H&Rom	
	<p>telo di copertura inantepervolezza del sistema (versatilità dimensionali)</p> <p>Alarmi (tolleranza e parametri segnalabili) (ad una più ampia gamma di allarmi (acustici, visivi e parametri segnalati) corrisponderà maggior punteggio)</p>	si	tubo verso l'esterno ingombrante attacco difficile -occhia moschettone	7 tubo e ripido e ingombrante e di difficile gestione	si	si	1,00	0,10	0,50	1,00	1	1,00	3
Sicurezza	<p>Alarmi (tolleranza e parametri segnalabili) (ad una più ampia gamma di allarmi (acustici, visivi e parametri segnalati) corrisponderà maggior punteggio)</p>	4	2 di difficile intercettazione e suona ogni fine ciclo. Per farlo il punteggio per il rischio degli allarmi sale da 1 ma viene operata una penalizzazione di 0,50.	8 la prova pratica ha evidenziato che il prodotto di Scaligera ha un tono di allarme molto basso e difficilmente udibile in un contesto di reparto (penalizzazione 1 punto) la prova pratica ha evidenziato che in mancanza di alimentazione l'allarme NON è scattato (penalizzazione 0,50)	5	10	1,00	0,50	1,70	2,00	4	1,00	4,00
Impianto elettrico	<p>Possibilità di sostituzione del cavo elettrico/sipha in base alle esigenze della rete elettrica delle singole unità operative</p>		spinnotto intercambiabile	spinnotto intercambiabile			0,25	2,00	2,00	2,00	2	0,25	2,00
	<p>Praticità di connessione del motore al materasso, pulizia, etc.</p>		la connessione al motore risulta poco funzionale perché la rigida del tubo tende a forare il connettore verso il basso, senza però provocarne la rottura	connessione in plastica attaccata direttamente al tubo. La connessione provoca la torsione del tubo			0,50	0,50	0,25	1,00	1	0,50	1,00
Unità motore	<p>Peso unità motore (a minor peso corrisponderà maggior punteggio)</p> <p>Esplicita Dimensione (la migliore estesa a minor vibrazione, e minori dimensioni corrisponderà maggior punteggio)</p>	2,75	2-5	3,4	2,9	4,8	0,81	1,00	0,74	0,86	1	0,81	0,54
	<p>Puntuosità della pompa (certificazione ISO 9001) (a minor umidità corrisponderà maggior punteggio)</p>	13:25	7:05	12:54	12:54	13:00	0,61	1,00	0,92	0,63	1	0,61	0,42
	<p>Stabilità e mantenimento della postura (prova del fondo)</p> <p>Possibilità di pigramento per uso su letti articolari senza alterare le funzioni terapeutiche dell'ausilio</p>	23	26	15	30	35	0,75	0,54	1,00	0,50	1	0,75	0,43
Comfort paziente	<p>Facilità di installazione della cover (a maggior semplicità pratica di installazione corrisponderà maggior punteggio)</p>		si	si	si	si	3,00	3,00	2,00	4,00	4	3,00	3,00
	<p>Facilità di sanificazione della cover (a maggior semplicità pratica di sanificazione corrisponderà maggior punteggio)</p>		in sede di prova si è evidenziato che per spegnere l'allarme acustico occorre resettare il sistema staccando la spina	contatti in inglese con simbologia non di semplice interpretazione blocco automatico della tastiera	buon pigramento, ma funzione terapeutica potrebbe essere alterata	buon pigramento e funzione terapeutica potrebbe essere alterata	1,90	1,80	1,80	2,00	2	1,90	1,80
Comfort operatore	<p>Facilità di acquisire la manovra di nursing</p>		tubo-riquadro ostacola manovre nursing	tubo-riquadro voluminoso rende difficile manovre di nursing	tubo flessibile non ostacola manovre nursing	tubo flessibile non ostacola manovre nursing	1,50	0,20	1,50	2,00	2	1,50	2,00
	<p>Facilità di acquisire la manovra di nursing</p>		tubo-riquadro ostacola manovre nursing	tubo-riquadro voluminoso rende difficile manovre di nursing	tubo flessibile non ostacola manovre nursing	tubo flessibile non ostacola manovre nursing	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1,00	1,00
	<p>Facilità di acquisire la manovra di nursing</p>		tubo-riquadro ostacola manovre nursing	tubo-riquadro voluminoso rende difficile manovre di nursing	tubo flessibile non ostacola manovre nursing	tubo flessibile non ostacola manovre nursing	1,50	0,20	1,00	2,00	2	1,50	2,00
							28,15	33,00	28,98	44,70	50	28,15	39,04
							TOTALE PUNTI						

**Scheda valutazione Lotto 4**  
**Sistemi per la prevenzione dei pazienti ad altissimo rischio e/o il trattamento delle lesioni al IV stadio di varia tecnologia in grado di gestire la macerazione cutanea.**

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Dati Rilevati Lotto 4					Punteggi attribuiti Lotto 4					
		Ricordabili	Scaligera	Reha	ATI KCI-Viscol	Hill Rom	Punsi max	Ricordabili	Scaligera	Reha	ATI KCI-Viscol	Hill Rom
Struttura organizzativa personale e mezzi impiegati	Sede/Costruttore:	Nimbus 3	Quattro Anelli	Auto Sure Float	Innova Extra MRS	Clear Active Plus MCM	6	2,00	2,00	2,00	5,50	3,50
	Numero personale, funzione e tempo dedicato											
	Localizzazione centri di sanificazione											
	Addebiatamento personale, numero ore											
	Numero verde											
	Progetto di servizio ospedaliero											
	Modalità di avvio, sanificazione e asciugatura del sistema (materasso, letto, unità motore, tubi di collegamento, ecc.)	Vedi art. 2 Scheda valutazione servizio										
	Processo di certificazione di qualità del percorso di sanificazione											
	Progetto di informatizzazione del servizio (richieste, disposizioni, informazioni e reportistica delle attività di noleggio)											
	Progetto di studio di prevalenza inibente le lesioni da pressione											
Miglioria	Presenza di funzionalità di scarico dinamico nelle prestazioni di contatto	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì						
	Scarico delle pressioni in relazione alle differenti zone corporee (anche con mobilità differenti)	3 zone: testa torace gambe										
	Funzione trasposto (r. di 3.015) (e maggior durata corrispondenti, maggior punteggio)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì						
	Funzionalità (esemplificativa in kg (r. 120 kg) (e maggior lavoro corrispondente maggior punteggio)	120	130	130	60	40						
	Accessibilità e facilità di utilizzo della valvola CPR	valvola a farfalla, zona piedi poco pratica e angusta										
	Caratteristiche migliorative del letto di copertura	no	no	no								
	Peso (n. dimetri chi)	10,3	12,2	7	11,6	16	0,5	0,34	0,27	0,30	0,30	0,22
	Maneggevolezza	2	3	7	2	1	0,6	0,14	0,21	0,30	0,14	0,07
	Maneggevolezza											
	Sicurezza	Algoritmi (logica e parametri regolati) per una più ampia gamma di azioni (accendi, spegni e soppressi) esprimibili con diverse manovre (punteggio)	1			5	10					
Possibilità di assistenza da parte dell'operatore in base alle esigenze della rete elettrica delle singole unità operative		lo spuntino di compressione non è intercambiabile ma connesso al motore										
Facilità di connessione del motore al motore/lego pulizia, ecc		la compressione al motore risulta poco funzionale per via della sigilla del tubo										
Peso unità motore (e minor peso corrispondente motore motore)		5,7	3,4	4,3	2,9	4,6						
Piano elettrico	Possibilità di assistenza da parte dell'operatore in base alle esigenze della rete elettrica delle singole unità operative	lo spuntino di compressione non è intercambiabile ma connesso al motore										
	Facilità di connessione del motore al motore/lego pulizia, ecc	la compressione al motore risulta poco funzionale per via della sigilla del tubo										
	Peso unità motore (e minor peso corrispondente motore motore)	5,7	3,4	4,3	2,9	4,6						

*[Handwritten signatures and initials in the top left corner]*



Scheda valutazione lotto 5  
 Sistemi a reale cessione d'aria per la prevenzione dei pazienti ad altissimo rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al IV stadio per terapia intensiva.

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Parametri rilevati Lotto 5 ATI KCI-VivoS Thera-Kair VivoS	Punti max	Punti attribuiti Lotto 5 ATI KCI-VivoS Thera-Kair VivoS
Struttura organizzativa personale o mezzi impiegati	Sede/Distributore.			
	Numero automobili. Numero personale: funzione e tempo dedicato. Localizzazione centri di sanificazione. Addebiatamento personale: numero ore. Numero veicoli. Possesso di certificazioni di qualità. Progetto di servizio ospedaliero.		6	5,50
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanitizzazione	Modalità di lavaggio, sanificazione e asciugatura del sistema (materasso, telo, unità motore, tubi di collegamento, ecc.).	Vedi art. 2. Scheda valutazione servizio	3	3,00
	Possesso di certificazioni di qualità del percorso di sanificazione		1	1,00
Informatizzazione del servizio	Progetto di informatizzazione del servizio: richieste, distinzioni, informazioni e reportistica delle attività di noleggio		3	3,00
	Migliorie		2	2,00
Principio di funzionamento	Presenza di modalità di scarico dinamico delle pressioni di contatto.	si	2	2,00
	Scarico della pressione in relazione alle differenti zone corporee (anche con modalità differenziali)		3	2,00
	Funzione trasporto (> di 3 ore) (a maggior durata corrisponderà maggior punteggio)	non indicate quante ore di funzione di trasporto in più rispetto alle 3	2	
	Portata terapeutica in kg (> 120 kg) (a maggior portata corrisponderà maggior punteggio)	15	2	2,00
	Accessibilità e facilità di utilizzo della valvola CPR	si	2	2,00
	Caratteristica migliorativa del telo di copertura	ore (ex	1	1,00
	Praticità d'uso (peso materasso, telo di copertura, maneggevolezza del sistema, versatilità dimensioni)	13,2	1	1,00
	Qualità della manutenzione curativa	2	1	1,00
	Alarmi (tipologia e parametri segnalati) per una più ampia gamma di alarmi (acustici, visivi) e parametri segnalati corrispondenti	si	3	3,00
	Possibilità di sostituzione del cavo elettrico/spina in base alle esigenze della rete elettrica delle singole unità operative	si	2	2,00
Impianto elettrico	Praticità di connessione del motore al materasso, puzza, etc	si	1	1,00
	Peso unità motore (a minor peso corrisponderà maggior punteggio)	6,3kg	1	1,00
Unità motore	Estracar/Dimensiori (a migliore estracar a minor variazione a minor dimensioni corrisponderà maggior punteggio)	23814	1	1,00
	Rumidità della pompa (certificazione sui db?) (a minor rumorosità corrisponderà maggior punteggio)	39	1	1,00
Comfort paziente	Stabilità e mantenimento della postura (prova del torzo)	non si sente il torzo a 90°	2	2,00
	Possibilità di piegarlo per viso su letti articolati senza alterare le funzioni terapeutiche dall'ausilio	si	2	2,00
Comfort operatore	Facilità di utilizzo del sistema e dei comandi (tecnologia e posizione)	si	2	2,00
	Facilità di sanificazione della cover (a maggior semplicità/praticità di sanificazione (a maggior semplicità/praticità di sanificazione corrisponderà maggior punteggio)	si	1	1,00
	Facilità ad eseguire le manovre di nursing	si	2	2,00
	<b>TOTALE PUNTI AMMESSO</b>		<b>50</b>	<b>46,50</b>
				si

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

## **ALLEGATO N. 4**

ALLA DELIBERAZIONE N. 84 DEL 22/12/2011

### **Integrazione del verbale del 07/11/2011**

### **Seduta del 07/12/2011**

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di "Sistemi antidecubito" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre - Lotti n. 5.

REGIONE LIGURIA

Commissio  
Centrale Regionale Acquisti  
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo n. 176.1  
del 07/12/2011

Integrazione al verbale del 07/11/2011

La Commissione Giudicatrice della gara di cui all'oggetto, nelle persone del:

- Dott. Antonino MASSONE, Direttore dell'Unità Spinale dell' Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ASL 2 Savonese – Presidente;
- Dott. Giovanni A. CHECCHIA - Direttore S.C. RRF Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ASL 2 Savonese – Componente;
- Sig.ra Deborah GRANARA – Infermiere Specializzato in Wound Care N.O. Lesioni Cutanee, ASL 3 Genovese – Componente;

premettono quanto segue:

- Il verbale di valutazione delle offerte tecniche è stato pubblicato sul sito della Centrale in data 13/10/2011;
- la Commissione si è riunita nuovamente in data 07/11/2011 presso gli uffici della Centrale per visionare le richieste di chiarimenti pervenute fino a quella data da parte di alcune Ditte Partecipanti e che di suddetta riunione è stato redatto verbale;
- che in tale data si è stabilito di fissare per il giorno 7 dicembre 2011 la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche;
- che in data 28/11/2011 è pervenuta agli uffici della Centrale la nota della Ditta Ricordini del 18/11/2011 (prot. n. 1696 del 28/11/2011);
- che la Stazione appaltante ha provveduto in data 29/11/2011 a inoltrare la suddetta nota ai membri della Commissione Giudicatrice, tramite posta elettronica;
- che non è stato possibile convocare una riunione della Commissione Giudicatrice in tempi compatibili con la data di apertura delle offerte economiche prevista per il giorno 07/12/2011.

Tuttavia i membri della Commissione Giudicatrice si sono consultati e hanno valutato come segue i rilievi posti dalla Ditta Ricordini con suddetta nota del 18/11/2011.

#### **Struttura organizzativa:**

**N° personale: funzione e tempo dedicato**

#### **Noi abbiamo scritto nei documenti di gara:**

Tre persone dedicate per la Liguria, previsione di aumento dell'organico in caso di aggiudicazione dell'appalto

#### **La Commissione scrive:**

Numero inadeguato, previsione aumento se vincono appalto.

Vorremmo sapere a quale titolo viene reputato inadeguato in quanto la "fotografia" da noi fatta fa riferimento al momento attuale dove la struttura aziendale è perfettamente in grado di gestire tutta la filiera del noleggio dei sistemi antidecubito al momento a noi affidata e del resto, come da noi scritto e dalla Commissione riportato, viene prevista un'implementazione dell'organico in caso di aggiudicazione dell'appalto con organizzazione già prevista e la cui attuazione è condizionata dall'esito della gara.

La Commissione rileva che il capitolato tecnico prevedeva, tra gli elementi di valutazione, il numero degli operatori da dedicare in esclusiva al servizio della Regione Liguria.

La Ditta ha indicato il personale attualmente dedicato al servizio (n.3 persone) che sono state giudicate dalla Commissione insufficienti.

Non si può esprimere una valutazione completa sul progetto organizzativo in presenza di una generica indicazione di "implementazione dell'organico".

### **Aggiornamento personale n° ore**

Premesso che la Commissione fa una distinzione tra aggiornamento interno ed ospedaliero non prevista dal Capitolato Tecnico

**Noi abbiamo scritto nei documenti di gara:**

Non meno di 16 ore

**La Commissione scrive:**

Manca indicazione contenuti

**Nel ns. allegato scriviamo:**

**"ad esse (alle persone che eseguono le mansioni) è dedicato annualmente un servizio di aggiornamento il cui numero di ore è variabile a seconda se Vi siano migliorie dei sistemi in essere e/o introduzione di nuovi prodotti nella gamma dei presidi a listino, e comunque non inferiori a 16."**

Crediamo sia implicito che i contenuti riguardino tutti gli aspetti relativi ai sistemi antidecubito sia dal punto di vista commerciale che tecnico (manutenzione preventiva ed assistenza tecnica in caso di guasto per modifiche intervenute nelle apparecchiature per i test e/o nei ricambi), visto che si parla, senza possibilità di incorrere in errore, di sistemi antidecubito.

**Noi scriviamo (per quello ospedaliero):**

**"è rivolto (il training ospedaliero) a tutto il personale infermieristico con obiettivo la presentazione dei Sistemi Antidecubito loro caratteristiche, indicazioni e controindicazioni, criteri di scelta, corretto utilizzo, prove pratiche. Il programma prevede:**

**• n° 2 corsi teorico-pratici direttamente presso i reparti utilizzatori al personale addetto con modalità da concordarsi con la Direzione Sanitaria e l'Ufficio Infermieristico"**

**La Commissione scrive:**


Manca indicazione contenuti; manca il numero delle ore previste per l'aggiornamento.

Noi riteniamo che i contenuti siano ben espliciti nella parte iniziale. Comunque, visto le considerazioni effettuate dalla commissione, riteniamo di ulteriormente precisare quanto segue il numero delle ore rientra nelle **"modalità da concordarsi con la Direzione Sanitaria e l'Ufficio Infermieristico"** in quanto, essendo diverse le tipologie di rischio coperte con sistemi diversi come vari sono i Reparti utilizzatori, abbiamo creduto dare la giusta importanza a queste strutture che riteniamo le più indicate per rapportare il numero delle ore da dedicare al training alla realtà organizzativa ospedaliera specifica.

In considerazione della struttura e dell'organizzazione ospedaliera abbiamo ritenuto, per correttezza,

non indicare un numero preciso di ore in quanto difficilmente stimabile ma è palese che per l'attuazione

del programma di training occorre un congruo numero delle stesse.



*La Commissione precisa che il punteggio globale non è stato penalizzato dal numero di ore o dall'assenza dei contenuti dei corsi di aggiornamento, bensì da:*

- mancata indicazione di ore per aggiornamento ospedaliero;
- assenza di numero verde;
- presenza di tutta una serie di criticità evidenziate nella scheda di valutazione del progetto di servizio ospedaliero.

## **SANIFICAZIONE: modalità di sanificazione**

A seguito delle rilevazioni effettuate dalla Commissione al punto **Sanificazione>>> modalità di sanificazione** precisiamo quanto segue:

- dal riesame della piantina dei locali di sanificazione dove è indicato il "percorso" seguito dai sistemi antidecubito ci pare evidente dove "si ferma lo sporco" e quali sono i locali adibiti ad "accogliere" il pulito.
- La divisione "fisica" degli ingressi ed uscite di sporco e pulito non è segnato sulla piantina per mero errore materiale.

Relativamente alla mancanza dei documenti di sanificazione che la Commissione dichiara di non aver potuto visionare neanche in sede di campionatura ricordiamo che, in sede di esame della stessa il giorno 14 giugno 2011, alla Commissione era stato chiarito dal Sig. Ricordini che i sistemi campionati erano unità demo e come tali utilizzati e non unità utilizzate per l'espletamento del servizio in ambito ospedaliero con allegata la documentazione (tagliando) dell'avvenuto processo di sanificazione.

Tale documento non era richiesto dal Capitolato altrimenti ci saremmo preoccupati di allegarlo.


Infine riteniamo opportuno rammentare che il punteggio a Noi attribuito pari a 0 (zero) mal si concilia con le procedure di controllo che sottostanno al riconoscimento del Sistema di Qualità ISO 9001-2008 in nostro possesso.

*La Commissione precisa che il punteggio attribuito dalla Commissione non è influenzato dalle verifiche sulla campionatura effettuate il giorno 14 giugno, bensì dalla poca chiarezza nella documentazione presentata (che peraltro la stessa Ditta conferma essere insufficienti per mero errore materiale) sui percorsi di sanificazione. D'altro canto la Commissione giudicatrice non aveva altro modo per poter valutare i percorsi di sanificazione, se non la documentazione presente agli atti.*

## **INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO:**

La Commissione scrive che "non ha elementi di valutazione. Non sono indicate neppure le eventuali maschere che possono consentire la valutazione del sistema, applicazione pratica e contenuti della reportistica".

Nel progetto di informatizzazione da noi illustrato viene indicato, come richiesto da Capitolato, che l'accesso al sito sia protetto da USERID e PASSWORD. Qualora la Commissione ne avesse fatta richiesta si sarebbe provveduto a creare un accesso temporaneo per dar modo alla stessa di valutare appieno la funzionalità dello stesso: anche in sede di esame della campionatura, vista la presenza sul luogo di esame della stessa del legale rappresentante Sig. Ricordini Mauro, la Commissione avrebbe potuto chiedere in "real time" il rilascio delle credenziali necessarie e con una semplice telefonata ai ns. uffici i membri della stessa avrebbero avuto a disposizione gli strumenti per un esame più approfondito e per l'assegnazione di un punteggio sicuramente più elevato.

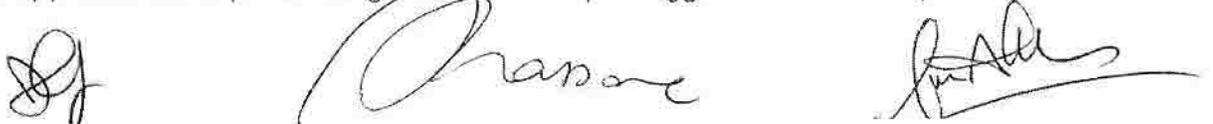

*La Commissione rileva che la richiesta di un progetto di informatizzazione, presupponeva la presentazione di un prodotto nel modo più esauritivo possibile tra i documenti di gara (es. CD Demo o anche più semplicemente la stampa delle maschere del programma).*

## **LOTTO 2**

### **Scarico delle pressioni in relazione alle differenti zone corporee (anche con modalità differenti).**

La commissione considera solo 2(due) zone, ma lo scarico delle pressioni nelle differenti zone corporee (testa- tronco -gambe) viene dal nostro sistema garantito tramite sensore di superficie attivo, che esercita un controllo pressorio continuo con il conseguente adeguamento della superficie in funzione della postura assunta, della distribuzione dei pesi e delle dimensioni del paziente sia in modalità attiva che reattiva.

*La Commissione precisa che le zone differenziate prese in considerazione sono:*

- *La sezione a supporto uniforme per la testa (dove si dovrebbe trovare la bassa pressione continua)*
- *La sezione tronco sacrale (che agisce su gambe e talloni) che può essere sia attiva che reattiva a seconda che il presidio sia utilizzato con pressione alternata o continua. (pg. 3 all. A).*

*Inoltre a pag. 4 del All. A è indicato che il controllo delle pressioni è automatico, ma dopo la pre-impostazione del peso del paziente.*

### **Accessibilità e facilità di utilizzo della valvola CPR**

La CPR si trova sul lato sinistro zona testa paziente. Il dato riportato nella scheda (zona talloni) è un refuso.

Per quanto da Voi affermato "lato opposto manovre rianimatorie" non è elemento discriminante in quanto gli operatori eseguono le suddette manovre da entrambi i lati.

*La Commissione segnala che in sede di campionatura ha rilevato la posizione corretta della valvola (zona testa). La posizione sul lato opposto le manovre rianimatorie, sebbene sia stata rilevata, non è un elemento discriminante, infatti è stato attribuito un punteggio pari a 1 e nessuna delle concorrenti ha ottenuto il massimo punteggio attribuibile.*


### **Sicurezza**

Gli allarmi sono effettivamente 5 e non 6 come da noi indicato per errore per un refuso.

### **Impianto elettrico**

La Commissione valuta erroneamente la presa ed il cavo di rete "lo spinotto di connessione non è intercambiabile ma connesso al motore" in quanto non può essere considerato un aspetto negativo il fatto che il cavo di alimentazione non è separabile. Vengono fornite unità di controllo (pompe) con adeguate spine a seconda delle prese di corrente presenti nelle singole unità di reparto.

*La Commissione segnala che il Capitolato Tecnico prevedeva l'attribuzione di un punteggio di qualità per la possibilità di sostituzione del cavo.*



### **Unità motore >>> praticità di connessione del motore al materasso, ecc.**

La Commissione scrive "attacco difficile": chiediamo spiegazioni in quanto l'inserimento a scatto è semplice, rapido e preciso.

*La Commissione precisa che in sede di prova pratica ha ritenuto di valutare come "difficile" la connessione del motore al materasso, anche in relazione al confronto con i prodotti presentati dagli altri concorrenti.*

### **Comfort operatore >> facilità di utilizzo del sistema e dei comandi**

La Commissione scrive "display con poco contrasto/poco visibile": tramite un comando è possibile regolare sia il contrasto che la luminosità.

La problematica segnalata non è stata evidenziata dalla Commissione ai Sig.ri Ricordini e Sommaro durante la presentazione dei presidi effettuata c/o l'Unità Spinale Unipolare dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. In quella sede si sarebbe potuto dimostrare come fare a variare sia l'intensità luminosa che il contrasto.

*La Commissione precisa che sarebbe stato compito dei rappresentanti della Ditta presentare il prodotto nelle sue condizioni ottimali in sede di campionatura e che suddetta problematica è stata oggetto di discussione durante la campionatura alla presenza dei rappresentanti della Ditta.*

### **Facilità ad eseguire le manovre di Nursing**

La commissione scrive "Tubo rigido ostacola le manovre di Nursing". Contestiamo questo punto in quanto la rigidità del tubo è adeguata a garantire la pervietà del passaggio dell'aria evitando che lo stesso si schiacci durante le manovre di nursing.

*La Commissione precisa che in sede di prova pratica ha valutato come "rigido e ostacolante le manovre di nursing" il tubo, anche in relazione al confronto con i prodotti presentati dagli altri concorrenti.*

Contestiamo il termine "potrebbe" perché il feedback di coloro che utilizzano questo presidio da tempo presso le loro strutture è totalmente positivo.

*La Commissione segnala che non si ritrova in questa sezione il termine "potrebbe".*

## **LOTTO 3**


### **Sicurezza >>> allarmi (tipologia e parametri segnalati)**

La Commissione considera 4 allarmi sui 5 dichiarati. Il quinto allarme è attivo qualora presente la batteria ausiliaria.

*La Commissione conferma di aver preso in considerazione gli allarmi in funzione, in condizioni di normalità.*

### **Impianto elettrico**

La Commissione valuta erroneamente la presa ed il cavo di rete "lo spinotto di connessione non è intercambiabile ma connesso al motore" in quanto non può essere considerato un aspetto negativo il fatto che il cavo di alimentazione non è separabile.

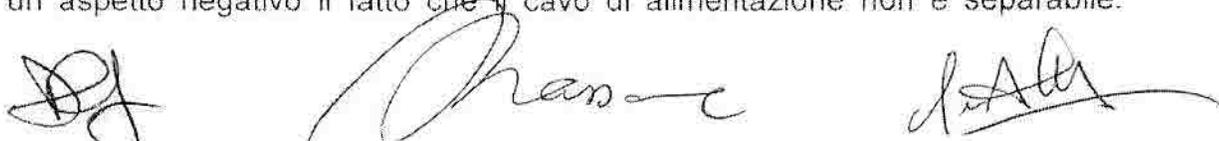

Vengono fornite unità di controllo (pompe) con adeguate spine a seconda delle prese di corrente presenti nelle singole unità di reparto.

*La Commissione segnala che il Capitolato Tecnico prevedeva l'attribuzione di un punteggio di qualità per la possibilità di sostituzione del cavo.*

#### **Comfort operatore >>> facilità di utilizzo del sistema e dei comandi**

La Commissione scrive che "in sede di prova pratica si è evidenziato che per spegnere l'allarme acustico occorre resettare il sistema staccando la spina".

In realtà l'allarme acustico può essere silenziato per 15 minuti tramite un apposito comando posizionato sul display della pompa di gonfiaggio, poi riprende a suonare ma può essere silenziato tutte le volte che lo si desidera fino a quando il problema non viene risolto: questo costituisce un sistema di sicurezza e non certo un'anomalia.

*La Commissione segnala che durante la prova pratica (alla presenza dei rappresentanti della Ditta) non ha potuto verificare quanto da Voi dichiarato.*

#### **Facilità ad eseguire le manovre di Nursing**

La commissione scrive "Tubo rigido ostacola le manovre di Nursing". Contestiamo questo punto in quanto la rigidità del tubo è adeguata a garantire la pervietà del passaggio dell'aria evitando che lo stesso si schiacci durante le manovre di nursing.

*La Commissione precisa che in sede di prova pratica ha ritenuto di valutare il tubo come "rigido e ostacolante le manovre di nursing", anche in relazione al confronto con i prodotti presentati dagli altri concorrenti.*

#### **Unità motore >> praticità di connessione del motore al materasso, ecc.**

La Commissione scrive "attacco difficile": chiediamo spiegazioni in quanto l'inserimento a scatto è semplice, rapido e preciso.

*La Commissione in sede di prova pratica ha ritenuto di valutare come "difficile" la connessione del motore al materasso, anche in relazione al confronto con i prodotti presentati dagli altri concorrenti.*

#### **Comfort paziente**

Contestiamo il termine "potrebbe" perché il feedback di coloro che utilizzano questo presidio da tempo presso le loro strutture è totalmente positivo.

*La Commissione precisa che ha evidenziato la possibilità di alterazione della funzione terapeutica, anche in relazione al confronto con i prodotti presentati dagli altri concorrenti.*

#### **LOTTO 4**

#### **Principio di funzionamento >>> scarico delle pressioni in relazione alle differenti zone corporee**

La Commissione scrive "3 zone" invece che 4 (testa -tronco-gambe-talloni) come si evince dalla scheda allegata ovvero:



3 celle sezione testa  
8 celle sezione tronco  
4 celle sezione gambe  
5 celle sezione talloni

*La Commissione rileva che, per mera errore materiale, sono state considerate 3 zone anziché 4. Pertanto la Commissione ritiene di dover modificare il punteggio assegnato a questo parametro e assegnare 1,60 punti.*

### **Accessibilità e facilità di utilizzo della valvola CPR**

Contestiamo assolutamente l'affermazione della Commissione che scrive "poco pratica ed indaginosa " in quanto ritenuta da tutti gli utilizzatori *Semplice- Rapida ed assolutamente efficace.*

*La Commissione precisa di aver rilevato queste caratteristiche della valvola CPR, anche in relazione al confronto con i prodotti presentati dagli altri concorrenti.*

### **Principio di funzionamento >>> praticità d'uso**

La Commissione scrive "tubo rigido, motore ingombrante non di ultima generazione": riteniamo la valutazione eccessivamente bassa, il motore viene descritto non di ultima generazione senza tener in alcun conto prestazioni, durata, affidabilità sicurezza (es. 3 stadi di filtrazione dell'aria fino a 0,3 Micron II).

*La Commissione ha ritenuto di esprimere la propria valutazione in relazione al confronto con i prodotti presentati dagli altri concorrenti.*

### **Impianto elettrico**

La Commissione valuta erroneamente la presa ed il cavo di rete "lo spinotto di connessione non è intercambiabile ma connesso al motore" in quanto non può essere considerato un aspetto negativo il fatto che il cavo di alimentazione non è separabile. Vengono fornite unità di controllo (pompe) con adeguate spine a seconda delle prese di corrente presenti nelle singole unità di reparto.

*La Commissione segnala che il Capitolato Tecnico, ~~è~~ prevedeva l'attribuzione di un punteggio di qualità per la possibilità di sostituzione del cavo.*


### **Sicurezza**

Gli allarmi sono 5 (Alta Pressione-Bassa Pressione-Mancanza alimentazione rete-Pompa Guasta - Service) e non 4 come da Voi dichiarato

*La Commissione ribadisce che il numero di allarmi rilevati sono 4, poiché l'allarme Alta/Bassa pressione è un unico allarme.*

### **Praticità di connessione del motore al materasso**

La commissione dichiara "la connessione al motore risulta poco funzionale per via della rigidità del tubo". Ribadiamo l'adeguata rigidità del tubo per mantenere la pervietà del passaggio dell'aria. Non viene invece valorizzata la possibilità di agganciare al contrario il

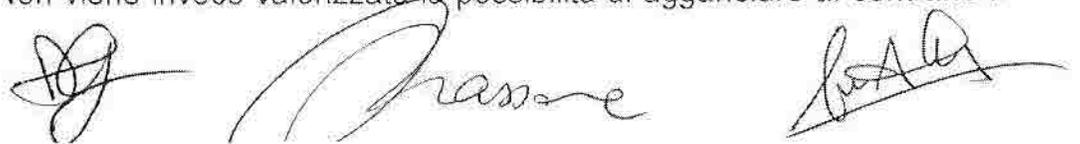

tubo di connessione che consente di posizionare a terra la pompa qualora si rendesse necessario rimuovere la pediera del letto (caratteristica unica presentata alla commissione durante la spiegazione del presidio).

*La Commissione in sede di prova pratica ha ritenuto di valutare come "difficile" la connessione del motore al materasso, anche in relazione al confronto con i prodotti presentati dagli altri concorrenti.*

### **Confort paziente**

La commissione scrive "si sente parzialmente il fondo ed in relazione al piegamento la funzione terapeutica potrebbe essere alterata". Non accettiamo la definizione "potrebbe" in quanto assolutamente non veritiera. Il tipo di realizzazione (la struttura delle celle ed i risultati fino ad oggi ottenuti dal punto di vista terapeutico, dimostrano la totale efficacia del sistema NIMBUS® nella prevenzione e gestione delle lesioni da pressione nell'alto ed altissimo rischio.

*La Commissione precisa di aver ~~ha~~ valutato la possibilità di alterazione della funzione terapeutica anche in relazione al confronto con i prodotti presentati dagli altri concorrenti. Inoltre la Commissione non può tener in alcun modo conto della valutazione fatta da altri utenti.*

### **Comfort operatore >>> facilità di utilizzo del sistema e dei comandi**

La Commissione scrive "la funzione del trasporto non è facilmente attivabile in quanto da ricercare nel materasso"

Contestiamo questa affermazione poiché la funzione è estremamente semplice e sicura ed in grado di garantire la possibilità di scollegare l'unità di controllo (pompa) in tutti quei casi dove gli spazi angusti non consentono di lasciare il compressore attaccato al letto durante i trasferimenti ( es. ascensori, corridoi e passaggi stretti, ecc.).

*La Commissione ha rilevato alcune difficoltà nella funzione di trasporto (come indicato nel verbale) anche in relazione al confronto con i prodotti presentati dagli altri concorrenti.*



La Commissione definisce lo sgonfiamento forzato della zona talloni "tecnologia obsoleta". Affermiamo l'assoluta efficacia dello sgonfiamento forzato ottenuto con le fasce elastiche che spingono individualmente le celle verso il basso quando si sgonfiano, rimuovendo la pressione da questa area ossea, prominente, ad altissimo rischio.

*La Commissione precisa di non aver messo in discussione l'efficacia del sistema di sgonfiamento, bensì la tecnologia. Essa è stata valutata come obsoleta anche in relazione al confronto con i prodotti presentati dagli altri concorrenti.*

La Commissione scrive "Tubo rigido ingombro motore"

Contestiamo questa affermazione in quanto si tratta di tubo piatto multi vie adeguatamente rigido per garantire ottima pervietà.

*La Commissione precisa che in sede di prova pratica ha ritenuto di valutare come "rigido e ingombrante" il tubo, anche in relazione ai prodotti presentati dagli altri concorrenti.*

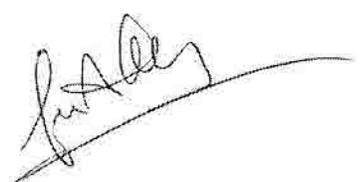

**Sempre con riferimento al lotto 4:**

Nel Disciplinare di Gara è previsto per il lotto 4 l'offerta di "i sistemi per la prevenzione dei pazienti ad altissimo rischio di varia tecnologia". dalle informazioni in ns. possesso per il presidio INNOVA EXTRAM RS ci risulta che si tratta di un sistema dove la tecnologia interviene solo parzialmente dovendo l'operatore effettuare delle impostazioni e dare input corretti al sistema affinché il trattamento terapeutico sia il più appropriato (oppure delle regolazioni).

La richiesta di un sistema di varia tecnologia non ci sembra quindi in linea con quanto richiesto per i lotti 2 e 3 dove per coprire rischi minori vengono richiesti sistemi automatici, quindi in grado di gestire in autonomia questa problematica.

*La Commissione precisa che le caratteristiche tecniche dei lotti sono state determinate da una Commissione tecnica all'uopo costituita, la quale ha individuato le caratteristiche tecniche dei prodotti da presentare per i vari lotti in base alle tipologie di lesioni da trattare.*

*Peraltro il capitolato, così come predisposto, è stato da Voi debitamente presentato e firmato per accettazione in fase di partecipazione alla gara.*

**La Commissione Giudicatrice, pertanto, ritiene di non dover variare i punteggi assegnati, ad eccezione del punteggio -LOTTO 4- relativo al parametro Principio di funzionamento-Scarico delle pressioni in relazione alle differenti zone corporee. Si allega per tanto la scheda di valutazione relativa al LOTTO 4 opportunamente corretta.**


• **Presidente:**

Dott. Antonino MASSONE

• **Componenti:**

Dott. Giovanni A. CHECCHIA

Sig.ra Deborah GRANARA

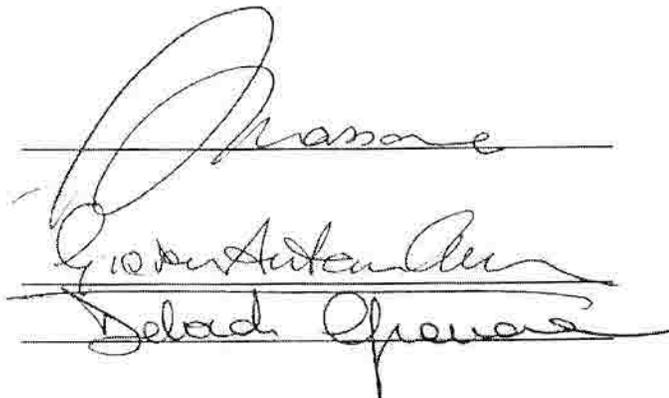

The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The top signature is 'Antonino Massone', the middle one is 'Giovanni A. Checchia', and the bottom one is 'Deborah Granara'.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Scheda valutazione Lotto 4**  
**Sistemi per la prevenzione dei pazienti ad altissimo rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al IV stadio di vana tecnologia in grado di gestire la macerazione cutanea.**

CATEGORIA	CARATTERISTICHE	Recordini	Scaligera	Riaba	ATE: KCH: Wash	Hill Rom	Punti max	Puntaggi attribuiti Lotto 4				
								Risortiti	Scaligera	Reba	ATI: KCH: Wash	Hill Rom
Struttura organizzativa personale e mezzi impiegati	Sede/Distributore	Nimbus 3	Giorno Acuto	Auto Sani Foot	Imnova Extra MRS	Clear: Active Plus MCM	6	2,00	2,00	2,00	5,60	3,50
	Numero personale/turno e tempo dedicato											
	Localizzazione centri di sanificazione											
	Aggiornamento personale/numero ore											
Aspetti igienici relativi alle procedure di sanificazione e sanificazione	Procedura di certificazione di qualità						3	0,00	0,00	0,00	3,00	2,50
	Modalità di lavaggio, sanificazione e accoppiatura del sistema (matteassa, tela, tubi, motori, tubi di collegamento, ecc.)											
Informatizzazione del servizio	Presenza di certificazioni di qualità del percorso di sanificazione						1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Progetto di informatizzazione del servizio						3	1,50	3,00	0,00	3,00	3,00
Migliore	Progetto di studio di prevalenza inerente le lesioni da pressione						2	0,50	0,50	0,00	2,00	1,50
	Presenza di modalità di scacco dinamico delle pressioni di contatto						2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Principio di funzionamento	Scaligera (vita pressione in relazione alle differenti zone corporee (anche con moduli alternativi))						2	1,00	1,20	0,40	1,20	2,00
	Funzione traspirante (x-3 ero) (a maggior durata consecutiva - maggior puntaggio)						2	2,00	1,11	1,11	2,00	1,11
	Portata temporistica in kg (x-120 kg) (a maggior portata corrispondente maggior puntaggio)						3	3,00	3,00	3,00	1,98	0,62
	Accessibilità e facilità di pulizia (della valvola CPK)						2	0,50	0,50	0,50	2,00	1,00
Sicurezza	Caratteristiche regolative del telo di copertura						1	0	0	0	1	0
	Praticità e uso (peso, materasso, telo di copertura, maneggevolezza del sistema, versatilità dimensionali)						0,5	0,34	0,27	0,50	0,30	0,22
							0,5	0,14	0,21	0,50	0,14	0,07
							1	0,25	0,50	0,25	1,00	1,00
Impianto elettrico	Altezza (spoglia e parametri regolati) (ad una più ampia gamma di alture (locutori, cervi) e parametri segnalati-corrispondenti maggior puntaggio)						4	1,50	2,20	0,30	2,00	4,00
	Presenza di sostituzione del cavo elettrificabile in base alle esigenze della rete elettrica delle singole unità operative											
Impianto idraulico	Praticità di connessione del motore al materasso, pulizia, ecc						1	0,25	0,25	0,25	1,00	1,00



## **ALLEGATO N. 5**

ALLA DELIBERAZIONE N. 84 DEL 22/12/2011


### **Verbale di apertura buste offerte economiche. Aggiudicazione provvisoria**

**Seduta del 07/12/2011**

# CRA

Centrale Regionale di Acquisto

Dirigente responsabile: dott.ssa Silvia SIMONETTI tel. 010/4102214  
e-mail: [silvia.simonetti@regione.liguria.it](mailto:silvia.simonetti@regione.liguria.it)  
Funziario referente: dott.ssa Paola BURLANDO tel. 010/4102577  
e-mail: [paola.burlando@regione.liguria.it](mailto:paola.burlando@regione.liguria.it)  
Estensore del documento: Sig. Roberto BORETTI tel. 010/4102570  
e-mail: [roberto.boretti@regione.liguria.it](mailto:roberto.boretti@regione.liguria.it)

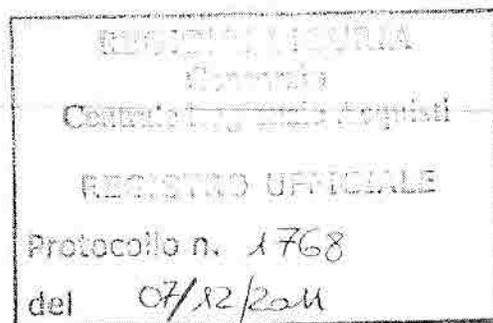

**Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di "Sistemi antidecubito" occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre Lotti n. 5 .**

## SECONDA SEDUTA PUBBLICA

### Verbale di apertura buste offerte economiche. Aggiudicazione provvisoria

Il giorno sette del mese di Dicembre dell'anno duemilaundici, alle ore 10,00 presso la Sala riunioni dell'Ospedale Villa Scassi (Palazzina Uffici Amministrativi), si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara della Centrale Regionale di Acquisto per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura aperta sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura in noleggio di Sistemi antidecubito occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre  
Il seggio di gara è così composto:

MASSONE	Dr. Antonino	Direttore dell'Unità Spinale dell' Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ASL 2 Savonese	Presidente della Commissione Giudicatrice
BURLANDO	Dott.ssa Paola	Collaboratore Amm.vo Esperto della Centrale	in qualità di Componente
BORETTI	Roberto	Assistente Amm.vo della Centrale	in qualità di Segretario

In rappresentanza delle Ditte offerenti sono presenti i Signori:

Nominativo	Ditta
Barbuti Valentina/Zuccato Nicola	ZUCCATO Hc S.r.l. (ex SANITARIA SCALIGERA S.r.l.)
Vitali Enrico/Quaggia Christian	KCI Medical S.r.l./ Vivisol
Tolu Antonello/Evangelisti Marco/Cerale Roberto	HILL- ROM S.p.A.
Ricordini Mauro	RICORDINI PIETRO DI RICORDINI MAURO & C. S.R.L.

muniti delle necessarie deleghe/procure (presentate in originale o in copia autenticata) allegate in copia quali parti integranti e sostanziali del presente verbale.

Il seggio di gara dà preliminarmente atto che:

- in data 12/10/2011 è stato redatto il verbale della verifica della documentazione tecnica e della campionatura prot. n. 1446 e che lo stesso è stato pubblicato sul sito informatico della Centrale;
- successivamente alla pubblicazione del suddetto verbale sono pervenute alla Centrale alcune richieste di chiarimenti e/o revisione dei punteggi da parte delle Ditte concorrenti;
- suddette comunicazioni sono state trasmesse dalla Centrale ai componenti della Commissione Giudicatrice per le opportune valutazioni;
- la Commissione Giudicatrice si è riunita in giorno 07/11/2011 per esaminare le richieste di chiarimenti pervenute fino a tale data e che le risultanze di suddetta riunione sono riassunte

Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Carlo Scassi, 1 - 16149 Genova - P. I. - Tel. 010 29030996  
Tel. +39 010 4102336 - Fax +39 010 4102417 - C.R.A. URL: [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it)

## Centrale Regionale di Acquisto

nel verbale prot. n.1591 del 07/11/2011, successivamente integrato con un "addendum" nel quale sono indicate le valutazioni della Commissione relative alle richieste successivamente al 7/11/2011.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice da quindi pubblica lettura dei suddetti verbali e dei punteggi assegnati a ciascuna Ditta per il parametro qualità, le cui risultanze sono sinteticamente riepilogate nella tabella che segue:

Ditte	Lotto 1		Lotto 2		Lotto 3		Lotto 4		Lotto 5	
	P.ti	Ammissa								
RICORDINI PIETRO DI RICORDINI MAURO & C. S.R.L.			27,42	SI	28,15	SI	24,88	NO		
T.S.S. S.R.L.			21,92	NO	21,10	NO				
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI				
ZUCCATO Hc Srl (ex SANITARIA SCALIGERA Srl)			31,63	SI	28,98	SI	28,78	SI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI
REHA - ISTITUTO TECNICO ORTOPEDICO			22,76	NO			22,45	NO		
ATI KCI MEDICAL S.R.L - VIVISOL			N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	44,70	SI	43,73	SI	46,50	SI
HILL- ROM S.P.A.	42,90	SI	38,26	SI	39,04	SI	38,55	SI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI
MEDIC AIR S.R.L.			N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI	N.C.	ASSENZA REQUISITI TECNICI MINIMI		

Come previsto dal disciplinare di gara, non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica le offerte prive delle caratteristiche tecniche ritenute indispensabili, pena esclusione e le offerte che non hanno raggiunto un punteggio tecnico maggiore o uguale a 26 e cioè:

Lotto 1 - non ammesse: offerta Ditta Officina Ortopedica Ferrero;

Lotto 2 - non ammesse: offerte Ditte T.S.S. Srl, Officina Ortopedica Ferrero, Reha - Istituto Tecnico Ortopedico, Ati Kci Medical S.R.L - Vivisol, Medic Air S.R.L.

Lotto 3 - non ammesse: offerte Ditte T.S.S. S.R.L., Officina Ortopedica Ferrero, Medic Air S.R.L.;

Lotto 4 - non ammesse: offerte Ditte Ricordini Pietro di Ricordini Mauro & c. S.r.l., Reha - Istituto Tecnico Ortopedico, Medic Air s.r.l.;

Lotto 5 - non ammesse: offerte Ditte Zuccato Hc Srl (Ex Sanitaria Scaligera Srl), Hill- Rom S.P.A.,

Alla richiesta fatta dal Presidente della Commissione se qualcuno dei presenti abbia qualche rilievo da fare, prende la parola il Dr. Vitali (in rappresentanza dell' ATI KCI - Vivisol) affermando che quanto scritto dalla Ditta Hill Rom è infondato e per tanto l' ATI KCI - Vivisol si riserva di tutelare i propri interessi nelle sedi opportune e fa rilevare la "scorrettezza" delle accuse a loro rivolte.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice ricorda che l'aggiudicazione avverrà in base al metodo disposto all'art. 83 del D.Lgs n° 163/06 e s.m.i, ossia a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, (comunemente detto qualità/prezzo) sulla base degli elementi valutativi indicati nel Capitolato Speciale e del prezzo offerto.

Il prezzo offerto si intende per lotto (cfr. offerte scheda economica) ed è determinato moltiplicando il prezzo unitario del noleggio per il numero di giornate triennali indicati per ciascun singolo lotto nel capitolato tecnico e nelle schede di offerta.

Per l'attribuzione del relativo punteggio al prezzo più basso saranno attribuiti punti 50. I punteggi saranno attribuiti secondo la seguente formula:

$$p = (50 \times P_m) / P$$

(p = punteggio; P = prezzo dell'offerta presa in considerazione; P<sub>m</sub> = prezzo dell'offerta più bassa)

Il Presidente ricorda altresì che, pena esclusione dalla gara, i prezzi proposti dalle ditte dovranno essere per ciascun prodotto offerto nei lotti di cui alla Sezione "A" del disciplinare uguali o migliori rispetto ai prezzi base ivi indicati.

Ciò determinato, previa positiva verifica della integrità del plico contenente le buste di offerta economica e la regolarità delle buste e dei sigilli appostivi, il Presidente procede all'operazione d'apertura delle offerte economiche (busta n. 2) conservate correttamente come previsto dal Disciplinare e alla verifica della presenza su tutte le offerte degli elementi previsti dal Disciplinare di gara (sottoscrizione della scheda offerta, presenza del bollo, etc).

Indi il Presidente della Commissione procede:

1. alla lettura dei prezzi proposti, dai concorrenti ammessi a questa fase di gara (in caso di difformità nell'offerta tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la Centrale).
2. a determinare, in base alla formula descritta, il punteggio relativo al Prezzo.
3. a individuare la Ditta che ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.  
In caso di parità tra più offerte, l'aggiudicazione sarà a favore del prodotto a cui è stato attribuito un punteggio di qualità maggiore, e in caso di ulteriore parità si procederà ad una richiesta di miglioramento ai Legali Rappresentanti delle Ditte interessate concorrenti; qualora nessuna delle Ditte che hanno presentato offerta uguale sia presente, o, anche se presente, non voglia migliorare l'offerta, sarà effettuato un sorteggio.
4. a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

L'operazione avviene in tempo reale attraverso la compilazione di un foglio di calcolo opportunamente predisposto.

Il risultato delle suddette operazioni è riepilogato nella tabella che segue:

## Centrale Regionale di Acquisto

Nome Ditta		RICORDINI PIETRO DI RICORDINI MAURO & C. S.R.L	ZUCCATO HC - (EX SANITARIA SCALIGERA S.R.L)	ATI KCI MEDICAL S.R.L - VIVISOL	HILL- ROM S.P.A.
Lotto 1	Punteggio di qualità (A)				42,90
	Punteggio prezzo (B)				50
	Prezzo Offerto €.				13.667,70
	Totale Punteggio (A+B)				92,90
	Posizione classifica in				AGGIUDICATARIA
Lotto 2	Punteggio di qualità (A)	27,42	31,63		38,26
	Punteggio prezzo (B)	36,52	50		35,29
	Prezzo Offerto €.	855.092,70	624.476,79		884.706,30
	Totale Punteggio (A+B)	63,94	81,63		73,55
	Posizione classifica in	3 classif.	AGGIUDICATARIA		2 classif.
Lotto 3	Punteggio di qualità (A)	28,15	28,98	44,70	39,04
	Punteggio prezzo (B)	33,73	50	34,10	35,94
	Prezzo Offerto €.	599.735,00	404.542,00	593.224,50	562.801,50
	Totale Punteggio (A+B)	61,88	78,98	78,80	74,98
	Posizione classifica in	4 classif.	AGGIUDICATARIA	2 classif.	3 classif.
Lotto 4	Punteggio di qualità (A)		28,78	43,73	38,55
	Punteggio prezzo (B)		50	39,92	38,79
	Prezzo Offerto €.		433.978,70	543.588,60	559.448,80
	Totale Punteggio (A+B)		78,78	83,65	77,34
	Posizione classifica in		2 classif.	AGGIUDICATARIA	3 classif.
Lotto 5	Punteggio di qualità (A)			46,50	
	Punteggio prezzo (B)			50	
	Prezzo Offerto €.			84.175,00	
	Totale Punteggio (A+B)			96,50	
	Posizione classifica in			AGGIUDICATARIA	

Centrale Regionale di Acquisto

La seduta è tolta alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:

MASSONE

Dott. Antonino



Componente:

BURLANDO

Dott.ssa Paola




Segretario:

BORETTI

Roberto





All.  
Scheda riepilogativa offerte  
Offerte economiche

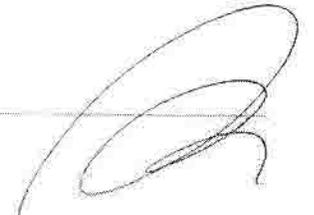

Lotto 1		Qualità		Prezzo			Punteggio Totale
Ditta	Prodotto	Punteggio	Ammesso	Unitario a chiamata	Unitario continuativo	Totale	Punteggio
HILL ROM	P330 Wound Surface	42,90	SI	3,95	2,75	13.567,70	50,00
						13.567,70	92,90

Vincitore	
HILL ROM	Can. 92,9

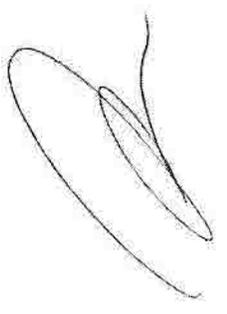



Lotto 2		Qualità			Prezzo			Punteggio	
Ditta	Prodotto	Punteggio	Ammesso	Unitario a chiamata	Unitario continuativo	Sistemi	Totale	Punteggio	Totale
RICORDINI	Alpha Response	27,42	SI	4,90	3,50	€ 855.092,70	855.092,70	36,52	63,94
TSS	Dual/Revo	21,92	NO			€ 0,00	NC	NC	NC
ZUCCATO HC	Pulsar Choice MR	31,63	SI	3,43	3,15	€ 624.476,79	624.476,79	50,00	81,63
REHA	Air Express P280DF	22,76	NO			€ 0,00	NC	NC	NC
HILL ROMI	Primo	38,26	SI	4,95	4,10	€ 884.706,30	884.706,30	35,29	73,55

Vincitore	ZUCCATO HC	Con	81,63
-----------	------------	-----	-------



Ditta	Lotto 3	Qualità		Prezzo			Punteggio Totale		
		Prodotto	Punteggio	Ammesso	Unitario a chiamata	Unitario continuativo		Sistemi	Totale
RICORDINI	Autologic	28,15	SI	7,00	5,00	€ 599.735,00	599.735,00	33,73	61,88
TSS	Sistema Dual	21,10	NO			€ 0,00	NC	NC	NC
ZUCCATO HC	Quattro Plus	28,98	SI	4,40	4,10	€ 404.542,00	404.542,00	50,00	78,98
ATI: KCI-VIVISOL	Innova Extra O.L.	44,70	SI	6,90	5,00	€ 593.224,50	593.224,50	34,10	78,80
HILL ROM	Clin Active Plus	39,04	SI	6,30	5,30	€ 562.801,50	562.801,50	35,94	74,98



Vincitore  
**ZUCCATO HC** Con 78,98

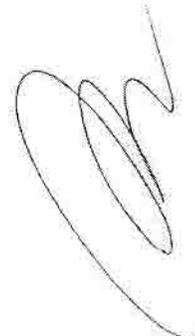


Ditta	Lotto 4	Prodotto	Qualità		Prezzo				Punteggio Totale	
			Punteggio	Ammesso	Unitario a chiamata	Unitario continuativo	Sistemi	Totale		Punteggio
RICORDINI		Nimbus 3	24,88	NO			€ 0,00	NC	NC	NC
ZUCCATO HC		Quattro Acute	28,78	SI	6,10	5,30	€ 433.978,70	433.978,70	50,00	78,78
REHA		Auto Sure Float	22,45	NO			€ 0,00	NC	NC	NC
ATI: KCI - VIVISOL		Innova Extra MRS	43,73	SI	7,80	5,90	€ 543.588,60	543.588,60	39,92	83,65
HILL ROM		Clean Active Plus MCM	38,55	SI	8,00	6,20	€ 559.448,80	559.448,80	38,79	77,34

Vincitore  
ATI: KCI - VIVISOL Con 83,65

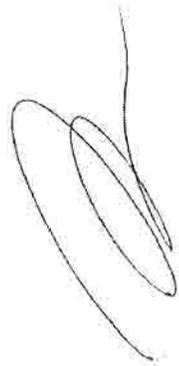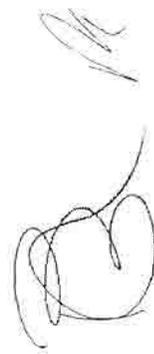

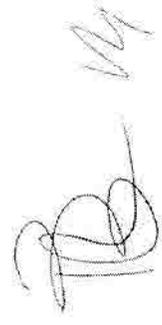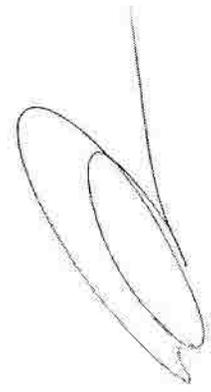Lotto 5		Qualità		Prezzo		Punteggio Totale	
Ditta	Prodotto	Punteggio	Ammesso	Unitario a chiamata	Sistemi	Totale	Punteggio
ATI: KCI - VIVISOL	Thera kair Visio	46,50	SI	12,95	€ 84.175,00	84.175,00	50,00
							96,50

Vincitore	
ATI: KCI - VIVISOL	Con 96,5

Sistemi antidecubito a riduzione pressoria continua senza elettrocompressore per la prevenzione e/o il trattamento delle lesioni fino al II stadio

**PRODOTTO OFFERTO**

**OFFERTA ECONOMICA**

Lotto	Denominazione prodotto	Fabbricante	Codice prodotto attribuito dal fabbricante	Fornitore	Codice prodotto attribuito dal fornitore	N° repertorio	Classif. C.N.D.	Quantitativo triennale		Prezzo unitario (IVA esclusa)	Importo complessivo triennale in cifre (IVA esclusa)	Importo complessivo triennale in lettere (IVA esclusa)
								C	D			
1	P330	HILL-ROM Industries	N02061	HILL-ROM S.p.a.	N02061	227788	Y033306	Noleggio a chiamata (n° giornate) (A)		3.126 €	12.347,70	diecimilatrecentoquarantasette/100
								Noleggio Continuativo (n° giornate) (B)		480 €	1.320,00	miltecentoventi
Totale Offerta (A+B)											13.667,70	tredecimilaseicentosessantasette/100


Nota: il prezzo offerto dovrà contenere al massimo 2 decimali


offerta 733/10/GMT/ar/1

del 15/11/2010

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

**HillRom S.p.A.**  
Massimo Bocciarelli  
Direttore Vendite

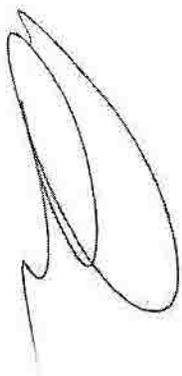

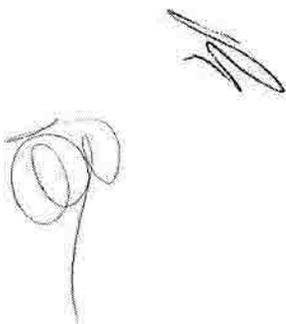ALLEGATO F2

GARA: SISTEMI ANTIDECUBITO

Sistemi a bassa pressione continua/ alternata per la prevenzione delle lesioni da pressione nei pazienti a medio rischio

PRODOTTO OFFERTO PULSAIR CHOICE (MR)

OFFERTA ECONOMICA

Lotto	Denominazione prodotto	Fabbricante	Codice prodotto attribuito dal fabbricante	Fornitore	Codice prodotto attribuito dal fornitore	N° repertorio	Classif. C.N.D.	Quantitativo		Prezzo unitario (IVA esclusa)	Importo complessivo triennale in cifre (IVA esclusa)	Importo complessivo triennale in lettere (IVA esclusa)
								triennale	C			
2	PULSAIR CHOICE (MR)	TALLEY GROUP LTD	PULSAIR CHOICE (MR)	SANTARIA SCALIGERA SRL	PULSAIR CHOICE (MR)	253098	Z12040212	Noleggio a chiamata (n° giornate) (A)		€ 3,43	€ 507.873,24	Euro centosettantaquattrocentocinquantaquattroventiquattro
								Noleggio Continuativo (n° giornate) (B)		€ 3,15	€ 116.603,55	Euro centosettantaquattrocentocinquantaquattroventiquattro
Totale Offerta (A+B)										€ 624.476,79	€ 624.476,79	Euro seicentotrentaduecentocinquantaquattroventiquattrocentocinquantaquattroventiquattro

Nota: il prezzo offerto dovrà contenere al massimo 2 decimali

offerta n° 10/0250/EP

Del 05/11/2010

MEMBRO E FIRMA LEGGIBILE

*[Signature]*

**SANTARIA SCALIGERA S.p.A.**  
 TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLA MEDICINA  
 Via della Consorteia 2 - 37127 Verona  
 Tel. 0469 578 955 - Fax 0469 378 595  
 WWW.SANTARIA.SCALIGERA.CO.IT  
 P.IVA 01600003601



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

ALLEGATO F2

GARA: SISTEMI ANTIDECUBITO

Sistemi a pressione alternata / fluttuazione dinamica per la prevenzione delle lesioni da pressione in pazienti ad alto rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al III stadio

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 RICA DA SOILLO  
 € 14,62  
 0 1 09 047201 254 8  
 01B9492012148

PRODOTTO OFFERTO : QUATTRO PLUS

OFFERTA ECONOMICA

Lotto	Denominazione prodotto	Fabbricante	Codice prodotto attribuito dal fabbricante	Fornitore	Codice prodotto attribuito dal fornitore	N° repertorio	Classif. C.N.D.	Quantitativo triennale		Prezzo unitario (IVA esclusa)		Importo complessivo triennale in cifre (IVA esclusa)		Importo complessivo triennale in lettere (IVA esclusa)	
								C	D	C X D	€	C X D	€	Lettere	
3	QUATTRO PLUS	TALLEY GROUP LTD	QUATTRO PLUS	SANTARIA SCALIGERA SRL	QUATTRO PLUS	18723	Z12040212	Noleggio a chiamata (n° giornate) (A)		65.105	€ 4,40	€ 286.462,00		Euro duecentottanta sei mila quattrocento sessantadue/100	
								Noleggio Continuativo (n° giornate) (B)		28.800	€ 4,10	€ 118.080,00		Euro centottantaotto mila zeroottanta/100	
								Stand By (n° sistemi)		13					
Totale Offerta (A+B)											€ 404.542,00	Euro quattrocento quarantamila duecento quarantadue/100			

Nota 1: Il prezzo offerto dovrà contenere al massimo 2 decimali

Nota 2: La Ditta partecipante dovrà assicurare anche la fornitura dei sistemi in stand-by la cui attivazione avrà le medesime condizioni contrattuali del servizio di "noleggio a chiamata"

offerta n° 10/0250/EP Del 05/11/2010

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE  
**FANTARIA SCALIGERA SRI**  
 TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA MEDICINA  
 VIA BENEDETTI 31127 Verona  
 Tel. 0455 378 536 Fax 0455 378 538  
 www.fantariascali.com  
 P. IVA e Iscr. COAIA di Terza. C172590233

Sistemi per la prevenzione dei pazienti ad altissimo rischio ero il trattamento delle lesioni da pressione fino al IV stadio di varia tecnologia in grado di gestire la macerazione cutanea

PRODOTTO OFFERTO

OFFERTA ECONOMICA

Lotto	Denominazione prodotto	Fabbricante	Codice prodotto attribuito dal fabbricante	Fornitore	Codice prodotto attribuito dal fornitore	N° repertorio	Classif. C.N.D.	Quantitativo			Importo complessivo o triennale (IVA esclusa)	Importo complessivo triennale in lettere (IVA esclusa)
								triennale	unitario (IVA esclusa)	C X D		
4	Innova Extra MRS	Kci USA Inc	MRS - M8230132 MRS - M8230133	Kci Medical s.r.l.	MRS - M8230132 MRS - M8230133	326816	Y033306	Noleggio a chiamata (n° giornate) (A)			€ 497.337,00	€ quattrocentosessantasettemilatrecentotrentasette/00
								Noleggio Continuativo (n° giornate) (B)				
								Stand By (n° sistemi)				
								Totale Offerta (A+B)			€ 543.588,60	€ cinquecentoquarantatremilacinquecentoottantotto/60

Nota 1: il prezzo offerto dovrà contenere al massimo 2 decimali

Nota 2: la Ditta partecipante dovrà assicurare anche la fornitura dei sistemi in stand-by la cui attivazione avrà le medesime condizioni contrattuali del servizio di "noleggio a chiamata"

offerta n° 2010/1188/Fb/1b del 09/12/2010

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE


**KCI Medical Srl**


Amministratore Delegato

Leonardo Borghesio



VIVIPOL S.r.l.



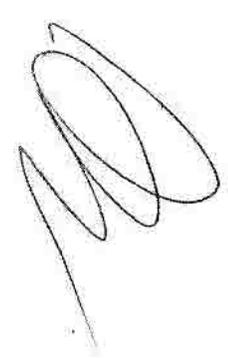Sistemi a reale cessione d'aria per la prevenzione dei pazienti ad altissimo rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al IV stadio per terapia intensiva

**PRODOTTO OFFERTO**

**OFFERTA ECONOMICA**

Lotto	Denominazione prodotto	Fabbricante	Codice prodotto attribuito dal fabbricante	Fornitore	Codice prodotto attribuito dal fornitore	N° repertorio	Classif. C.N.D.	Quantitativo triennale		Prezzo unitario (IVA esclusa)	Importo complessivo triennale in cifre (IVA esclusa)	Importo complessivo triennale in lettere (IVA esclusa)
								C	D			
5	Therakair Visio	Kci USA Inc	M6256529 M6256526	Kci Medical s.r.l.	M6256529 M6256526	114292/R	Y033308	Noleggio a chiamata (n° giornate) (A)		€ 12,95	€ 84.175,00	€ ottantaquattromilacentosettantacinque/00
								Stand By (n° sistemi)	3			
Totale Offerta (A)										€ 84.175,00	€ ottantaquattromilacentosettantacinque/00	

Nota 1: il prezzo offerto dovrà contenere al massimo 2 decimali

Nota 2: la Ditta partecipante dovrà assicurare anche la fornitura dei sistemi in stand-by la cui attivazione avrà le medesime condizioni contrattuali del servizio di "noleggio a chiamata"

offerta n° 2019/1188/fv/ib

del 09/12/2010

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

**KCI Medical Srl**

Amministratore Delegato



Leonardo Borghesio



VIVISOL S.R.L.

Amministratore Delegato

Handwritten signature of Vivisol representative


## **ALLEGATO N. 6**

ALLA DELIBERAZIONE N. 84 DEL 22/12/2011

### **Offerte economiche presentate dalle ditte**

ALLEGATO F2

GARA: SISTEMI ANTIDECUBITO

Sistemi antidecubito a riduzione pressoria continua senza elettrocompressore per la prevenzione e/o il trattamento delle lesioni fino al II stadio

HILL - ROM S.p.A.  
Via Ambrosoli n. 6  
20090 RODANO (MI)  
P. IVA 08817300158

PRODOTTO OFFERTO

OFFERTA ECONOMICA

Lotto	Denominazione prodotto	Fabbricante	Codice prodotto attribuito dal fabbricante	Fornitore	Codice prodotto attribuito dal fornitore	N° repertorio	Classif. C.N.D.	Quantitativo triennale	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Importo complessivo triennale in cifre (IVA esclusa)	Importo complessivo triennale in lettere (IVA esclusa)	
1	P330	HILL-ROM Industries	N02061	HILL-ROM S.p.a.	N02061	227788	Y033306	3.126	€ 3,95	12.347,70	dodici milatrecento quarantasette/70	
								C	D	C X D		
								Noleggio a chiamata (n° giornate) (A)		480	€ 2,75	milatrecentoventi
								Noleggio Continuativo (n° giornate) (B)				tredecimilaseicent
								Totale Offerta (A+B)				osessantasette/70

Nota: il prezzo offerto dovrà contenere al massimo 2 decimali

offerta 733/10/G/MT/ar/1

del 15/11/2010

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Hill-Rom S.p.A.  
Massimo Bocciarelli  
Direttore Venditori  
*Massimo Bocciarelli*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ALLEGATO F2**

**GARA: SISTEMI ANTIDECUBITO**

Sistemi a pressione alternata / fluttuazione dinamica per la prevenzione delle lesioni da pressione in pazienti ad alto rischio e/o il trattamento delle lesioni da pressione fino al III stadio

**PRODOTTO OFFERTO : QUATTRO PLUS**

**OFFERTA ECONOMICA**

Lotto	Denominazione prodotto	Fabbricante	Codice prodotto attribuito dal fabbricante	Fornitore	Codice prodotto attribuito dal fornitore	N° repertorio	Classif. C.N.D.	Quantitativo triennale	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Importo complessivo triennale in cifre (IVA esclusa)	Importo complessivo triennale in lettere (IVA esclusa)
								C	D	C X D	
								65.105	€ 4,40	€ 286.462,00	euro duecentottanta seimilaquattrocento sessantadue/zero
								28.800	€ 4,10	€ 118.080,00	euro centodieciottomila zerottanta/zero
3	QUATTRO PLUS	TALLEY GROUP LTD	QUATTRO PLUS	SANITARIA SCALIGERA SRL	QUATTRO PLUS	18723	Z12040212				
								13			
										€ 404.542,00	Euro quattrocento quattromilacinque centoquarantadue /zero

Nota 1: il prezzo offerto dovrà contenere al massimo 2 decimali

Nota 2: la Ditta partecipante dovrà assicurare anche la fornitura dei sistemi in stand-by la cui attivazione avrà le medesime condizioni contrattuali del servizio di "noleggio a chiamata"

offerta n° 10/0250/EP

Del 10/05/11/2010

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

**SANITARIA SCALIGRA SM**  
 TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA MEDICINA  
 Via S. Maria Goretti, 127 - Veduggio (MI)  
 Tel. 0458 376 555 Fax 0458 376 553  
 www.sanitariascalingera.com  
 P.IVA e Iscr. CCIAA di Monza, C1729500233



